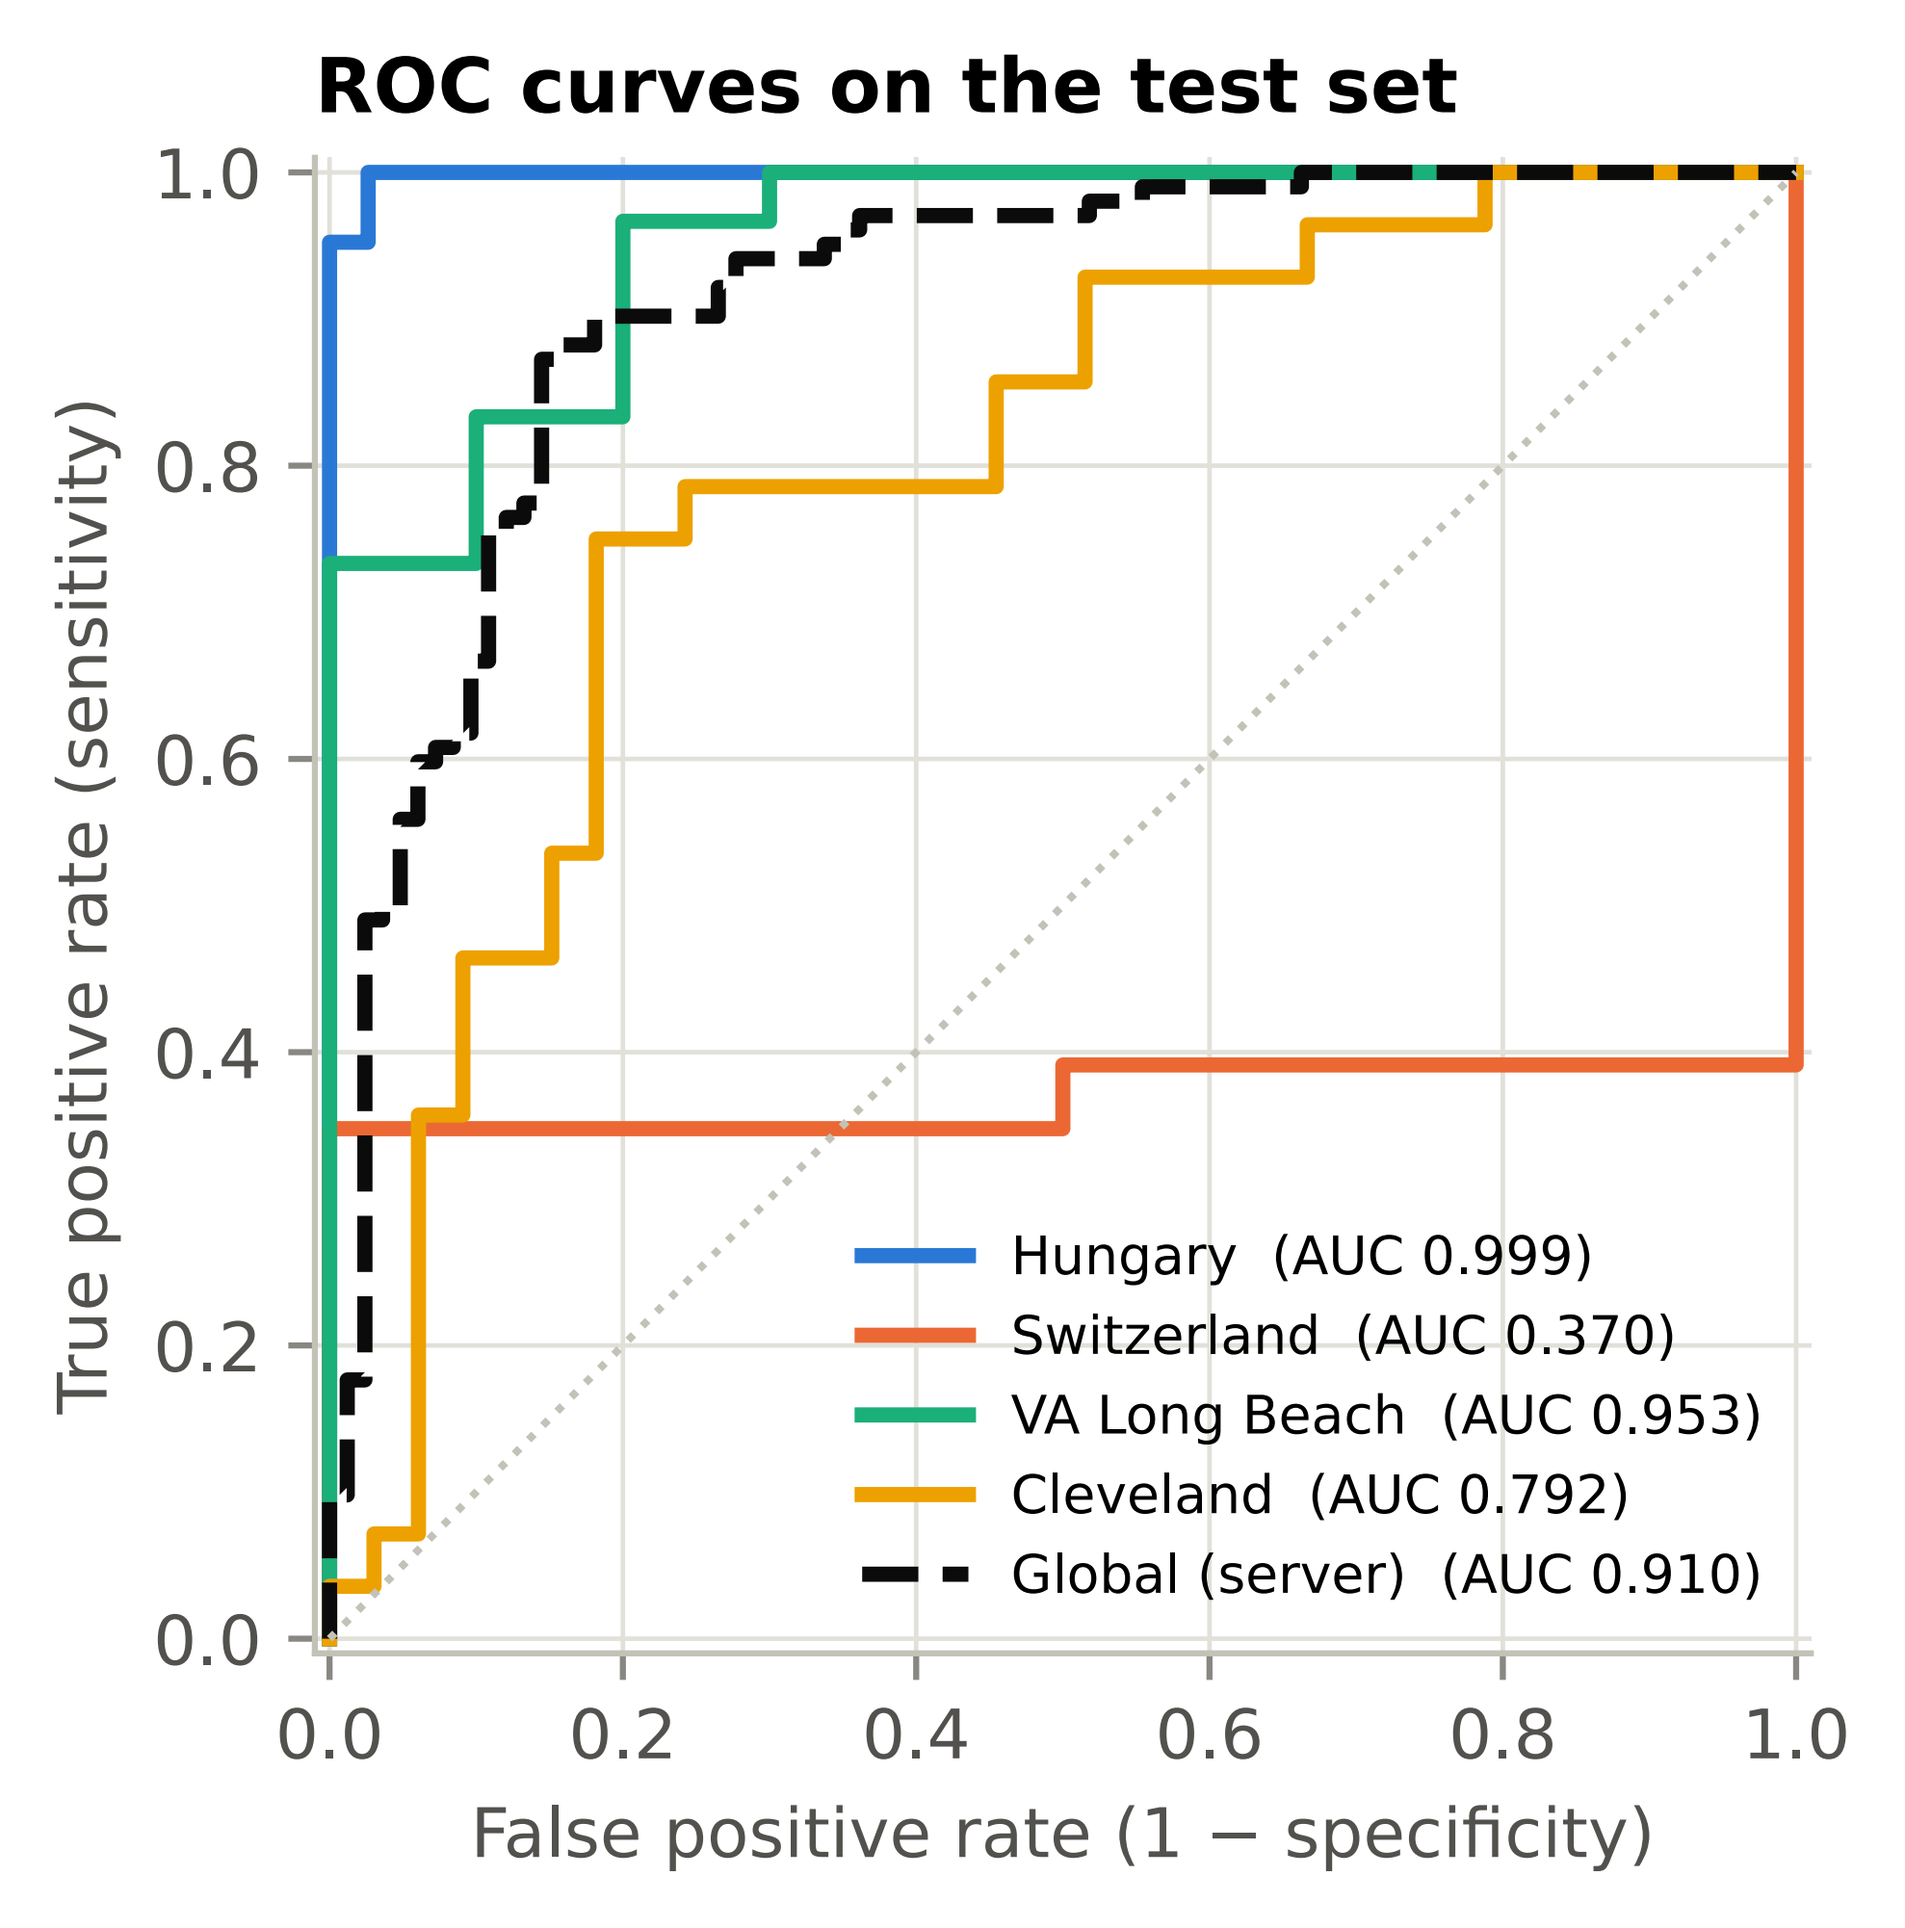
ROC curves on the test set
True positive rate (sensitivity)
False positive rate (1 − specificity)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Hungary (AUC 0.999)
Switzerland (AUC 0.370)
VA Long Beach (AUC 0.953)
Cleveland (AUC 0.792)
Global (server) (AUC 0.910)