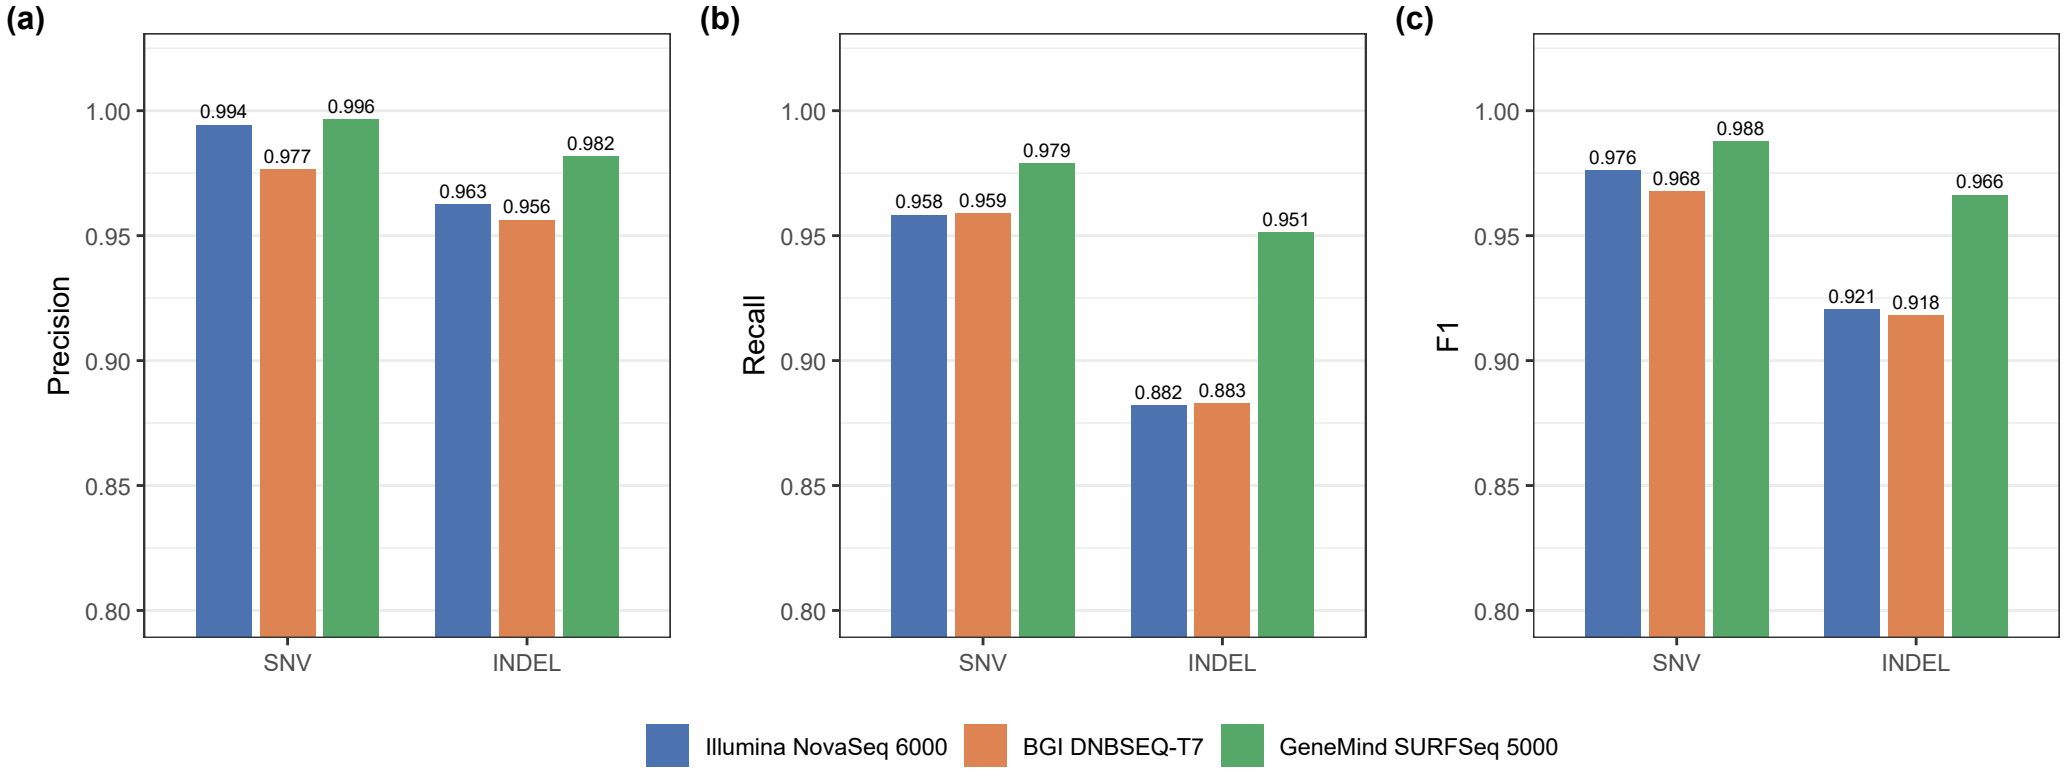
(a)
Precision
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.994
0.977
0.996
0.963
0.956
0.982
SNV
INDEL
(b)
Recall
0.958
0.959
0.979
0.882
0.883
0.951
(c)
F1
0.976
0.968
0.988
0.921
0.918
0.966
Illumina NovaSeq 6000
BGI DNBSEQ-T7
GeneMind SURFSeq 5000