Device−related thrombosis, corrected arm−level set

Study or subgroup	Bio−PFO Events	Bio−PFO Total	Metallic Events	Metallic Total	Weight	RD [95% CI] Estimate [95% CI]
Comparative studies						
Li 2026	3	44	0	88	100.0%	RD 0.07 (−0.01, 0.14)
Zhang 2026	0	96	0	94	−	RD 0.00 (0.00, 0.00)
Cernic Suligoj 2020	0	46	0	47	−	RD 0.00 (0.00, 0.00)
Li 2025	0	81	0	77	−	RD 0.00 (0.00, 0.00)
Total (RD)	3	267	0	306		**RD 0.01 (−5.05e−06, 0.03)**

Heterogeneity: Q = 0.00, df = 3, p = 1.000, I2 = 0%
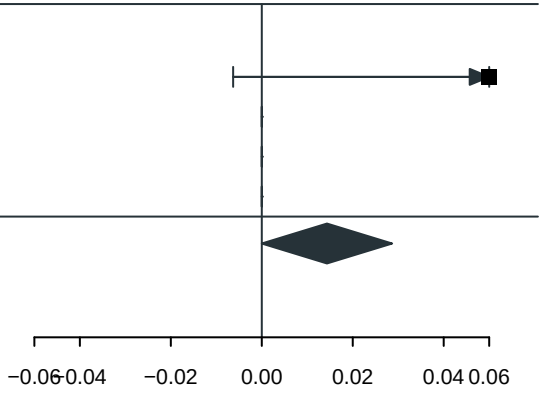
Model: MH RD; no continuity correction; k = 4; N = 573