
Guida alla pedana PNEV

Esame stabilometrico e biofeedback con la pedana Wii Balance Board

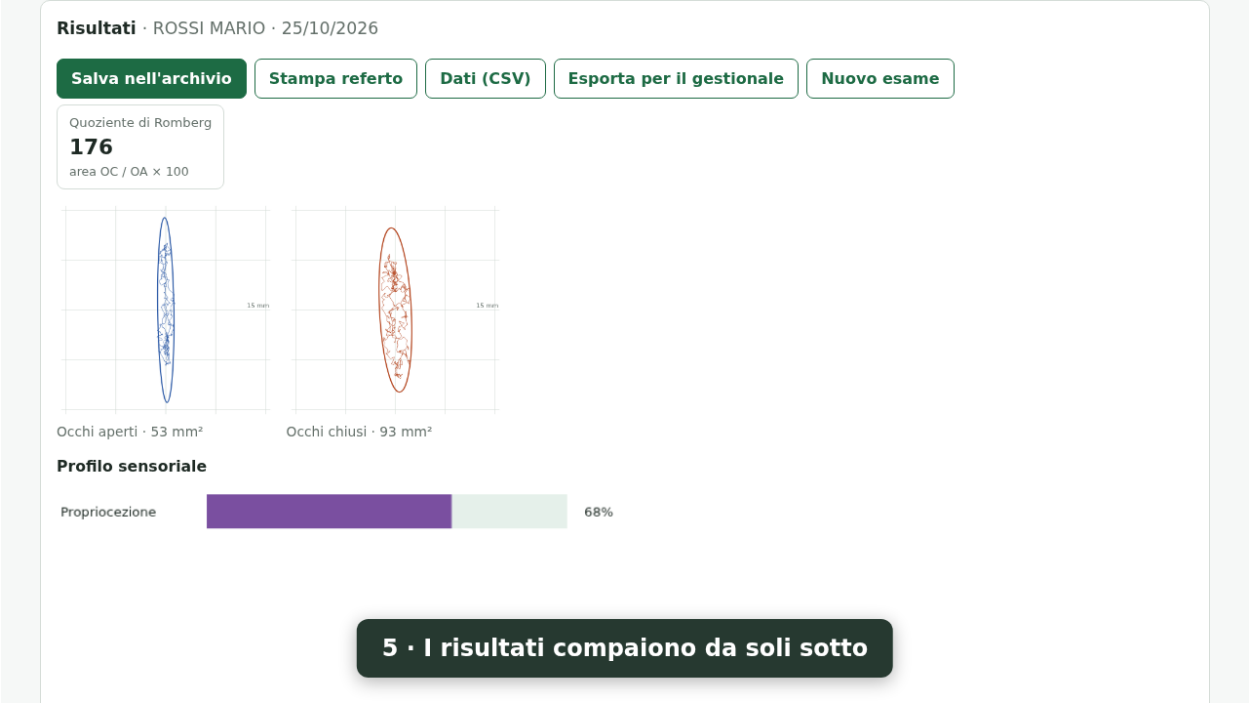

In breve. Dal gestionale premi «Apri la pedana» → «Collega la pedana» → «Azzera» → «Esame base» → «Avvia la prova» due volte → «Esporta per il gestionale» → carica il file nella scheda del paziente.

C'è anche un **video** di 2 minuti: nel gestionale, scheda «Pedana e installazione», oppure nella pagina della pedana con il pulsante «Video».

Cosa serve

1. La **pedana Wii Balance Board** con **4 pile AA cariche** (con pile scariche si collega ma misura male).
2. Un **computer Windows con Bluetooth**.
3. **Google Chrome** o **Microsoft Edge**. Firefox non può collegare la pedana.
4. Per alcune prove: un **cuscino di gommapiuma** e uno **schermo** (monitor o TV) davanti al paziente, a circa 1,5 m.

Prima volta su un computer: abbinare la pedana

Si fa **una sola volta per ogni computer**. Poi basta accendere la pedana.

1. Nel gestionale: **Valutazione PNEV** → **Neurologica e posturale** → **Postura (Wii Balance Board)**, scheda **«Pedana e installazione»**.
2. Scarica **«Programma di abbinamento»**, apri lo zip ed estrai la cartella.
3. Accendi il Bluetooth del computer, poi fai doppio clic su **«Abbina pedana Wii»**. Se Windows avvisa «PC protetto»: *Ulteriori informazioni* → *Esegui comunque*.
4. Apri lo sportellino delle pile, premi il **tastino rosso** (la luce blu lampeggia) e premi **Invio** nella finestra.
5. Quando compare **«FATTO! Pedana abbinata»** hai finito.
6. Consigliato: scarica anche l'**«Icona per il desktop»**. Con un doppio clic apre la pagina in Chrome.

> Se il programma non riesce, usa **Dolphin** (dolphin-emu.org): *Controller* → *Balance Board reale* → *spunta «Scansione continua»* e premi il tastino rosso. Poi chiudi Dolphin.

Ogni volta: l'esame in 6 passi

1 · Apri la pagina della pedana

Nel gestionale apri il paziente e il modulo **Postura (Wii Balance Board)**, poi premi **«Apri la pedana»**. La pagina si apre in una scheda nuova con **nome e data già scritti**.



2 · Collega la pedana

Accendi la pedana con il **pulsante davanti** (luce blu fissa) e premi **«Collega la pedana»**. Nella finestra di Chrome scegli **«Nintendo RVL-WBC-01»** e premi **Connetti**. Il pallino in alto a sinistra diventa verde.

3 · Azzera

Con nessuno sopra la pedana premi **«Azzera a pedana vuota»** e aspetta 2 secondi.



4 · Scegli l'esame

Esame base: occhi aperti e occhi chiusi (1 minuto). **Esame completo**: aggiunge limiti di stabilità e gommapiuma (5 minuti). Altre prove (testa ruotata, doppio compito, optocinetico, lenti/prismi, bite, monopodalico) sono in *«Scelta avanzata»*.



5 · Fai le prove

Fai salire il paziente, leggi ad alta voce le **istruzioni nel riquadro verde** e premi **«Avvia la prova»**. Ogni prova dura 30 secondi. Il primo secondo serve ad assestarsi. Alla fine la pagina passa da sola alla prova successiva.



Sicurezza: nelle prove a occhi chiusi e sulla gommapiuma **resta accanto al paziente**. Se scende dalla pedana la prova si ferma da sola: basta ripeterla.

6 · Guarda i risultati e mandali al gestionale

I risultati compaiono sotto: indici (Romberg, plantare…), tracciati con l'ellisse, profilo sensoriale, parametri e un **commento scritto in automatico**, da rileggere e correggere.




Premi **«Esporta per il gestionale»**: si scarica un file. Nel gestionale, scheda **«Carica esami»**, caricalo, spunta l'esame e premi **«Salva»**.



Nel gestionale

Esami: ogni esame con indici, grafici, commento modificabile e **«Referto Word»**.

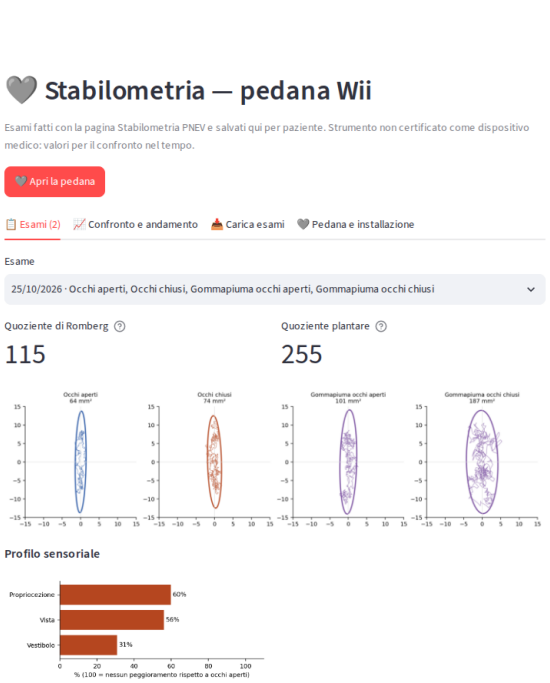

Confronto e andamento: grafici nel tempo e confronto **prima/dopo** tra due esami.



Archivio e biofeedback nella pagina

Archivio: gli esami salvati in quel computer, con andamento e confronto. Scarica ogni tanto la **copia di sicurezza**.



Biofeedback: esercizi in cui il paziente sposta il peso per guidare il punto (Resta al centro, Bersagli, Segui il percorso). Con «Feedback sonoro» o «Solo suono» si lavora anche a occhi chiusi.



Problemi frequenti

L'elenco di Chrome è vuoto

La pedana è spenta: premi il pulsante davanti (luce blu fissa) e riprova. Se la luce si spegne subito, cambia le pile.

Compare «serve Chrome o Edge»

Hai aperto la pagina con Firefox: premi «Apri in Microsoft Edge» oppure usa l'icona sul desktop.

Il punto va dalla parte sbagliata

Spunta «Inverti destra/sinistra» o «Inverti avanti/dietro» sotto la pedana.

Il peso è strano (troppo alto o basso)

Fai scendere il paziente e premi di nuovo «Azzera a pedana vuota».

«Meno di 10 kg sulla pedana»

Il paziente non è ancora salito, oppure la pedana è stata azzerata con qualcuno sopra: azzera di nuovo.

Ho cambiato computer

Fai l'abbinamento una volta (pag. 2). Gli esami salvati nel gestionale si vedono da qualsiasi computer.

Dove sono i dati dei pazienti?

Durante l'esame restano solo nel Chrome di quel computer: la pagina non manda niente su internet. Nel database dello studio entrano quando li carichi nel gestionale.

Nota. La pedana Wii Balance Board non è un dispositivo medico certificato. I valori servono per **confrontare lo stesso paziente nel tempo**, con la stessa procedura e durata, e vanno integrati con l'esame clinico.