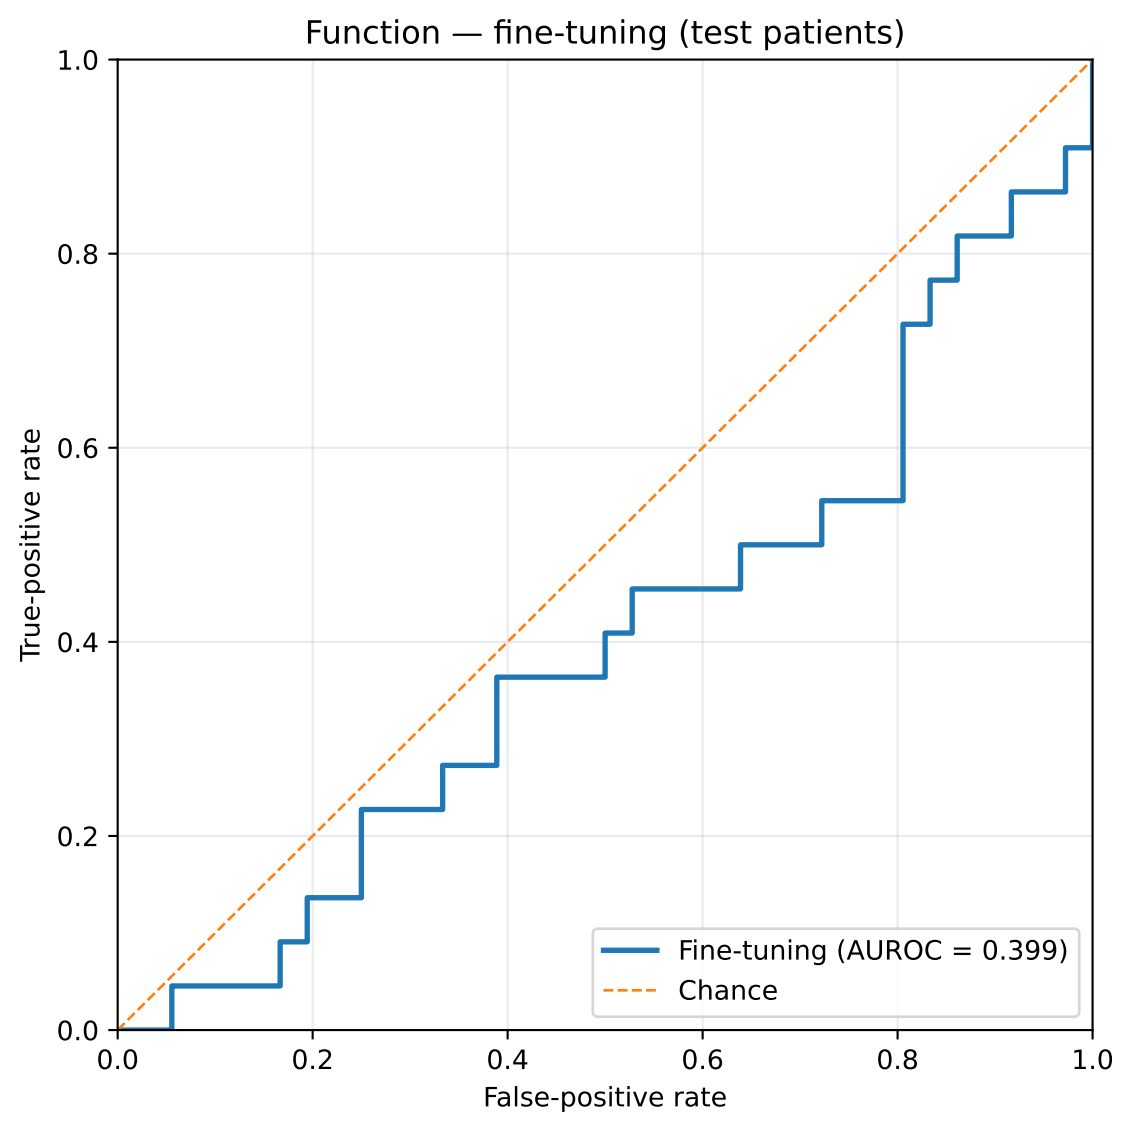
Function — fine-tuning (test patients)
True-positive rate
False-positive rate
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Fine-tuning (AUROC = 0.399)
Chance