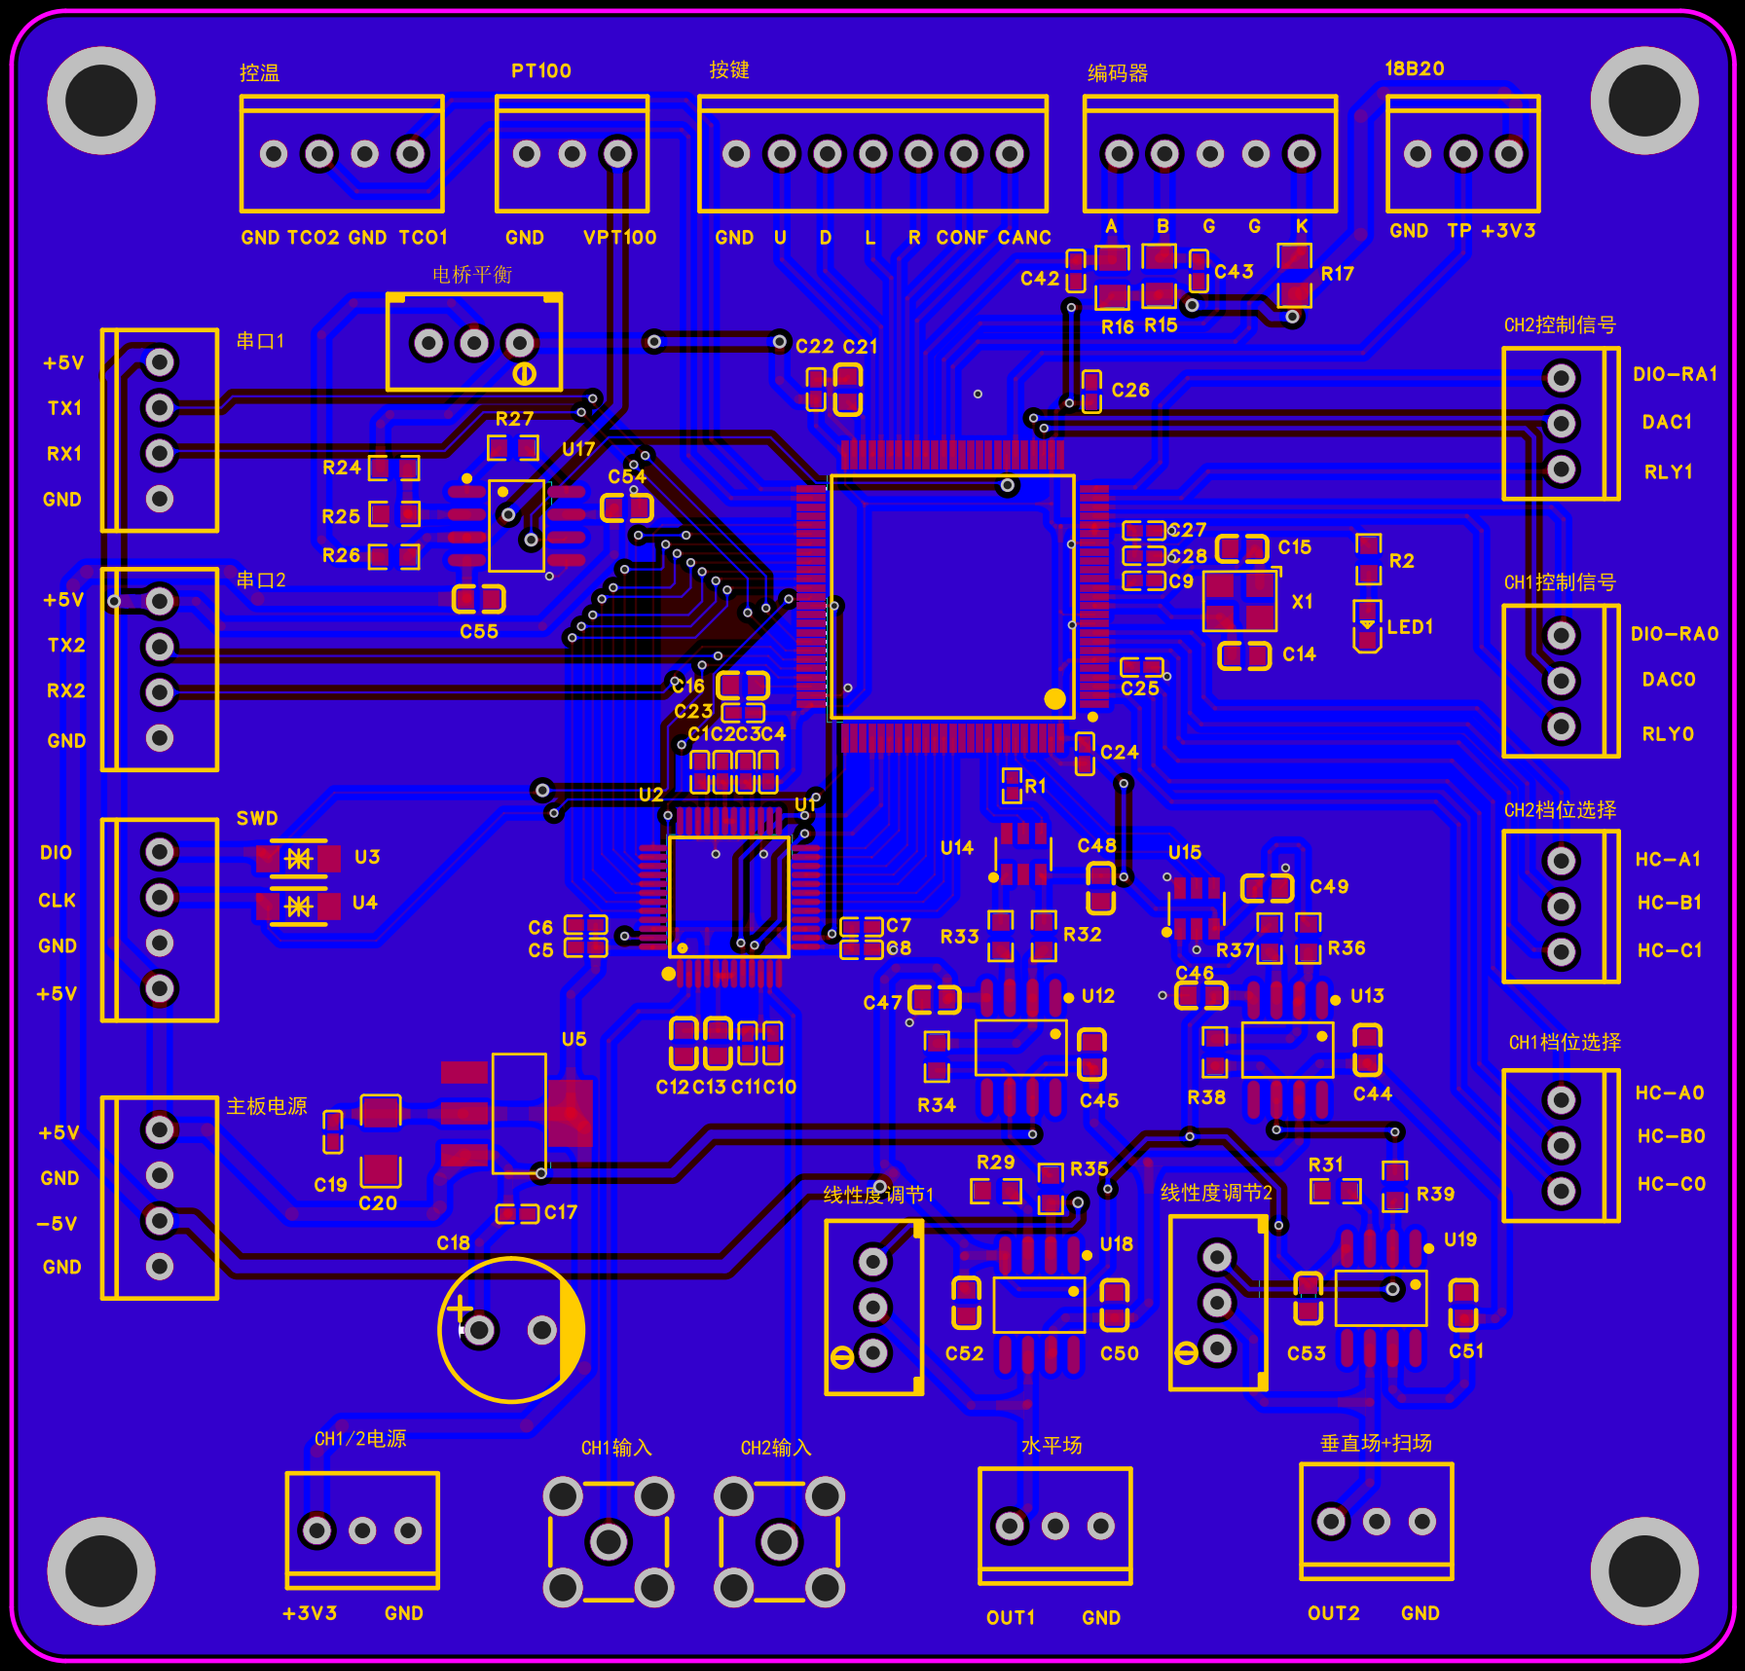
控温
GND TCO2 GND TCO1
PT100
GND VPT100
按键
GND U D L R CONF CANC
编码器
A B G G K
18B20
GND TP +3V3
电桥平衡
串口1
+5V
TX1
RX1
GND
串口2
+5V
TX2
RX2
GND
SWD
DIO
CLK
GND
+5V
主板电源
+5V
GND
-5V
GND
CH2控制信号
DIO-RA1
DAC1
RLY1
CH1控制信号
DIO-RA0
DAC0
RLY0
CH2档位选择
HC-A1
HC-B1
HC-C1
CH1档位选择
HC-A0
HC-B0
HC-C0
线性度调节1
线性度调节2
CH1/2电源
+3V3 GND
CH1输入
CH2输入
水平场
OUT1 GND
垂直场+扫场
OUT2 GND