



ODİYOMETRİ SONUÇ RAPORU

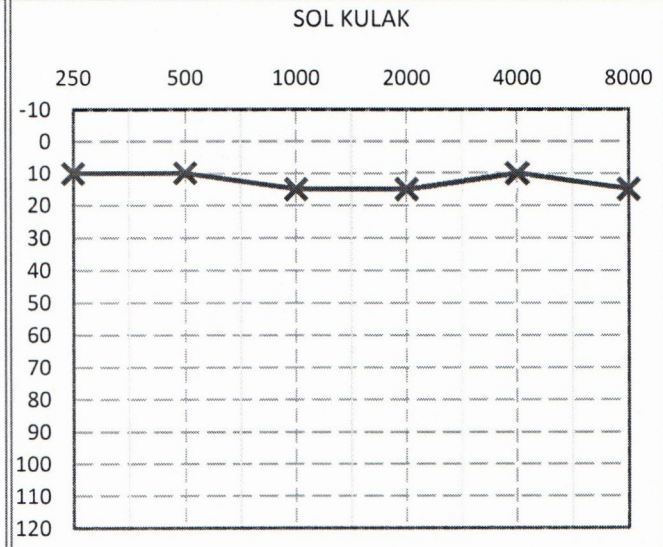

ADI SOYADI : ASLI ALTINTAŞ
DOĞUM TARİHİ :
SİCİL NO :

PROTOKOL NO : 25724 / 23072
FİRMA ADI :
TARİH : 01/02/2025.

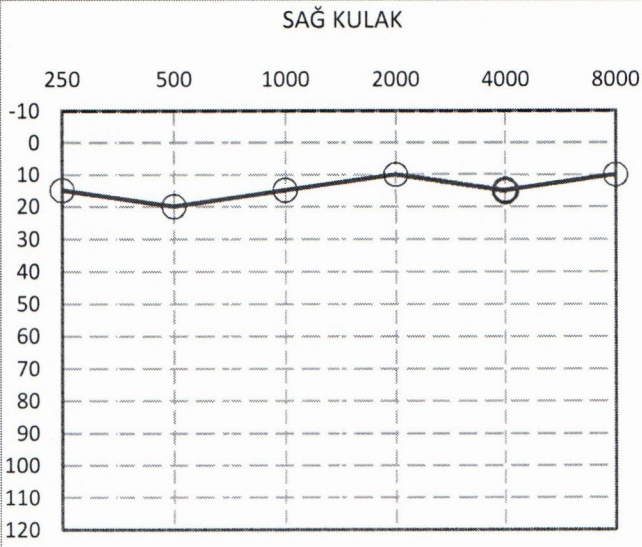

SAĞ KULAK İŞİTME FREKANSLARI			HAVA YOLU	KEMİK YOLU	
1	SAĞ KULAK	250	15		dB
2	SAĞ KULAK	500	20		dB
3	SAĞ KULAK	1000	15		dB
4	SAĞ KULAK	2000	10		dB
5	SAĞ KULAK	4000	15		dB
6	SAĞ KULAK	8000	10		dB

SOL KULAK İŞİTME FREKANSLARI			HAVA YOLU	KEMİK YOLU	
1	SOL KULAK	250	10		dB
2	SOL KULAK	500	10		dB
3	SOL KULAK	1000	15		dB
4	SOL KULAK	2000	15		dB
5	SOL KULAK	4000	10		dB
6	SOL KULAK	8000	15		dB

NORMAL

Sağ kulak saf ses ortalaması normal sınırlardadır.

Sol kulak saf ses ortalaması normal sınırlardadır.

SAĞ KULAK		SOL KULAK	
O	Maskesiz Hava Yolu	X	
O	Maskeli Hava Yolu	X	
<	Maskesiz Kemik Yolu	>	
[Maskeli Kemik Yolu]	

	SAĞ KULAK	SOL KULAK
SAF SES ORTALAMASI (dB) HAVA YOLU (500-2000 Hz)	15 dB	13 dB
SAF SES ORTALAMASI (dB) KEMİK YOLU (500-2000 Hz)	dB	dB

Özlem KÜTÜK

Odyometrist

Dip. No: 31-16210

BİR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ SAN. TİC. A.Ş

Altunizade Mah. Tophanelioğlu Cad. No:2 K:2 Üsküdar/İstanbul

Web: www.birosgb.com E-mail: info@birosgb.com Tel: 0850 466 67 42 - 0216 344 20 70 - 0216 443 04 99 Faks: 0216 443 04 95