Spectral Scans

517

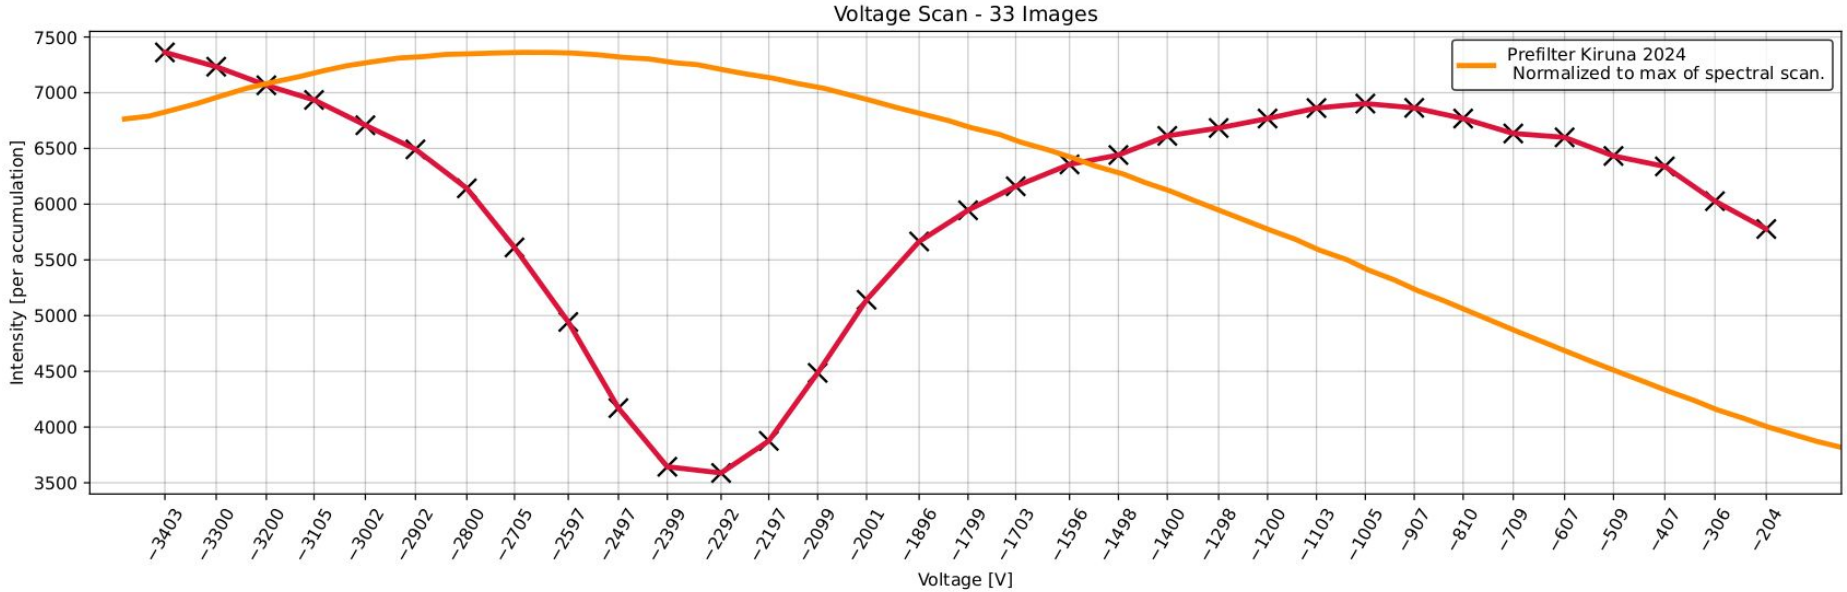
Voltage Scan - 33 Images
Prefilter Kiruna 2024
Normalized to max of spectral scan.
Intensity [per accumulation]
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
Voltage [V]
−3403
−3300
−3200
−3105
−3002
−2902
−2800
−2705
−2597
−2497
−2399
−2292
−2197
−2099
−2001
−1896
−1799
−1703
−1596
−1498
−1400
−1298
−1200
−1103
−1005
−907
−810
−709
−607
−509
−407
−306
−204

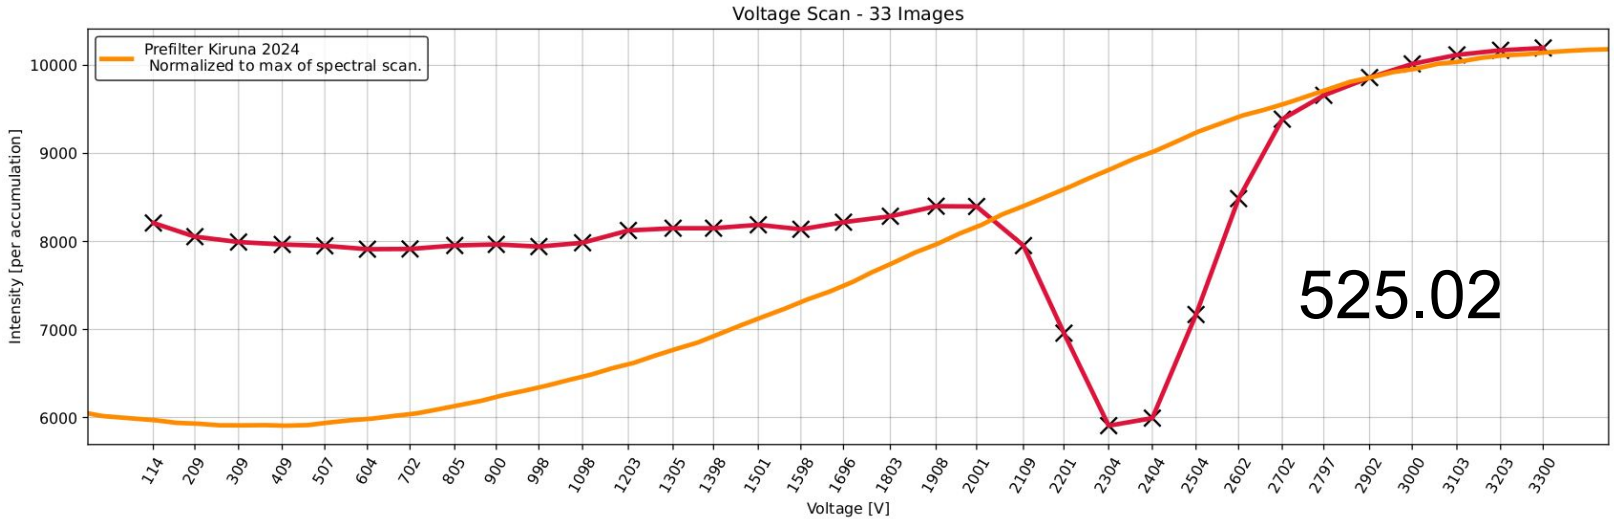
Voltage Scan - 33 Images
Prefilter Kiruna 2024
Normalized to max of spectral scan.
Intensity [per accumulation]
Voltage [V]
525.02

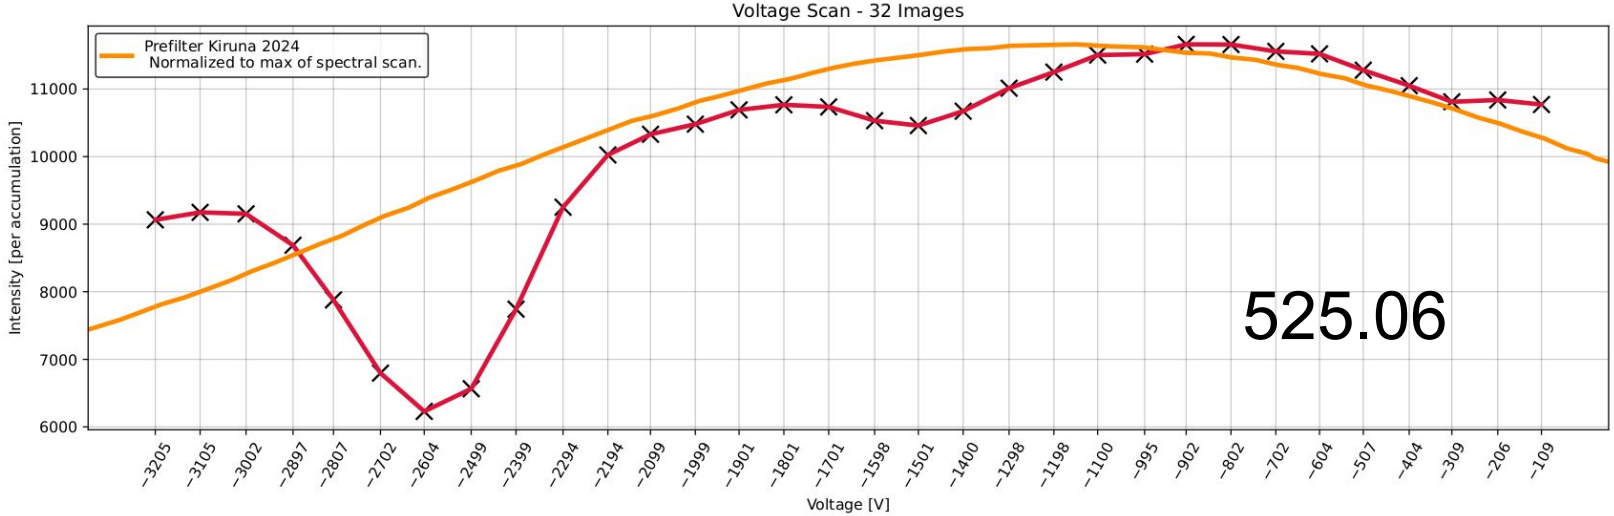
Voltage Scan - 32 Images
Prefilter Kiruna 2024
Normalized to max of spectral scan.
Intensity [per accumulation]
Voltage [V]
525.06

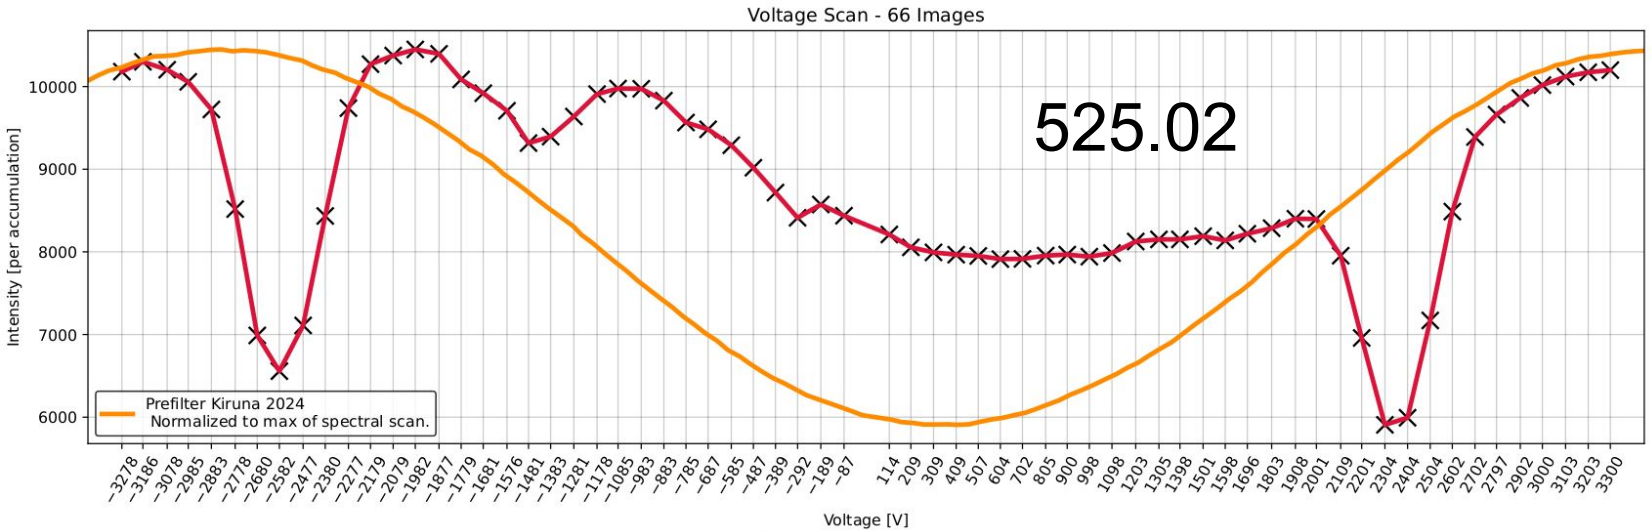
Voltage Scan - 66 Images
525.02
Intensity [per accumulation]
Voltage [V]
Prefilter Kiruna 2024
Normalized to max of spectral scan.

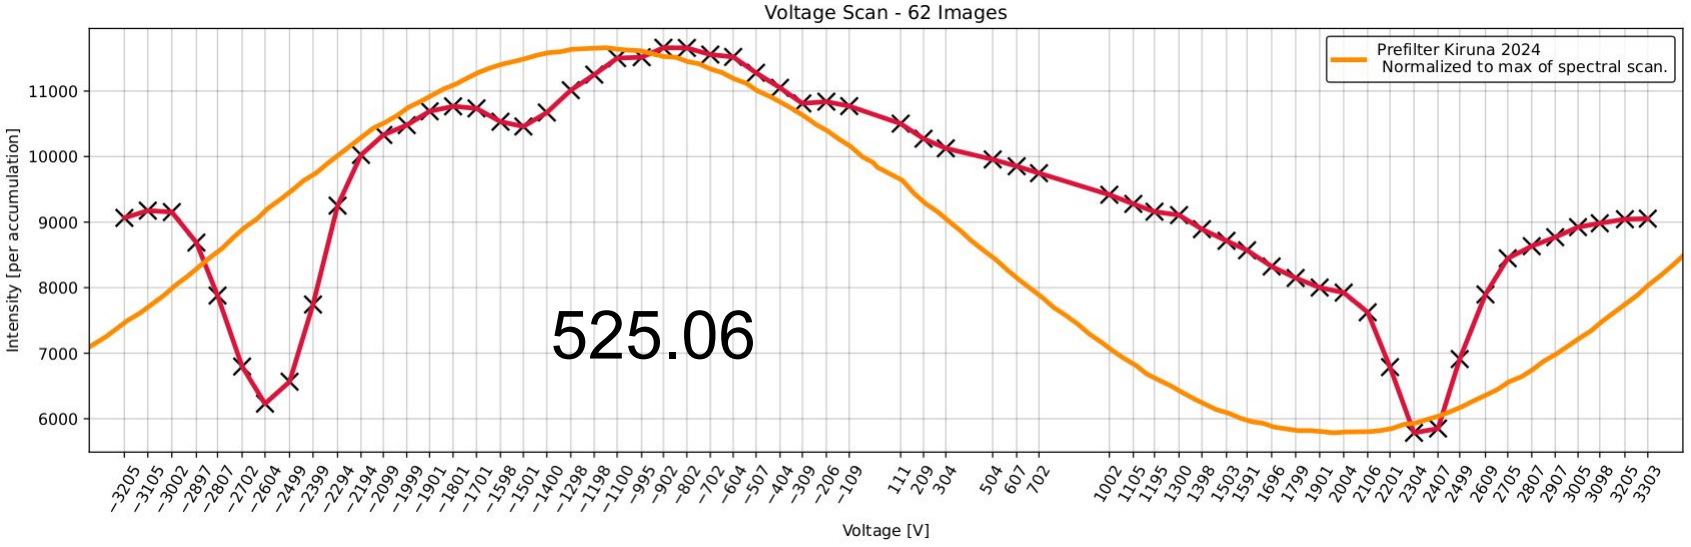
Voltage Scan - 62 Images
525.06
Intensity [per accumulation]
Voltage [V]
Prefilter Kiruna 2024
Normalized to max of spectral scan.