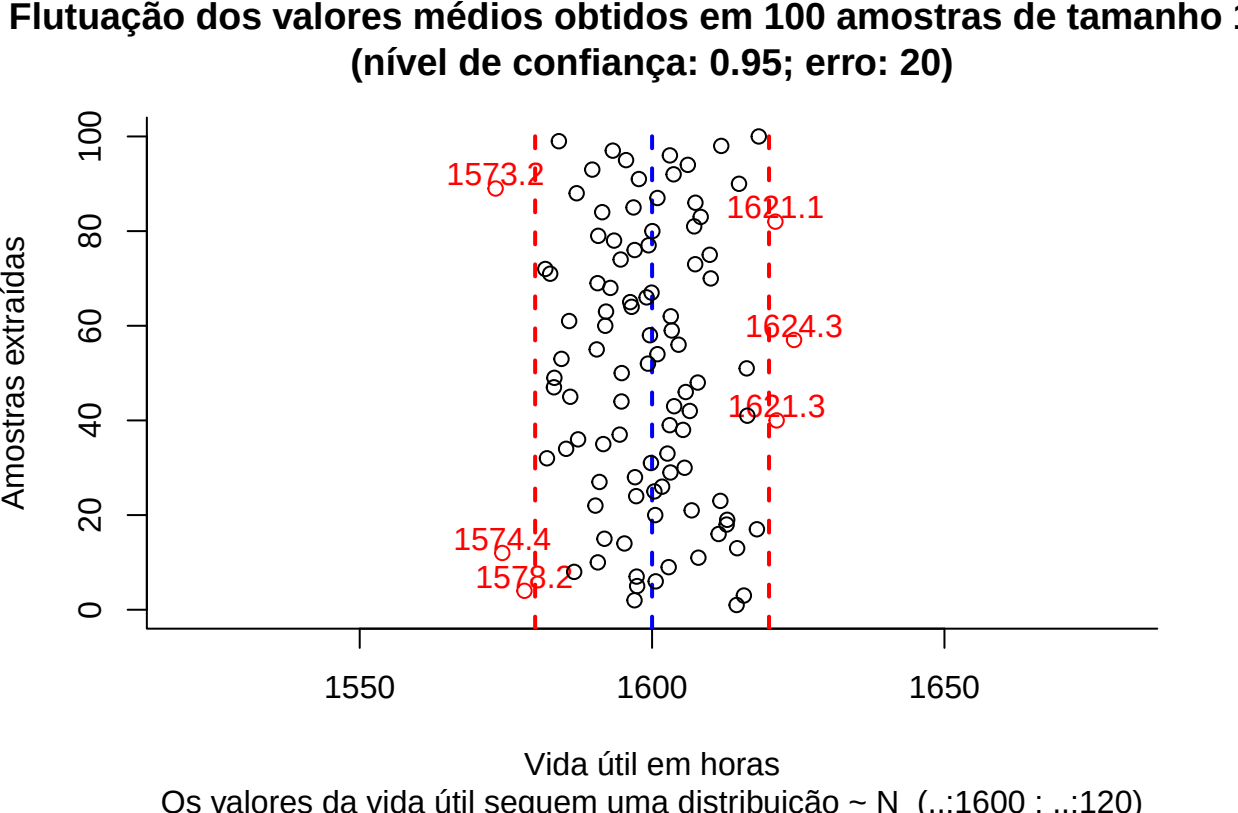
Flutuação dos valores médios obtidos em 100 amostras de tamanho 1
(nível de confiança: 0.95; erro: 20)
Amostras extraídas
0
20
40
60
80
100
1573.2
1621.1
1624.3
1621.3
1574.4
1573.2
1550
1600
1650
Vida útil em horas
Os valores da vida útil seguem uma distribuição ~ N (..:1600 ; ..:120)