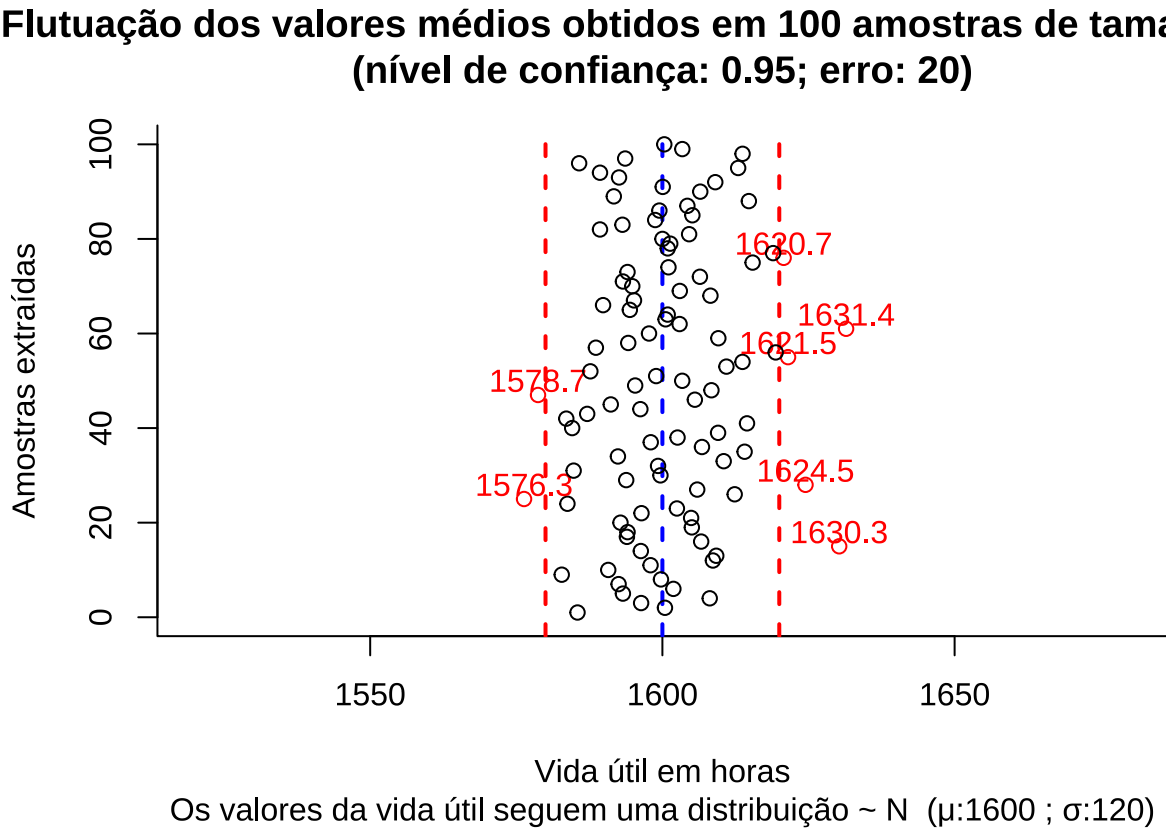
Flutuação dos valores médios obtidos em 100 amostras de tamanho
(nível de confiança: 0.95; erro: 20)
Amostras extraídas
0
20
40
60
80
100
1550
1600
1650
1630.7
1631.4
1621.5
1578.7
1624.5
1576.3
1630.3
Vida útil em horas
Os valores da vida útil seguem uma distribuição ~ N (μ:1600 ; σ:120)