

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO CO-220701

Cliente: REI DOS PALETES CONSULTORIA LTDA
Endereço: AV COLOMBO BAIOCCHI FILHO S/N QUADRA 01 LOTE 14 RESIDENCIAL MONTE SINAI ANAPOLIS GO CNPJ:50.772.645/0001-10

CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO

Instrumento:	Manômetro		
Localização:	casa de compressor		
Fabricante:	N/C	Faixa Instrumento:	0 a 14 kgf/cm ² / 0 a 200 psi
Modelo:	RETO	Faixa Operação:	0 a 12 kgf/cm ² / 0 a 150 psi
Tipo:	Analogico	Resolução:	0,2 kgf/cm ² / 5 psi
TAG:	MAN 03	LEP:	- / -
Código:	N/C	Índice de Classe:	2 %
Nº Série:	N/C	Data Aferição:	22/07/2026
Patrimônio:	N/C	Próxima Calibração:	22/07/2028

PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO

PADRÃO - 01		PADRÃO - 02	
Instrumento:	Manovacuômetro digital	Instrumento:	TERMOHIGRÔMETRO
Nº Certificado:	2025-09496	Nº Certificado:	T2334/2024
Fabricante:	ASTA	Fabricante:	MINIPA
Modelo:	N/C	Modelo:	MT-241
Tipo:	DIGITAL	Tipo:	DIGITAL
Identificação:	PI-04	Identificação:	THM-001
Faixa Instrumento:	-1 a 20 kgf/cm ²	Faixa Instrumento:	0 a 100 %UR
Resolução:	0,1 kgf/cm ²	Resolução:	0,1 %UR
Incerteza:	0,006 %	Incerteza:	0,2 %
Data Calibração:	09-set.-25	Data Calibração:	18-out-24
Próxima Calibração:	setembro-27	Próxima Calibração:	outubro-27

PADRÃO - 03		PADRÃO - 04	
Instrumento:	-	Instrumento:	-
Nº Certificado:	-	Nº Certificado:	-
Fabricante:	-	Fabricante:	-
Modelo:	-	Modelo:	-
Tipo:	-	Tipo:	-
Identificação:	-	Identificação:	-
Faixa Instrumento:	-	Faixa Instrumento:	-
Resolução:	-	Resolução:	-
Incerteza:	-	Incerteza:	-
Data Calibração:	-	Data Calibração:	-
Próxima Calibração:	-	Próxima Calibração:	-

PROCEDIMENTO UTILIZADO NA CALIBRAÇÃO

Nº PROCEDIMENTO	TEMPERATURA AMBIENTE	UMIDADE RELATIVA DO AR
PO-003-CO	32,0 °C	45,0 %

RESULTADOS DA MEDIÇÃO

RECEBIMENTO	VALOR DO PADRÃO		VALOR INSTRUMENTO EM TESTE (kgf/cm ²)			
	psi	kgf/cm ²	PRIMEIRO CICLO		SEGUNDO CICLO	
			SUBIDA	DESCIDA	SUBIDA	DESCIDA
0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2,0	28	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4,0	56	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
6,0	85	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
8,0	113	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

DATA EMISSÃO

22/07/2026

EXECUTANTE

Kleiton ferreira

APROVADO

Weenys Ribeiro da Cunha Junior

PÁGINA


1 / 2

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO CO-220701

RESULTADOS DA MEDIÇÃO

Padrão		Manômetro em Calibração	Média do Erro de Indicação	Incerteza Combinada	Histerese	Incerteza Expandida (U) ±	k
Indicação (1)		Média (2)	= (1) - (2)				
kgf/cm ²	Mpa	kgf/cm ²	kgf/cm ²	kgf/cm ²	kgf/cm ²	kgf/cm ²	
0,000	0,000	0,000	0,000	0,065	0,000	0,129	2,00
2,000	0,196	1,995	0,005	0,065	0,009	0,131	2,00
4,000	0,392	4,005	0,005	0,065	0,009	0,131	2,00
6,000	0,588	5,995	0,005	0,065	0,009	0,131	2,00
8,000	0,785	8,000	0,000	0,066	0,012	0,132	2,00

Curva de Erro de Indicação

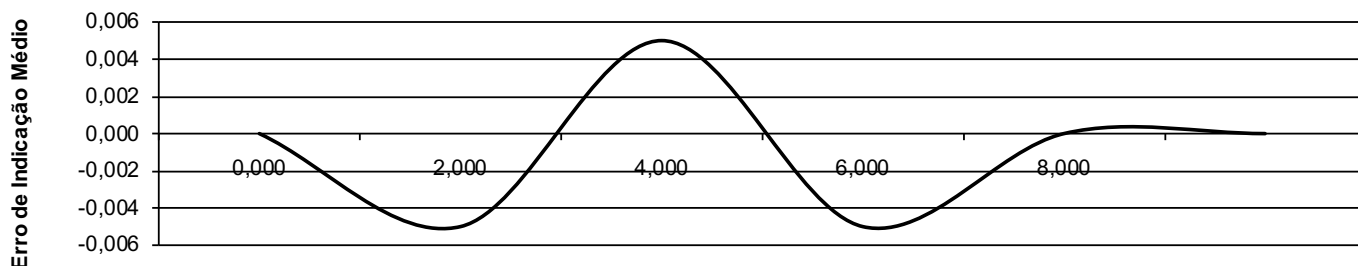

Indicação do Instrumento em Calibração
Unidade do Gráfico: kgf/cm²

RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Incerteza Combinada:	0,066 kgf/cm ²	Histerese:	0,012 kgf/cm ²	Repetitividade:	0,000 kgf/cm ²
Incerteza da Expandida:	0,132 kgf/cm ²				

OBSERVAÇÕES

- * A Curva de Correção é $Y = (1,000)X + (-0,001)$; onde Y = Valor de Referência Corrigido e X = Valor Indicado Pelo Instrumento.
* A Incerteza da Medição foi calculada para um Nível de Confiança de 95% e um Fator de Abrangência (K = 2,00).

DATA EMISSÃO	EXECUTANTE	APROVADO	PÁGINA
22/07/2026	Kleiton ferreira	Weenys Ribeiro da Cunha Junior	2 / 2

- 1) Este certificado é válido exclusivamente para o instrumento submetido à calibração, nas condições específicas.
2) A calibração foi executada em dois ciclos conforme o procedimento: PO-003-CO, do laboratório.
3) Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico, estabelecido na regulamentação metrológica.
4) Este certificado não deve ser parcialmente reproduzido.