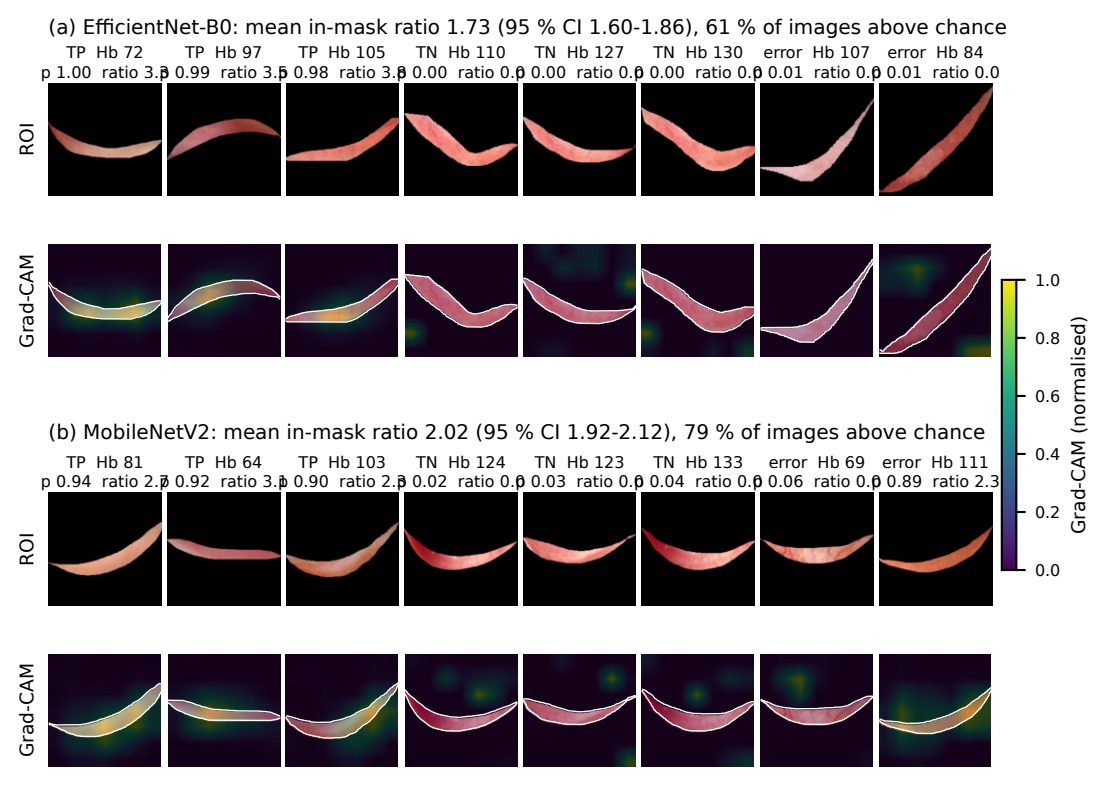

(a) EfficientNet-B0: mean in-mask ratio 1.73 (95 % CI 1.60-1.86), 61 % of images above chance
TP Hb 72 p 1.00 ratio 3.3
TP Hb 97 p 0.99 ratio 3.5
TP Hb 105 p 0.98 ratio 3.8
TN Hb 110 p 0.00 ratio 0.0
TN Hb 127 p 0.00 ratio 0.0
TN Hb 130 p 0.00 ratio 0.0
error Hb 107 p 0.01 ratio 0.0
error Hb 84 p 0.01 ratio 0.0
ROI
Grad-CAM
(b) MobileNetV2: mean in-mask ratio 2.02 (95 % CI 1.92-2.12), 79 % of images above chance
TP Hb 81 p 0.94 ratio 2.7
TP Hb 64 p 0.92 ratio 3.0
TP Hb 103 p 0.90 ratio 2.3
TN Hb 124 p 0.02 ratio 0.0
TN Hb 123 p 0.03 ratio 0.0
TN Hb 133 p 0.04 ratio 0.0
error Hb 69 p 0.06 ratio 0.0
error Hb 111 p 0.89 ratio 2.3
ROI
Grad-CAM
Grad-CAM (normalised)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0