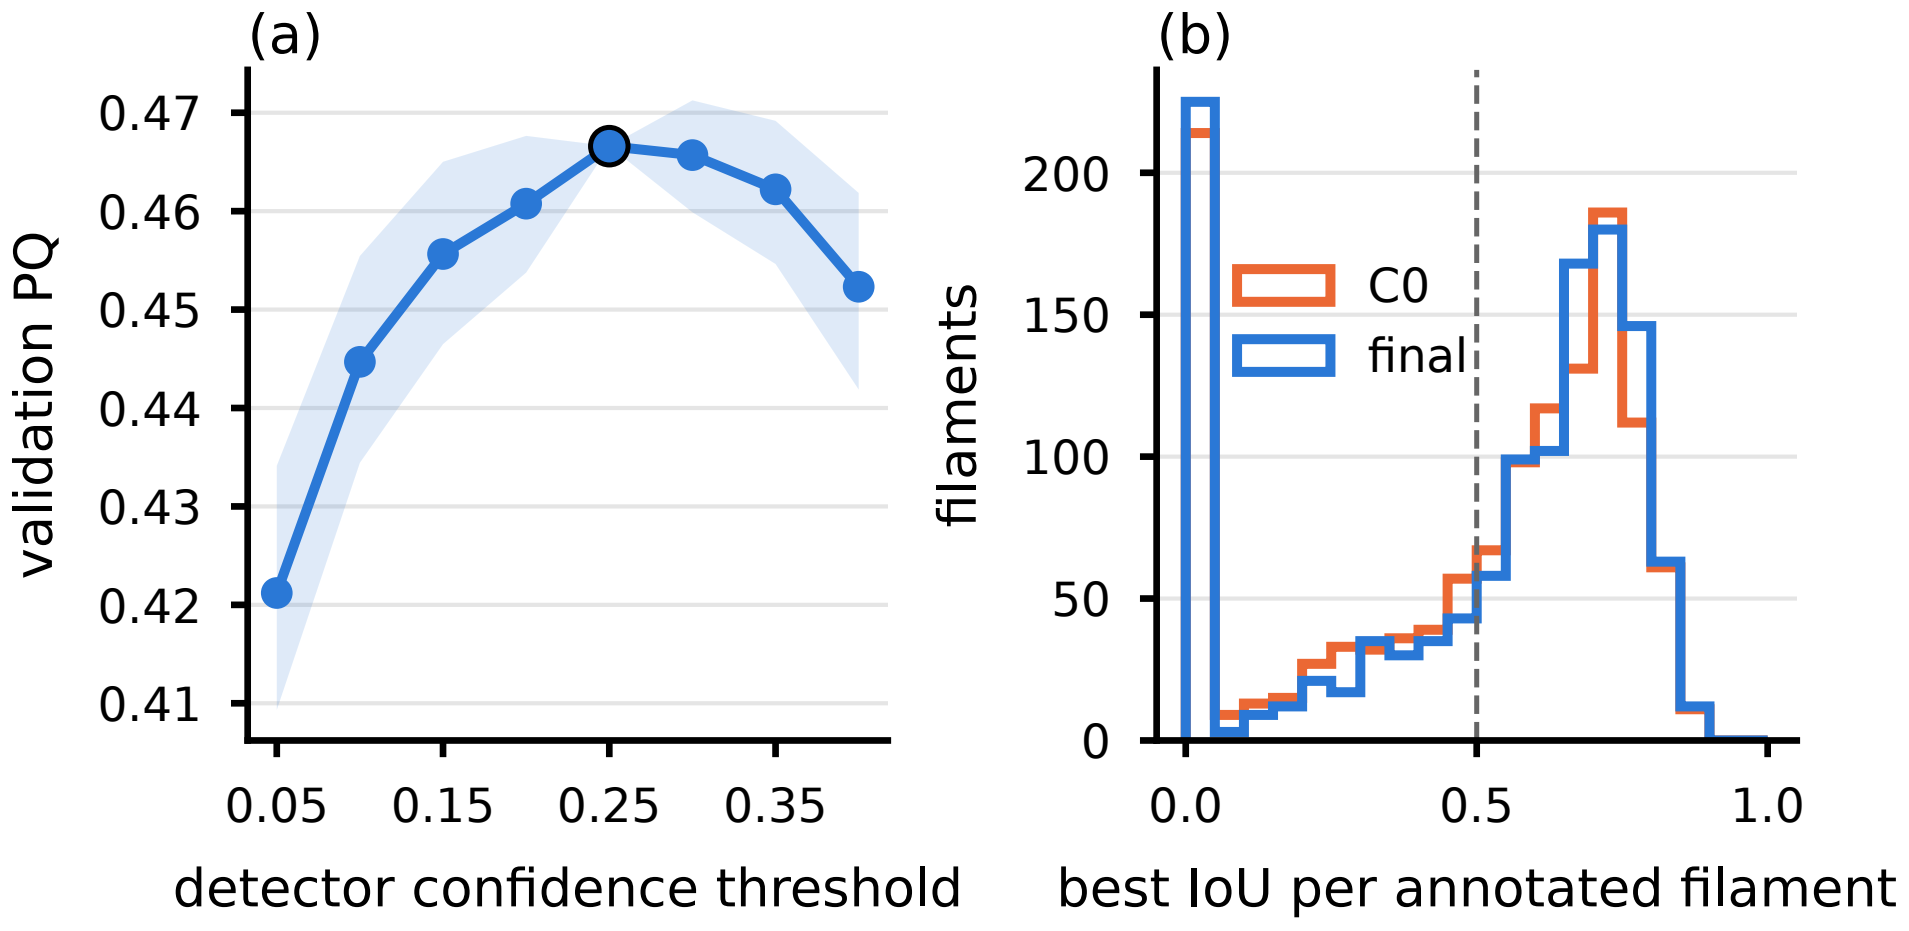
(a)
validation PQ
0.47
0.46
0.45
0.44
0.43
0.42
0.41
0.05
0.15
0.25
0.35
detector confidence threshold
(b)
filaments
200
150
100
50
0
C0
final
0.0
0.5
1.0
best IoU per annotated filament