FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Cotización No.

Fecha:

Lugar:

Equipo: ARIETTA 850

Vigencia:



FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Estimado _____

Muchas gracias por su interés en adquirir tecnología FUJIFILM. Atendiendo a su reciente petición, nos es grato extender la presente propuesta para el equipo de Ultrasonido modelo ARIETTA 850 de la marca Fujifilm. A continuación, se describen las características que componen en su totalidad la adquisición del equipo.

Especificaciones Técnicas



Sistema de Ultrasonido para estudios de todas las regiones anatómicas.

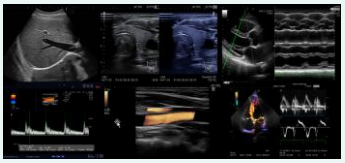
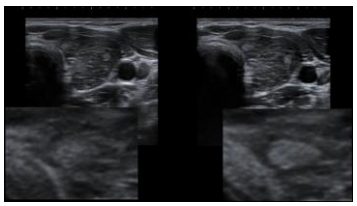
El equipo presenta las siguientes especificaciones técnicas:

Característica	Descripción
Monitor principal	Pantalla Full HD de 22 pulgadas OLED. Montado en brazo completamente articulado.

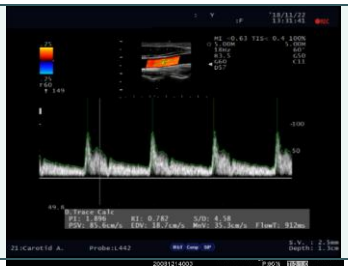
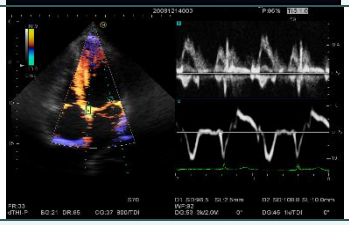
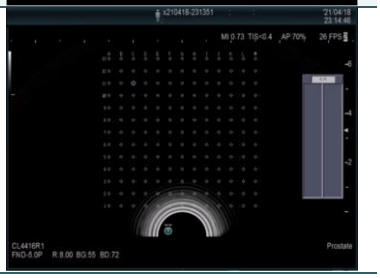
FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

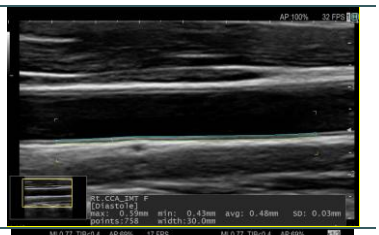
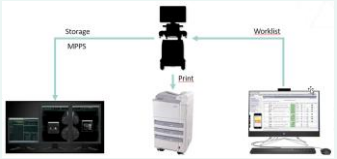
Pantalla Touch	Pantalla de Cristal Líquido (LCD) TFT de 10.4 pulgadas.
Memoria	Disco Duro Integrado de 1 TB
Panel de control	Panel de control con ajuste de altura y giro. Teclado físico integrado.
Puertos para transductor	6 puertos para transductores (4 activos)
Espacio de almacenamiento	Bandeja trasera de almacenamiento.
Portatransductores	7 portatransductores.
Ruedas con freno	4 ruedas con freno.
Suministro Eléctrico	El equipo requiere de una alimentación eléctrica convencional (bifásica) de 100-120/200-240 ±10. Con una potencia eléctrica de 0.9 a 1.3 kVA y frecuencia de 50/60 Hz.

Funciones incluidas

Característica	Descripción	Muestra
Modos de operación y visualización	Modo B, Modo M, Doppler Color (Color Flow Mode), Doppler espectral, Power Doppler, Doppler tisular, Modo M anatómico, Imagen trapezoidal, HI Zoom, Imagen Panorámica.	
Funciones de procesamiento y mejora de imagen	Tissue Harmonic Imaging, HI Rez, Acoustic Noise Reduction, Near-field Noise Reduction, Low Echo Reduction, HI Frame, Grayscale Enhancement, Compound Imaging, B-Steer, Auto Optimizer (Modo B, Doppler espectral, Doppler color), Automated Angle Correction (Doppler espectral), Tissue Adaptive Technology, Carving Imaging, eFocusing, Wide Scanning.	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

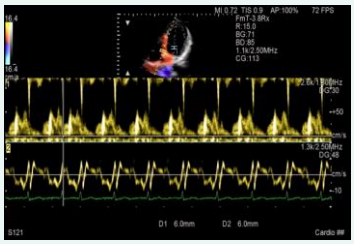
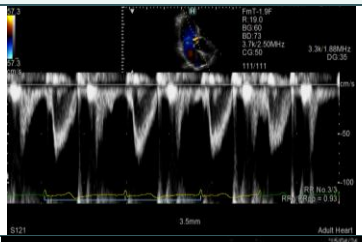
Real-time Doppler Auto Trace	Trazo y cálculos automáticos de Doppler espectral en tiempo real.	
Dual Gate Doppler	Esta función despliega el espectro Doppler de dos muestras o regiones de interés diferentes de manera simultánea.	
eFlow	eFLOW es un modo de adquisición de imágenes de alta definición del flujo sanguíneo que incorpora mejoras radicales en la resolución temporal y espacial. Con eFLOW, es posible mostrar la información del flujo sanguíneo con una mayor sensibilidad y resolución que con los métodos tradicionales.	
Needle Emphasis	Software de realce de aguja, disponible en transductores convexos, lineales y endocavitarios (C22K, C252, C253, C251, C35, C421 C42, C42K, C421, C22P, C23, C23RV, C25P, L34, L35, L441, L55, L64, C41B, C41RP, C41V1, CC41R, CC41R1, CC41R2).	
Marking assist	Esta función permite el despliegue en pantalla de líneas de referencia de acuerdo a marcas en transductor, disponible en transductores lineales (L35, L442, L64).	
Brachy Grid Display	Esta función muestra en pantalla una cuadrícula para braquiterapia, compatible con transductores biplanares (C41L47RP, CL4416R, CL4416R1).	

Automated IMT Measurement software	Este software posibilita la evaluación automática de la íntima media carotídea	
Dynamic Slow-motion Display software	Esta función posibilita la visualización de imagen en tiempo real y cámara lenta, lado a lado, útil para visualización de corazón fetal o embrionario.	
Automated OB Measurement software	Automated OB Measurement (Auto GA) proporciona mediciones automáticas por detección de imágenes de las medidas fetales: DBP, DOF, CC, CA, DPTA, DTT, DTA, FTA, LF.	
Protocol Assistant software	Protocol Assistant brinda la capacidad de guiar y ahorrar tiempo del estudio al mostrar una lista estandarizada del protocolo de una manera eficiente y reproducible. Cuenta con protocolos pre-programados que pueden ser editados y con la capacidad de programar nuevos protocolos.	
DICOM network software	Esta opción habilita las licencias permanentes de DICOM Storage, DICOM Print, DICOM Worklist y DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS).	

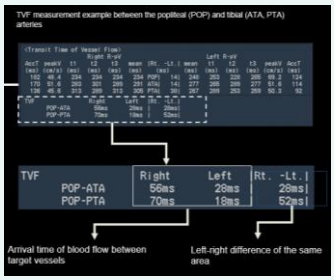
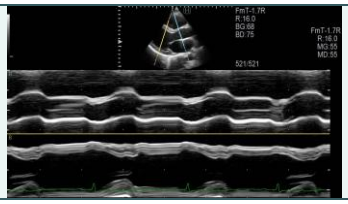
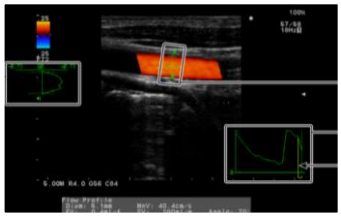
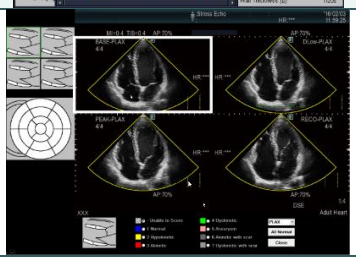
Opcionales

Característica	Descripción	Muestra
B/W Printer Connection kit	Kit de conexión para impresoras integradas al carro del ultrasonido marca Sony o Mitsubishi (UP-X898MD, P95DW, P95DE). Incluye cable USB y cable de alimentación eléctrica.	

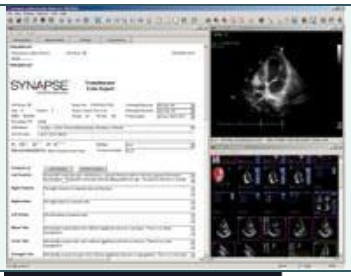
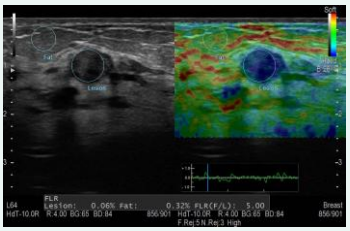
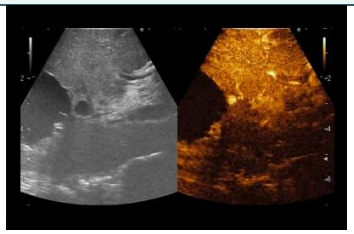
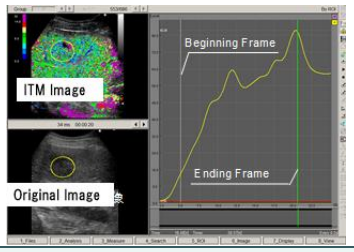
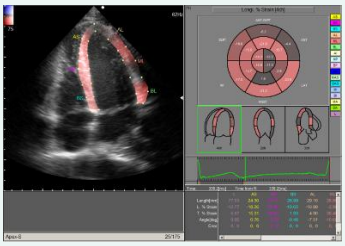
FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Triple Foot Switch	Pedal para manejo del equipo, con tres interruptores programables.	
Jelly Warmer (AC adopter, Mount kit)	Calentador de gel integrado al equipo. Necesita del adaptador de alimentación eléctrica y kit de montaje.	
Endo-cavity Probe holder kit	Portatransductor para transductor endocavitario	
PEU hardware	Módulo fisiológico integrado en el equipo para despliegue en pantalla de señal de ECG y onda respiratoria. Señales de ECG disponibles: I, II y III. Incluye cable de 3 derivaciones. Necesario para todas las funciones cardiológicas avanzadas.	
CW Servo Unit	Esta opción habilita la adquisición de Doppler continuo y permite la instalación del software Real-time 3D.	
Picture in Picture	Opción para visualización Picture in Picture en la pantalla del equipo de ultrasonido. Útil en procedimientos de endoscopia e intervencionismo.	
Performance Acceleration unit	Unidad de aceleración del desempeño. Necesaria para cardiología 3D/4D e iEF.	

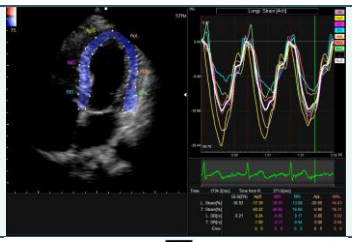
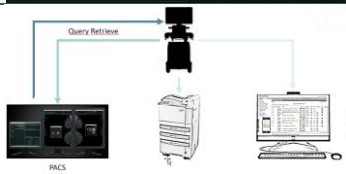
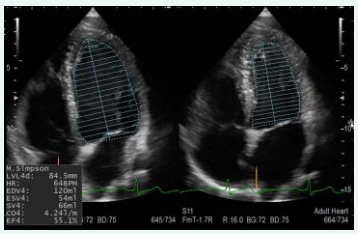
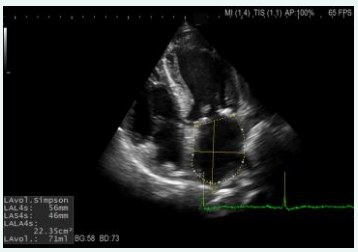
FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Transit Time of Vessel Flow measurement software	TVF habilita un procedimiento guiado sencillo para el cálculo de tiempo de tránsito de flujo vascular, el cual a través de una comparación temporal entre las extremidades permite identificar con claridad si una estenosis crea, y dónde lo hace, un retraso del flujo máximo. Con trazo de onda y visualización de resultados.	
Real-time 3D	Real time 3D en conjunto con la unidad CW servo unit y un transductor 3D/4D permite generar imágenes en 3D en tiempo real (4D). Incluye las funciones de OB Snap Shot, Reconstrucción Multi-Planar (MPR), cortes tomográficos (Multi Slice Imaging) y simulación de fuente de luz y sombras (4Dshading). La opción CW servo unit es un prerrequisito para este software.	
FAM software	Free Angular M-mode o Modo M anatómico permite la formación de hasta 3 imágenes simultáneas en Modo M a partir de cualquier ángulo.	
Flow Profile Measurement software	Flow Profile es un software de medición del volumen instantáneo de flujo sanguíneo del sistema vascular periférico, calculado a través de los valores de velocidad de flujo del perfil unidimensional detectados a partir de Doppler Color.	
TDI Analysis software	Tissue Doppler Imaging Analysis brinda la medición de la velocidad de movimiento de los segmentos del miocardio e información de torsión (strain, strain rate) a partir de Doppler Tisular.	
Stress Echo software	Stress Echo Analysis permite adquirir y evaluar protocolos de eco estrés por banda de esfuerzo, farmacológico y protocolos programables por usuario. Permite adquisición sincronizada con señal ECG.	

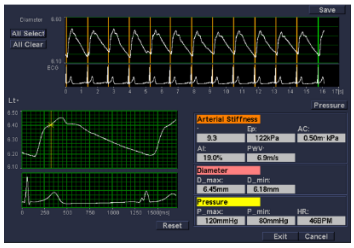
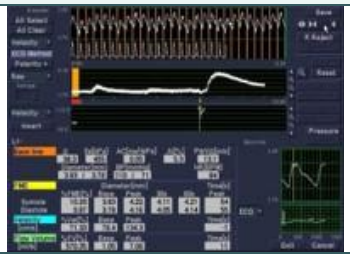
FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

DICOM Structure Report software	Esta licencia habilita el envío de Reportes Estructurados por medio de protocolo DICOM	
Automated NT Measurement software	Automated NT permite obtener de manera automática la medición de translucencia nucal	
Real-time Tissue Elastography software	RTE permite evaluar la rigidez de un tejido en tiempo real a través de un mapa de colores y de la medición de Strain Ratio. Incluye Auto Select Frame para la selección automática de cuadros con presión estable y Assist Strain Ratio para el posicionamiento automático de ROI en tejido graso.	
Contrast Harmonic Imaging software	CHI es un software para la formación de imágenes por medio de contraste a partir de la detección de los ecos armónicos generados por los mismos. Incluye función de acumulación, análisis por Curva de Intensidad en el tiempo (TIC) y Substracción de imágenes. Disponible en transductores convexos, endocavitarios, lineales y sectoriales (C252, C253, C35, C22P, C23, C23RV, C25P, C41V, C41V1, C41B, CC41R, C22I, C22K, C22T, C42T, L34, L35, L441, L442, L55, L43K, L44K, L46K1, L51K, L44LA, S121).	 
2D Tissue Tracking Analysis software	2DTT es un software de evaluación de la movilidad de la pared cardiaca o strain, a partir de speckle tracking. Es posible evaluar diversas estructuras como el miocardio y las válvulas. 2DTT proporciona mediciones cuantitativas e información precisas, como: Strain, strain rate, Strain Global Longitudinal (GLS), strain radial y circunferencial, Torsión (twist)	

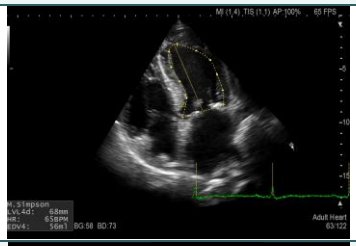
FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

	desplazamiento y grosor de la pared, entre otros.	
DICOM Query/Retrieve software	Esta licencia habilita la recuperación de estudios por medio de protocolo DICOM.	
RTE Strain Histogram software	Esta licencia, complementaria a Real-time Tissue Elastography, activa las funciones de Histograma y Liver Fibrosis Index, el cual calcula el valor estimado de fibrosis en pacientes con hepatitis C.	
Shear Wave Measurement software	SWM es un software de Elastografía point Shear Wave y 2D Shear Wave compatible con los transductores C251 y C253. Muestra la medición en m/s y kP, rango intercuartil y tasa de efectividad (VsN) que proporciona un indicador de confiabilidad. Adicionalmente SWM habilita el software Attenuation, para evaluación de esteatosis o hígado graso por atenuación.	
Automated Cardiac Measurement software	Permite mediciones automáticas en modo 2D de Ventrículo Izquierdo: Volúmenes, gasto cardiaco, fracción de eyección, IVS, LVID, LVPW ; así como trazo automático de la cavidad cardiaca, Aurícula izquierda, Aurícula derecha, área VD, FAC y en Modo M de AoDd, LAD, LA/AO. Se puede usar en conjunto con la función de Detección Automática de fin de diástole y fin de sístole. La opción Physiological Signal Unit es un prerrequisito para la opción de medidas cardiológicas automáticas.	 

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

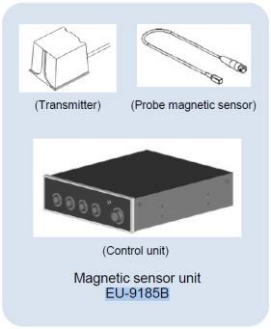
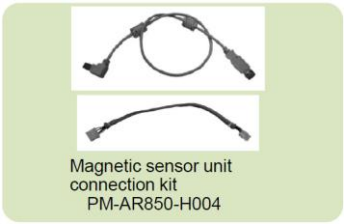
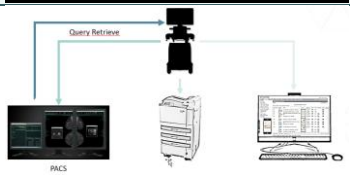
Detective Flow Imaging Software	DFI genera imágenes en Color de acuerdo con la intensidad de la señal. El flujo sanguíneo se muestra con un alto frame rate y es mínimamente afectado por los movimientos que el paciente pudiera hacer.	
EyeballEF	EyeballEF detecta los bordes y muestra en tiempo real los volúmenes y la Fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo, latido a latido.	
eTracking	eTracking calcula los índices de ateroesclerosis relacionados a las características elásticas de los vasos sanguíneos, a partir del diámetro del vaso y los valores de presión arterial. Necesita del módulo de ECG (PEU hardware)	
Wave Intensity	La intensidad de onda (Wave Intensity) es un nuevo índice hemodinámico que puede evaluar el desempeño cardiovascular al brindar información acerca del comportamiento dinámico e interacción del corazón y el sistema vascular. La intensidad de onda es calculada en función de los cambios que experimentan la presión arterial y la velocidad del flujo sanguíneo, registrados en un punto arbitrario del sistema circulatorio. Necesita del módulo de ECG (PEU hardware)	
FMD	Flow Mediated Dilatation (FMD) es usado para la evaluación funcional de los vasos sanguíneos antes de que ocurran cambios orgánicos.	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

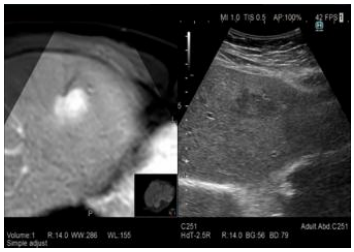
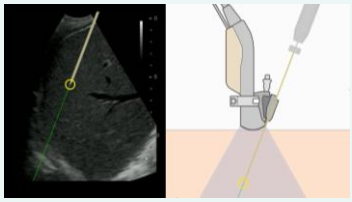
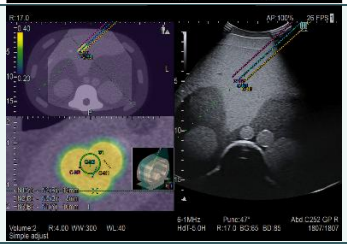
Cardiac 3D B Software	La función Cardiac 3D (4D) brinda la capacidad de desplegar imágenes cardiológicas 3D y mostrar imagen dual simultánea (Imagen de referencia e imagen biplanar). La unidad Performance Acceleration unit es un prerrequisito para esta función.	
iEF software	iEF calcula la Fracción de Eyección biplanar de manera con detección de cuadro ED/ES y reconocimiento de bordes de las vistas A2C y A4C. iEF software necesita la unidad Performance Acceleration unit.	
Automated FS Measurement	Esta función posibilita la extracción automática de la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo fetal.	
Automated FHR measurement	Medición automática de frecuencia cardiaca fetal a partir de imágenes de modo B en tiempo real.	
McAfee Embedded Control software	Opción de Antivirus integrado en el equipo. McAfee es una marca registrada de McAfee LCC en los Estados Unidos y otros países.	McAfee

Paquete opcional para Real-Time Virtual Sonography y Needle Tracking

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Magnetic sensor unit (Obligatorio)	Incluye Unidad de control, Transmisor y sensor magnético para transductor.	
Magnetic sensor unit connection kit (Obligatorio)	Kit de conexión para el Magnetic Sensor Unit.	
RVS flexible stand (Obligatorio)	Pedestal móvil para posicionamiento del transmisor.	
Real-time Virtual Sonography (Obligatorio)	Licencia necesaria para habilitar la función Real-time Virtual Sonography (RVS) que permite la sincronización del ultrasonido con los volúmenes de CT o MR.	
DICOM Query/Retrieve software (Opcional)	Esta licencia habilita la recuperación de estudios por medio de protocolo DICOM.	
Magnetic sensor For Tracking (Opcional)	El Sensor magnético para rastreo es necesario para utilizar Body Motion Tracking o Needle Tracking.	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Body Motion Tracking	La función Body Motion Tracking, en conjunto con el accesorio omniTRAX Active Patient Tracker (no incluido, fabricado por CIVCO), brinda Registro automático de imágenes fusionadas con ajuste continuo de la sincronización, incluso con movimientos ligeros del paciente o el transmisor.	
Needle Tracking (Opcional)	Needle Tracking rastrea y muestra la localización de la punta de la aguja en tiempo real. Útil durante Ablación por Radiofrecuencia, entre otros procedimientos. Necesita VirtuTRAX Instrument Navigator 610-1059 (No incluido, fabricado por CIVCO) y aditamento de guía de biopsia para cada transductor.	
Volume Data Extension y 3D Sim-Navigator (Opcional)	Muestra en pantalla simulaciones de datos reconstruidos por software de análisis de imágenes 3D, sincronizados con la imagen de ultrasonido en tiempo real. Además, habilita la visualización del plano coronal.	
E-field simulator	A partir de la localización de electrodos de Ablación por Radiofrecuencia guiada por ultrasonido, simula la distribución de la corriente eléctrica en un mapa de colores sobre las imágenes de Tomografía Computada.	
HDMI cable	Cable HDMI para conectar el Magnetic Sensor Unit y el sensor de posición magnética integrada al transductor C23RV.	
RVS Attachment for C252/C253 (Opcional)	Accesorio para utilizar el transductor convexo C252 o C253 con Real-time Virtual Sonography.	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

RVS Attachment for L64 (Opcional)	Accesorio para utilizar el transductor Lineal L64 con Real-time Virtual Sonography.	 RV-009 *1
RVS Attachment for L55 (Opcional)	Accesorio para utilizar el transductor Lineal L55 con Real-time Virtual Sonography.	 RV-008 *1
RVS Attachment for SML44 (Opcional)	Accesorio para utilizar el transductor Lineal SML44 con Real-time Virtual Sonography.	 RV-014 *1
RVS Attachment for C41V1 (Opcional)	Accesorio para utilizar el transductor endocavitario C41V1 con Real-time Virtual Sonography.	 RV-002 *1
RVS Attachment for CL4416R1 (Opcional)	Accesorio para utilizar el transductor endocavitario biplanar CL4416R1 con Real-time Virtual Sonography.	 RV-021 *1
RVS Attachment for CC41R1 (Opcional)	Accesorio para utilizar el transductor endocavitario biplanar CC41R1 con Real-time Virtual Sonography.	 RV-015 *1
RVS Attachment for _____ (Opcional)	Accesorio para utilizar el transductor _____ con Real-time Virtual Sonography.	

Paquete opcional para conexión de impresora a color Sony UP-D25MD

PM-LI880-H002 **Color printer connection kit**	Kit de conexión para impresora digital a color
MP-FX-AVA-30 **Mounting Rack of Color printer**	Soporte de montaje para Impresora digital a color Marca Sony Modelo UP-D25MD

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Paquete opcional para conexión de impresora a color Mitsubishi CP30DW

PM-LI880-H002 **Color printer connection kit**	Kit de conexión para impresora digital a color
MP-FX-AVA-31 **Mounting Rack of Color printer**	Soporte de montaje para Impresora digital a color Marca Mitsubishi Modelo CP30DW

Transductores y accesorios

C252	Transductor convexo de 1 a 6 MHz.	
C253	Transductor convexo de 1 a 5 MHz.	
C35	Transductor convexo de 2 a 8 MHz.	
C41	Transductor microconvexo de 4 a 13 MHz.	
C23	Transductor microconvexo de 1 a 6 MHz.	
C23RV	Transductor microconvexo de 1 a 6 MHz con sensor magnético integrado para RVS. Para su utilización con RVS es necesario el cable HDMI.	
C42K	Transductor convexo intraoperatorio de 4 a 10 MHz.	
C22P	Transductor microconvexo para biopsia, de 1 a 6 MHz.	
C25P	Transductor convexo para biopsia, de 1 a 5 MHz.	


FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

C22K	Transductor convexo intraoperatorio de 1 a 6 MHz.	
C42K	Transductor convexo intraoperatorio de 4 a 10 MHz.	
C42T	Transductor convexo intraoperatorio de 3 a 10 MHz	
C41V1	Transductor endocavitario de 2 a 10 MHz con 200° de campo de visión.	
C41V	Transductor endocavitario de 4 a 8 MHz con 200° de campo de visión.	
C41B	Transductor endocavitario de 2 a 10 MHz con 200° de campo de visión.	
C41RP	Transductor transrectal de 2 a 9 MHz con 180° de campo de visión.	
R41R	Transductor transrectal de 5 a 10 MHz y 360° de campo de visión.	
L442	Transductor lineal de 2 a 12 MHz.	
L34	Transductor lineal de 3 a 7 MHz.	
L35	Transductor lineal de 2 a 9 MHz.	
L55	Transductor lineal de 5 a 13 MHz.	
L64	Transductor lineal de 5 a 18 MHz.	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

L53K	Transductor lineal tipo hockey stick, intraoperatorio, de 3 a 15 MHz.	
L44K	Transductor lineal intraoperatorio de 2 a 14 MHz (42 mm).	
L46K1	Transductor lineal intraoperatorio de 2 a 14 MHz (63mm).	
L44LA	Transductor laparoscópico de 2 a 13 MHz.	
L43K	Transductor intraoperatorio de arreglo lineal compatible con Robot Da Vinci, de 2 a 12 MHz.	
L51K	Transductor intraoperatorio de arreglo lineal compatible con Robot Da Vinci, de 3 a 15 MHz.	
L31KP	Transductor de arreglo lineal intraoperatorio y para biopsias, de 2 a 9 MHz.	
S31KP	Transductor de arreglo sectorial intraoperatorio y para biopsias, de 3 a 8 MHz.	
S11	Transductor sectorial de 1 a 5 MHz.	
S121	Transductor sectorial de 1 a 5 MHz.	
S31	Transductor sectorial de 2 a 9 MHz.	
S42	Transductor sectorial de 3 a 14 MHz.	
S3ESEL	Transductor transesofágico de 2 a 8 MHz.	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

S3ESL1	Transductor transesofágico de 2 a 9 MHz.	
MXS1	Transductor sectorial transtorácico (TTE) 3D/4D. Necesita el Software Cardiac 3D B, la unidad Performance Acceleration unit y el hardware PEU.	
VC35	Transductor convexo 3D/4D de 2 a 8 MHz.	
VC41V	Transductor endocavitario 3D/4D de 2 a 8 MHz.	
CC41R	Transductor transrectal biplanar convexo-convexo de 4 a 8 MHz con 100° y 120° de campo de visión.	
CC41R1	Transductor transrectal biplanar convexo-convexo de 2 a 10 MHz con 180° de campo de visión.	
CL4416R1	Transductor transrectal biplanar convexo-lineal de 2 a 14 MHz y 180° de campo de visión en el arreglo convexo.	
C41L47RP	Transductor transrectal biplanar convexo-lineal de 4 a 10 MHz y 200° de campo de visión en el arreglo convexo.	
EZU-PA7V	Adaptador de punción para transductor C41V1	
EZU-PA3U	Accesorio de biopsia para transductor C41L47RP	
EZU-PA7L1	Soporte de guía de aguja para transductor L442	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

EZU-PA7L2	Soporte de guía de aguja para transductor L55	
EZU-PA7L3	Soporte de guía de aguja para transductor L64	
BA-001	Adaptador de punción para transductor CL4416R1	
C253	Transductor convexo de 1 a 5 MHz.	
C35	Transductor convexo de 2 a 8 MHz.	
C41	Transductor microconvexo de 4 a 13 MHz.	
C23	Transductor microconvexo de 1 a 6 MHz.	
C23RV	Transductor microconvexo de 1 a 6 MHz con sensor magnético integrado para RVS. Para su utilización con RVS es necesario el cable HDMI.	
C42K	Transductor convexo intraoperatorio de 4 a 10 MHz.	
C22P	Transductor microconvexo para biopsia, de 1 a 6 MHz.	
C25P	Transductor convexo para biopsia, de 1 a 5 MHz.	


FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

C22K	Transductor convexo intraoperatorio de 1 a 6 MHz.	
C42K	Transductor convexo intraoperatorio de 4 a 10 MHz.	
C42T	Transductor convexo intraoperatorio de 3 a 10 MHz	
C41V1	Transductor endocavitario de 2 a 10 MHz con 200° de campo de visión.	
C41V	Transductor endocavitario de 4 a 8 MHz con 200° de campo de visión.	
C41B	Transductor endocavitario de 2 a 10 MHz con 200° de campo de visión.	
C41RP	Transductor transrectal de 2 a 9 MHz con 180° de campo de visión.	
R41R	Transductor transrectal de 5 a 10 MHz y 360° de campo de visión.	
L442	Transductor lineal de 2 a 12 MHz.	
L34	Transductor lineal de 3 a 7 MHz.	
L55	Transductor lineal de 5 a 13 MHz.	
L64	Transductor lineal de 5 a 18 MHz.	
L53K	Transductor lineal tipo hockey stick, intraoperatorio, de 3 a 15 MHz.	
L44K	Transductor lineal intraoperatorio de 2 a 14 MHz (42 mm).	


FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

L46K1	Transductor lineal intraoperatorio de 2 a 14 MHz (63mm).	
L44LA	Transductor laparoscópico de 2 a 13 MHz.	
L43K	Transductor intraoperatorio de arreglo lineal compatible con Robot Da Vinci, de 2 a 12 MHz.	
L51K	Transductor intraoperatorio de arreglo lineal compatible con Robot Da Vinci, de 3 a 15 MHz.	
L31KP	Transductor de arreglo lineal intraoperatorio y para biopsias, de 2 a 9 MHz.	
S31KP	Transductor de arreglo sectorial intraoperatorio y para biopsias, de 3 a 8 MHz.	
S11	Transductor sectorial de 1 a 5 MHz.	
S31	Transductor sectorial de 2 a 9 MHz.	
S42	Transductor sectorial de 3 a 14 MHz.	
S3ESEL	Transductor transesofágico de 2 a 8 MHz.	
S3ESL1	Transductor transesofágico de 2 a 9 MHz.	
S3ESCLS	Transductor transesofágico pediátrico de 2 a 8 MHz	
MXS1	Transductor sectorial transtorácico (TTE) 3D/4D.	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

	Necesita el Software Cardiac 3D B, la unidad Performance Acceleration unit y el hardware PEU.	
VC35	Transductor convexo 3D/4D de 2 a 8 MHz.	
VC41V	Transductor endocavitario 3D/4D de 2 a 8 MHz.	
CC41R	Transductor transrectal biplanar convexo-convexo de 4 a 8 MHz con 100° y 120° de campo de visión.	
CC41R1	Transductor transrectal biplanar convexo-convexo de 2 a 10 MHz con 180° de campo de visión.	
CL4416R1	Transductor transrectal biplanar convexo-lineal de 2 a 14 MHz y 180° de campo de visión en el arreglo convexo.	
C41L47RP	Transductor transrectal biplanar convexo-lineal de 4 a 10 MHz y 200° de campo de visión en el arreglo convexo.	
EZU-PA7V	Adaptador de punción para transductor C41V1	
EZU-PA3U	Accesorio de biopsia para transductor C41L47RP	
EZU-PA7L1	Soporte de guía de aguja para transductor L442	
EZU-PA7L2	Soporte de guía de aguja para transductor L55	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

EZU-PA7L3	Soporte de guía de aguja para transductor L64	
BA-001	Adaptador de punción para transductor CL4416R1	

Garantía

El equipo cuenta con una garantía de 12 meses desde la fecha de la instalación del equipo o 14 meses desde el despacho de fábrica, lo que acontezca primero.