FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Cotización No.

Fecha:

Lugar:

Equipo: LISENDO 880 LE

Vigencia:



FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Estimado _____

Muchas gracias por su interés en adquirir tecnología FUJIFILM. Atendiendo a su reciente petición, nos es grato extender la presente propuesta para el equipo de Ultrasonido modelo LISENDO 880 LE de la marca Fujifilm. A continuación, se describen las características que componen en su totalidad la adquisición del equipo.



Especificaciones Técnicas

Sistema de Ultrasonido para estudios cardiovasculares.

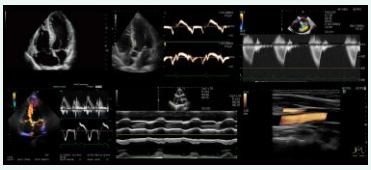
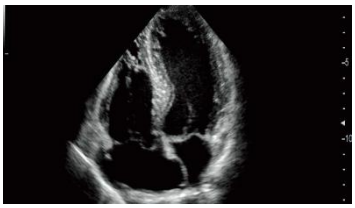
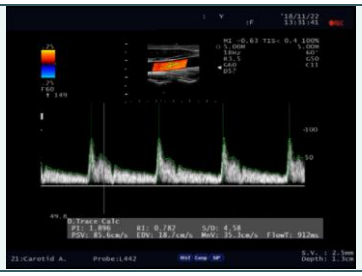
El equipo presenta las siguientes especificaciones técnicas:

Característica	Descripción
Monitor principal	Pantalla Full HD de 22 pulgadas OLED. Montado en brazo completamente articulado.
Pantalla Touch	Pantalla de Cristal Líquido (LCD) TFT de 10.4 pulgadas.
Memoria	Disco Duro Integrado de 1 TB
Panel de control	Panel de control con ajuste de altura y giro. Teclado físico integrado.
Puertos para transductor	6 puertos para transductores (4 activos)
Espacio de almacenamiento	Bandeja trasera de almacenamiento.
Portatransductores	7 portatransductores.

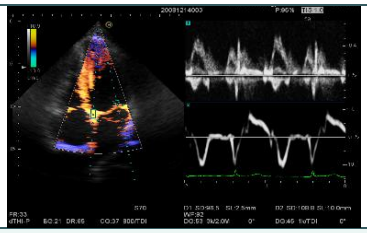
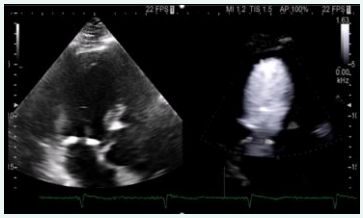
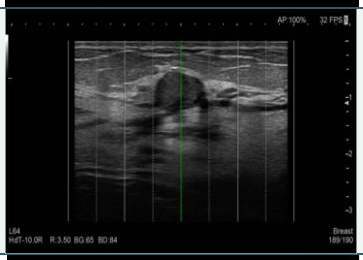
FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Ruedas con freno	4 ruedas con freno.
Suministro Eléctrico	El equipo requiere de una alimentación eléctrica convencional (bifásica) de 100-120/200-240 ±10. Con una potencia eléctrica de 0.75 kVA y frecuencia de 50/60 Hz.

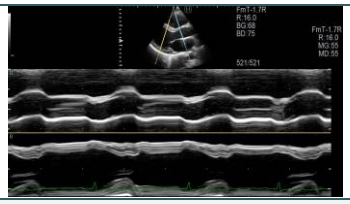
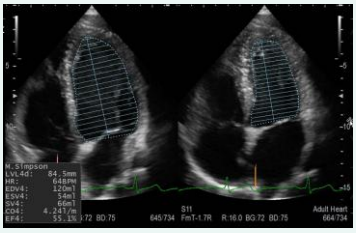
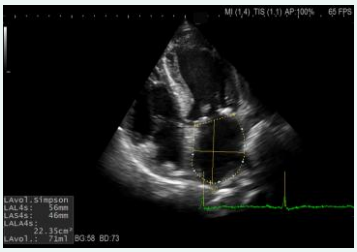
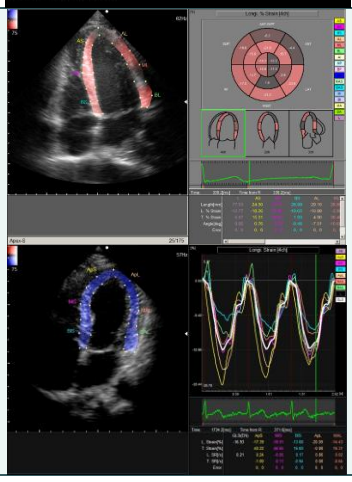
Funciones incluidas

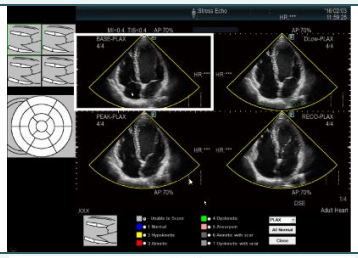
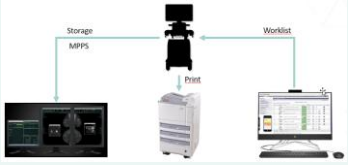
Característica	Descripción	Muestra
Modos de operación y visualización	Modo B, Modo M, Doppler Color (Color Flow Mode), Doppler espectral, Power Doppler, Doppler tisular, Modo M anatómico, Imagen trapezoidal, HI Zoom, Imagen Panorámica.	
Funciones de procesamiento y mejora de imagen	Tissue Harmonic Imaging, HI Rez, Acoustic Noise Reduction, Near-field Noise Reduction, Low Echo Reduction, HI Frame, Grayscale Enhancement, Compound Imaging, B-Steer, Auto Optimizer (Modo B, Doppler espectral, Doppler color), Automated Angle Correction (Doppler espectral), Tissue Adaptive Technology, Carving Imaging, eFocusing, Wide Scanning.	
Real-time Doppler Auto Trace	Trazo y cálculos automáticos de Doppler espectral en tiempo real.	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Dual Gate Doppler	Esta función despliega el espectro Doppler de dos muestras o regiones de interés diferentes de manera simultánea.	
eFlow	eFLOW es un modo de adquisición de imágenes de alta definición del flujo sanguíneo que incorpora mejoras radicales en la resolución temporal y espacial. Con eFLOW, es posible mostrar la información del flujo sanguíneo con una mayor sensibilidad y resolución que con los métodos tradicionales.	
Needle Emphasis	Software de realce de aguja, disponible en transductores convexos, lineales y endocavitarios (C251, C252, C35, C42, C42K, C421, L34, L35, L441, L64).	
Marking assist	Esta función permite el despliegue en pantalla de líneas de referencia, de acuerdo a marcas en transductor, disponible en transductores lineales (L35, L64, SML44).	
Automated IMT Measurement software	Este software posibilita la evaluación automática de la íntima media carotídea	
Protocol Assistant software	Protocol Assistant brinda la capacidad de guiar y ahorrar tiempo del estudio al mostrar una lista estandarizada del protocolo de una manera eficiente y reproducible. Cuenta con protocolos pre-programados que pueden ser editados y con la capacidad de programar nuevos protocolos.	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

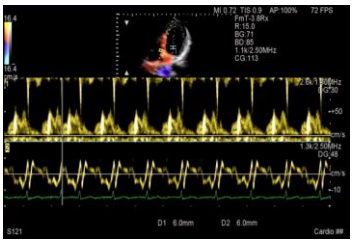
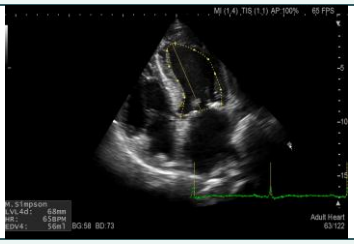
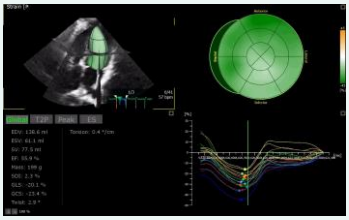
FAM software	Free Angular M-mode o Modo M anatómico permite la formación de hasta 3 imágenes simultáneas en Modo M a partir de cualquier ángulo.	
Automated Cardiac Measurement software	Permite mediciones automáticas en modo 2D de Ventrículo Izquierdo: Volúmenes, gasto cardiaco, fracción de eyección, IVS, LVID, LVPW; así como trazo automático de la cavidad cardiaca, Aurícula izquierda, Aurícula derecha, área VD, FAC y en Modo M de AoDd, LAD, LA/AO. Se puede usar en conjunto con la función de Detección Automática de fin de diástole y fin de sístole. La opción Physiological Signal Unit es un prerrequisito para la opción de medidas cardiológicas automáticas.	 
EyeballEF	EyeballEF detecta los bordes y muestra en tiempo real los volúmenes y la Fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo, latido a latido.	
2D Tissue Tracking Analysis software	2DTT es un software de evaluación de la movilidad de la pared cardiaca o strain, a partir de speckle tracking. Es posible evaluar diversas estructuras como el miocardio y las válvulas. 2DTT proporciona mediciones cuantitativas e información precisas, como: Strain, strain rate, Strain Global Longitudinal (GLS), strain radial y circunferencial, Torsión (twist) desplazamiento y grosor de la pared, entre otros.	

TDI Analysis software	Tissue Doppler Imaging Analysis brinda la medición de la velocidad de movimiento de los segmentos del miocardio e información de torsión (strain, strain rate) a partir de Doppler Tisular.	
Contrast Harmonic Imaging software	CHI es un software para la formación de imágenes por medio de contraste a partir de la detección de los ecos armónicos generados por los mismos. Incluye función de acumulación, análisis por Curva de Intensidad en el tiempo (TIC) y Substracción de imágenes. Disponible en transductores sectoriales, lineales y convexos (C251, C252, C35, C421, L34, L35, L441, S121).	
Stress Echo software	Stress Echo Analysis permite adquirir y evaluar protocolos de eco estrés por banda de esfuerzo, farmacológico y protocolos programables por usuario. Permite adquisición sincronizada con señal ECG.	
DICOM network software	Esta opción habilita las licencias permanentes de DICOM Storage, DICOM Print, DICOM Worklist y DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS).	

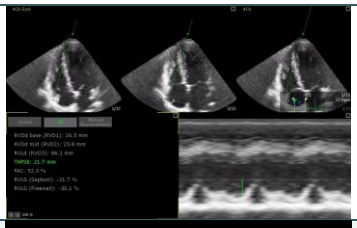
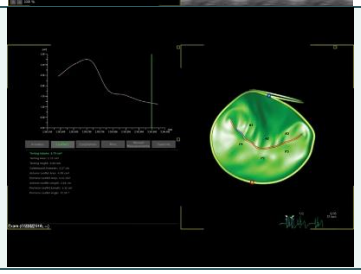
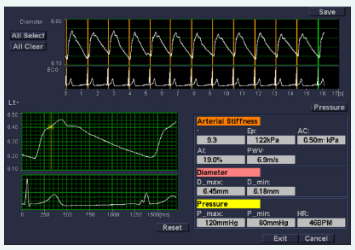
Opcionales

Característica	Descripción	Muestra
B/W Printer Connection kit	Kit de conexión para impresoras integradas al carro del ultrasonido marca Sony o Mitsubishi (UP-X898MD, P95DW, P95DE). Incluye cable USB y cable de alimentación eléctrica.	

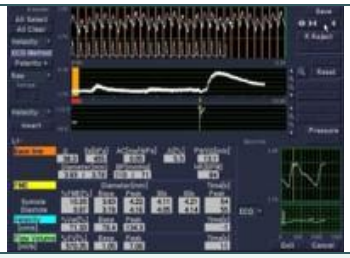
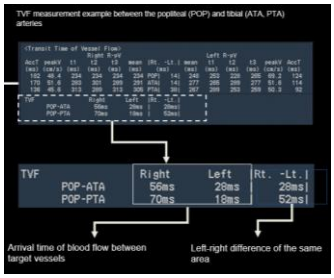
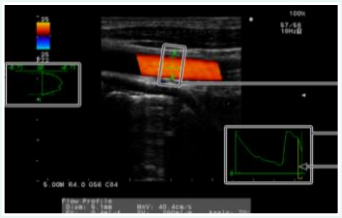
FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Triple Foot Switch	Pedal para manejo del equipo, con tres interruptores programables.	
Jelly Warmer (AC adopter, Mount kit)	Calentador de gel integrado al equipo. Necesita del adaptador de alimentación eléctrica y kit de montaje.	
Physiological Signal Display Unit	Módulo fisiológico integrado en el equipo para despliegue en pantalla de señal de ECG y onda respiratoria. Señales de ECG disponibles: I, II y III. Incluye cable de 3 derivaciones. Necesario para todas las funciones cardiológicas avanzadas.	
Cardiac 3D Software	La función Cardiac 3D (4D) brinda la capacidad de desplegar imágenes cardiológicas 3D y mostrar imagen dual simultánea (Imagen de referencia e imagen biplanar).	
iEF (Biplane AutoEF)	iEF calcula la Fracción de Eyección biplanar con detección de cuadro ED/ES automática y reconocimiento de bordes de las vistas A2C y A4C.	
4D LV-Analysis software	4D LV-Analysis permite la cuantificación automática de los volúmenes y fracción de eyección del Ventrículo izquierdo a partir de los datos 4D. El uso de parámetros como Strain y la torsión permite el análisis cuantitativo de la función ventricular izquierda y la disincronía.	

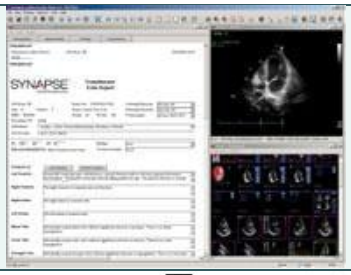
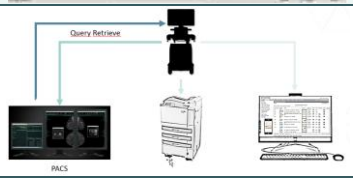
FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

4D RV-Analysis software	Permite evaluar la funcionalidad del ventrículo derecho al proporcionar los valores de fracción de eyección, Strain longitudinal y volúmenes del VD a partir de los datos 4D.	
4D MV-Assessment software	4D MV- Assessment Software puede proporcionar todos los datos necesarios para el diagnóstico y el tratamiento de la válvula mitral, como diámetro y circunferencia del anillo, cuantificación de las valvas y coaptación, entre otras.	
VFM	La tecnología VFM visualiza el flujo sanguíneo intracardiaco mediante vectores de velocidad. Estos vectores permiten evaluar las características del vórtice, las evaluaciones cuantitativas de la tensión de cizallamiento de la pared cardiovascular (Wall Shear Stress) y las pérdidas de energía (Energy Loss).	
Relative Pressure	Opción que proporciona el valor de Gradiente de Presión Relativa, la cual es de utilidad en el diagnóstico de insuficiencia cardiaca.	
Advanced Cardiac Report	Reporte Cardiológico Avanzado cumple con las guías de la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Permite confirmar revisiones de mediciones, ingresas hallazgos y preparar informes desde la pantalla de Reporte.	
eTracking	eTracking calcula los índices de ateroesclerosis relacionados a las características elásticas de los vasos sanguíneos, a partir del diámetro del vaso y los valores de presión arterial. Necesita del módulo de ECG (PEU hardware)	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

FMD	Flow Mediated Dilatation (FMD) es usado para la evaluación funcional de los vasos sanguíneos antes de que ocurran cambios orgánicos.	
Wave Intensity	La intensidad de onda (Wave Intensity) es un nuevo índice hemodinámico que puede evaluar el desempeño cardiovascular al brindar información acerca del comportamiento dinámico e interacción del corazón y el sistema vascular. La intensidad de onda es calculada en función de los cambios que experimentan la presión arterial y la velocidad del flujo sanguíneo, registrados en un punto arbitrario del sistema circulatorio. Necesita del módulo de ECG (PEU hardware)	
TVF Measurement	Transit Time of Vessel Flow measurement software habilita un procedimiento guiado sencillo para el cálculo de tiempo de tránsito de flujo vascular, el cual a través de una comparación temporal entre las extremidades permite identificar con claridad si una estenosis crea, y dónde lo hace, un retraso del flujo máximo. Con trazo de onda y visualización de resultados.	
Flow Profile Measurement software	Flow Profile es un software de medición del volumen instantáneo de flujo sanguíneo del sistema vascular periférico, calculado a través de los valores de velocidad de flujo del perfil unidimensional detectados a partir de Doppler Color.	
Picture in Picture	Opción para visualización Picture in Picture en la pantalla del equipo de ultrasonido. Útil en procedimientos de intervencionismo.	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Detective Flow Imaging Software	DFI genera imágenes en Color de acuerdo con la intensidad de la señal. El flujo sanguíneo se muestra con un alto frame rate y es mínimamente afectado por los movimientos que el paciente pudiera hacer.	
McAfee Embedded Control software	Opción de Antivirus integrado en el equipo. McAfee es una marca registrada de McAfee LCC en los Estados Unidos y otros países.	McAfee
DICOM Structure Report software	Esta licencia habilita el envío de Reportes Estructurados por medio de protocolo DICOM	
DICOM Query/Retrieve software	Esta licencia habilita la recuperación de estudios por medio de protocolo DICOM.	

Paquete opcional para conexión de impresora a color Sony UP-D25MD

PM-LI880-H002	Kit de conexión para impresora digital a color
MP-FX-AVA-30 Mounting rack of Color printer (UP-D25MD SONY)	Soporte de montaje para Impresora digital a color Marca Sony Modelo UP-D25MD

Paquete opcional para conexión de impresora a color Mitsubishi CP30DW

PM-LI880-H002	Kit de conexión para impresora digital a color

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

MP-FX-AVA-31 **Mounting rack of Color printer (CP30DW Mitsubishi)**	Soporte de montaje para Impresora digital a color Marca Mitsubishi Modelo CP30DW

Transductores y accesorios

C251	Transductor convexo de 1 a 5 MHz.	
C252	Transductor convexo de 1 a 6 MHz.	
C35	Transductor convexo de 2 a 8 MHz.	
C42	Transductor convexo de 4 a 8 MHz.	
C421	Transductor convexo de 3 a 12 MHz.	
C42K	Transductor convexo intraoperatorio de 4 a 10 MHz.	
L34	Transductor lineal de 3 a 7 MHz.	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

L35	Transductor lineal de 2 a 9 MHz.	
L441	Transductor lineal de 2 a 12 MHz	
L64	Transductor lineal de 5 a 18 MHz.	
SML44	Transductor lineal de 2 a 22 MHz.	
L53K	Transductor lineal tipo hockey stick, intraoperatorio, de 3 a 15 MHz.	
S121	Transductor sectorial de 1 a 5 MHz.	
S31	Transductor sectorial de 2 a 9 MHz.	
S42	Transductor sectorial de 3 a 14 MHz.	
S3ESL1	Transductor transesofágico de 2 a 9 MHz.	
S3ESEL	Transductor transesofágico de 2 a 8 MHz.	
MXS1	Transductor sectorial transtorácico (TTE) 3D/4D. Necesita el Software Cardiac 3D B y el hardware PEU.	
MXS2ESLL1	Transductor transesofágico (TEE) 3D/4D. Necesita el Software Cardiac 3D B y el hardware PEU.	
UST-2265-2	Transductor tipo lápiz o ciego para Doppler espectral de onda continua.	

FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Latin American Office
6161 Blue Lagoon Dr., Suite 100 Miami, FL 33126
1.305.406.2910

Garantía

El equipo cuenta con una garantía de 12 meses desde la fecha de la instalación del equipo o 14 meses desde el despacho de fábrica, lo que acontezca primero.