I - Objet	Ce mode opératoire décrit la marche à suivre pour procéder à l'ouverture manuelle d'urgence de la porte coulissante DIB des Vers HD dans le cas où la porte coulissante n'est plus alimentée électriquement.
II - Domaine d'application	Le service de radiothérapie du Centre Hospitalier d'Ajaccio. Personnel concerné : les manipulateurs du service, les physiciens, les dosimétristes/techniciennes de physique, le service technique, les médecins radiothérapeutes.
III - Supports matériel et / ou références légales	Guide de l'ASN N°5 indice 0
IV - Définitions et / ou abréviations	
V - Contenu	Préparation et Déroulement de l'Activité
VI - Objet de la nouvelle version	Version initiale

REVISION ET APPROBATION

	FONCTION	NOM	DATE	VISA
REDIGE PAR	Physicien Médical	Rashid Oozeer	18/12/2025	
REVU PAR	MERM	Emilie LION	22/12/2025	
VALIDE PAR	Responsable Opérationnelle de la qualité en radiothérapie	Pascale Lomellini		
DATE D'APPLICATION Cf. date de validation		**PERIODICITE DE REVISION** *(si non renseignée, par défaut tous les 5 ans)*		

1. Objectifs et contexte

Ce mode opératoire décrit la marche à suivre pour procéder à l'ouverture manuelle d'urgence de la porte coulissante DIB des Vers HD dans le cas où la porte coulissante n'est plus alimentée électriquement.

2. Domaine d'application et responsabilité

Unité concernée : RADIOTHERAPIE
Personnel concerné : les manipulateurs du service, les physiciens, les dosimétristes, les techniciennes de physique, le service technique, les médecins radiothérapeutes.

3. Références légales

a) Légal

- Arrêté du 17 mai 2021 portant homologation de la décision n° 2021-DC-0708 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 avril 2021 fixant les obligations d'assurance de la qualité pour les actes utilisant des rayonnements ionisants réalisés à des fins de prise en charge thérapeutique

- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

b) Qualité

- Guide de l'ASN n°5 : Guide de management de la sécurité et de la qualité des soins de radiothérapie

4. Définitions – Abréviations

Modes de fonctionnement de la porte :

AUTO : mode de fonctionnement normal ((les boutons ouverture/1/2 ouverture et Fermeture focntionnenet quand la porte est alimentée)

DEBR. : débrayage manuel de la porte possible

BLOC FERME : porte bloquée

5. Préparation de l'Activité

Ce mode opératoire s'applique à la porte DIB des Versa HD.

Elle concerne les manipulateurs et toute autre personne susceptible d'intervenir pour l'ouverture d'urgence des porte coulissantes des Versa HD : les manipulateurs du service, les physiciens, les dosimétristes, les techniciennes de physique, le service technique, les médecins radiothérapeutes.

6. Déroulement de l'Activité

ETAPE 1 :

Identification des composantes de l'activité Versa 1



Composantes :

1. Manivelle
2. Trappe
3. Bouton pour Débrayage

Identification des composantes de l'activité Versa 2




Composantes :

1. Manivelle
2. Trappe
3. Bouton pour Débrayage

ETAPE 2 :

Tourner le bouton de mode de fonctionnement de la porte coulissante de la position « AUTO » à la position position «DEBR. »

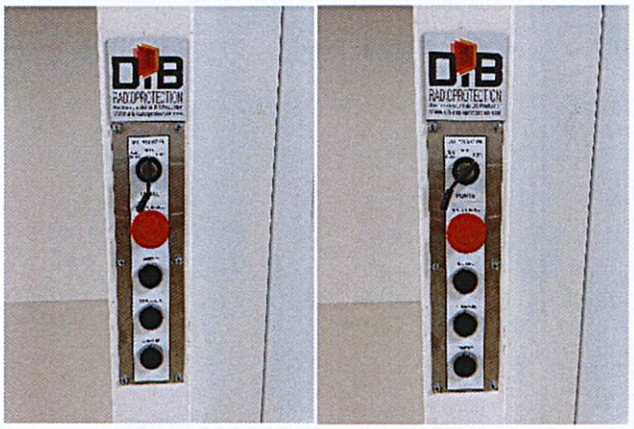


ETAPE 3 :

Prendre l'escabeau situé sous la manivelle accrochée au mur à côté de l'affiche de l'accélérateur :



ETAPE 4 :

Ouvrir la trappe en glissant avec le doigt vers la droite ou la gauche et insérer la manivelle :

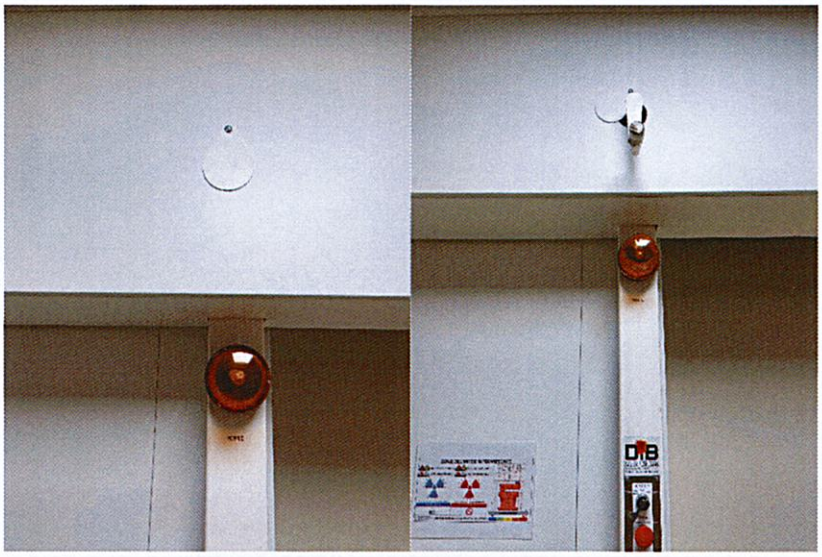

ETAPE 5 :

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la porte



La porte coulissante s'ouvre.

7. Bibliographie

8. Enregistrement

Librairie : Support ; Radioprotection

Thème : Risques rayonnements ionisants