規制番号　名称	26-0009 東広島医療センター入口　(UD-RTR)	運　用	2025年2月4日	製造番号	4L2619
管制番号　名称	260009 東広島医療センター入口　1012号「版6」	開始日時	1時00分　～	製造年月	2024年11月
				メーカー	コイト電工㈱

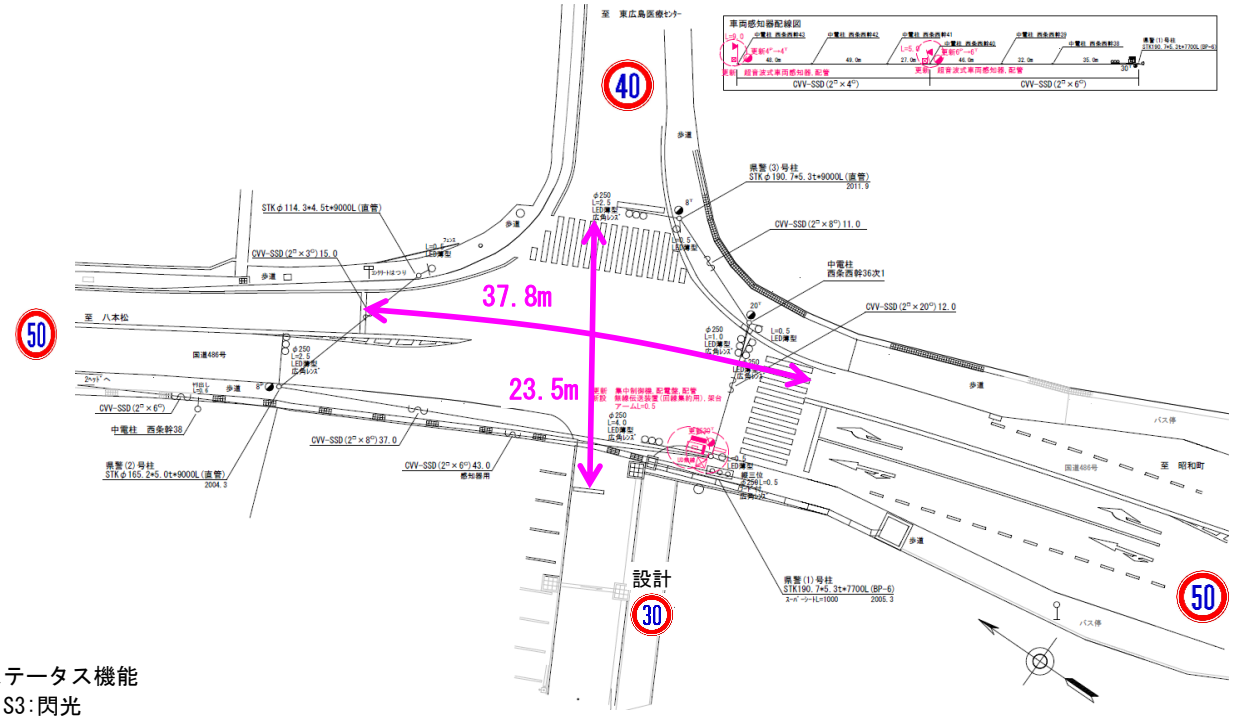

ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図																				
１Ｐ　[1P]		┃	┃	┃	┃															
１　[1V]				∧																
２Ｐ　[2P]							┃	┃	┃	┃										
２　[2V]									∧											
ＰＵ	109					109														
ＰＬ　(60秒)	14	5	2	3	3	15	5	7	3	3										
保安秒時　(140秒)	92	5	4	3	3	15	5	7	3	3										
最長時間（秒）	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間（秒）	6	1	1	1	1	6	1	1	1	1										
ＡＢ連動出力																				

規制番号 名称	26-0009 東広島医療センター入口	運 用	H.12年12月 4日	製造番号	0H0523
管制番号 名称	240009 国立療養所入口 （UC形）	開始日時	14時25分 ～	製造年月	平成12年10月

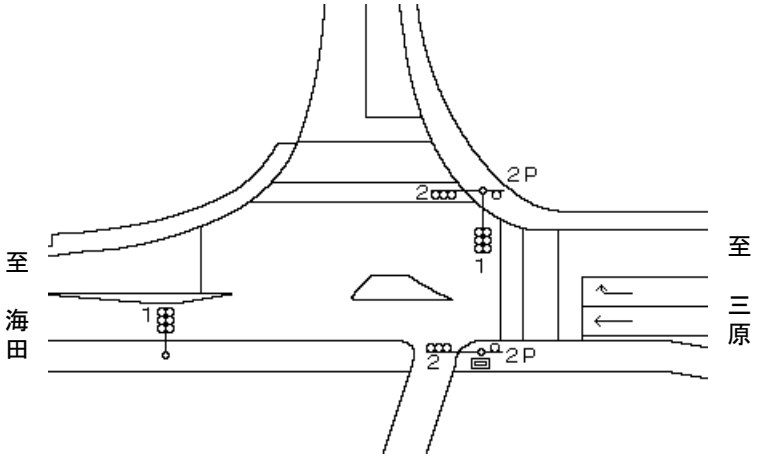

ステータス機能
S1:半感応(DC12V Ⅱ形) 23:00～ 6:00
S3:閃光
その他
シリアル／パス端子

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
（1P）［1P］	―	―	‖	―	―	―	―	―	―	―	―									
1 ［1V］	―	―	―	―	∧∨	―	―	―	―	―	―									
2P ［2P］	―	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―									
2 ［2V］	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∨	―									
最終指定	○					○					○	スプリット数： 3								
可変指定	○	○					○													
保安秒時（ 120秒）	10	70	5	2	3	3	12	5	4	3	3									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									