
規制番号　名称	01-0134　広大医学部南	運　用	平成25年2月7日	製造番号	K0000001
管制番号　名称	10134　広大医学部南　(UD-UC)	開始日時	23時23分　～	製造年月	2012年12月
				メーカー	日本信号(株)

Int056

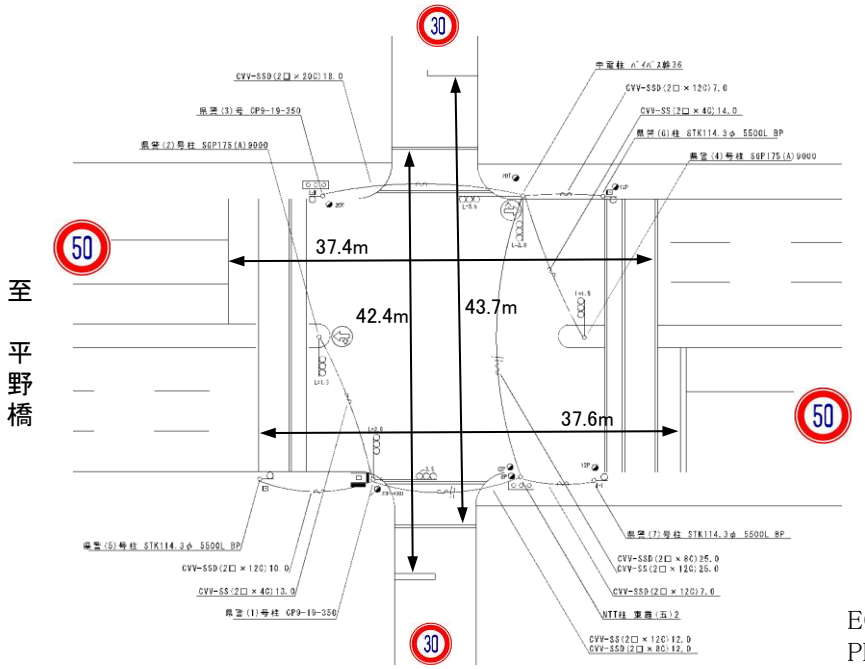



付加機能
　高齢者等感応
ステータス機能
　S3:閃光


EC5503A-202
PD1220A　V1.05
形式 EC5503A+34001001

ｽﾃｯﾌﾟ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ｽﾃｯﾌﾟ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R									

流れ図










(1P)　[1P]	▬	▬	▮▮▮	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬									
1　[1V]	▬	▬	▬	▬	∿	▬	▬	▬	▬	▬	▬									
2P　[2P]	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▮▮▮	▬	▬	▬									
2　[2V]	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	∿	▬									
高齢者等感応		補正					29													
可変指定	○	○					○													
最終指定	○					○					○									
PU	109	109					26													
PL　(68秒)	7	5	5	2	3	3	25	9	2	3	4									
保安秒数 (160秒)	58	46	5	2	3	3	25	9	2	3	4									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									

規制番号 名称	10134 広大医学部南	運 用	H. 5年 3月30日	製造番号	2M2670
				製造年月	平成 5年 2月
管制番号 名称	10134 広大医学部南 （A集中）	開始日時	1時45分 ～	メーカー	松下電器産業㈱

Int056

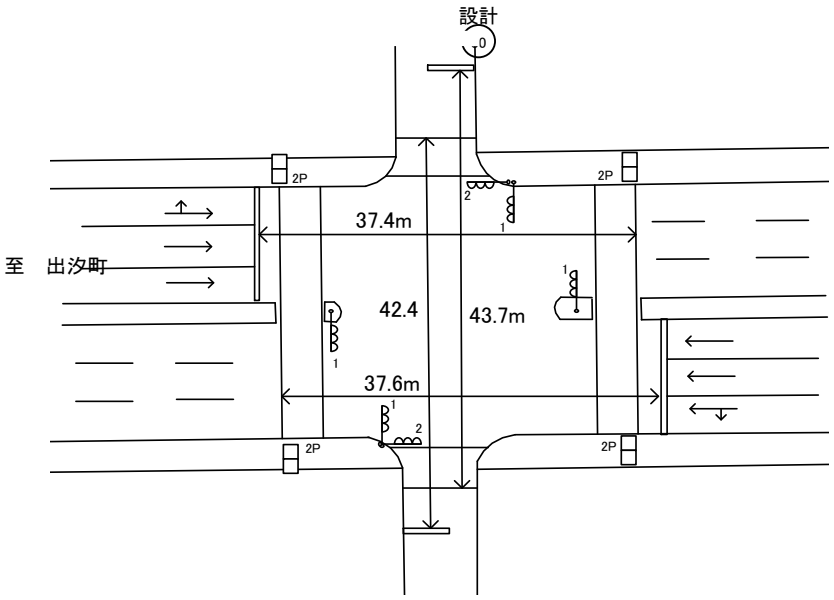

付加機能
弱者感応
ステータス機能
S3:閃光押釦
その他

ステップ番号	1*	2	3	4	5	6*	7	8	9	10	11*	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									
流動図																				
（1P）[1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
PU	109	109					26										弱者補正4秒を2StepPLに加算			
PL （ 68秒 ）	7	5	5	2	3	3	25	9	2	3	4						11Step：計算上5秒			
初期PL（ 66秒 ）	7	1	5	4	3	2	25	9	4	3	3									
ステップ機能		弱者補正					弱者感応													
置換秒数							29										端末置き換え秒数29秒に変更必要			
初期置換秒数							25													
保安秒時（ 140秒）	44	40	10	4	3	2	12	15	4	3	3									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									