規制番号 名称	1-0503 安佐病院前		運 用	H. 20年 2月25日	製造番号	72067
管制番号 名称	010503 安佐病院前	（UC形）	開始日時	10時01分 ～	製造年月	平成 20年 1月

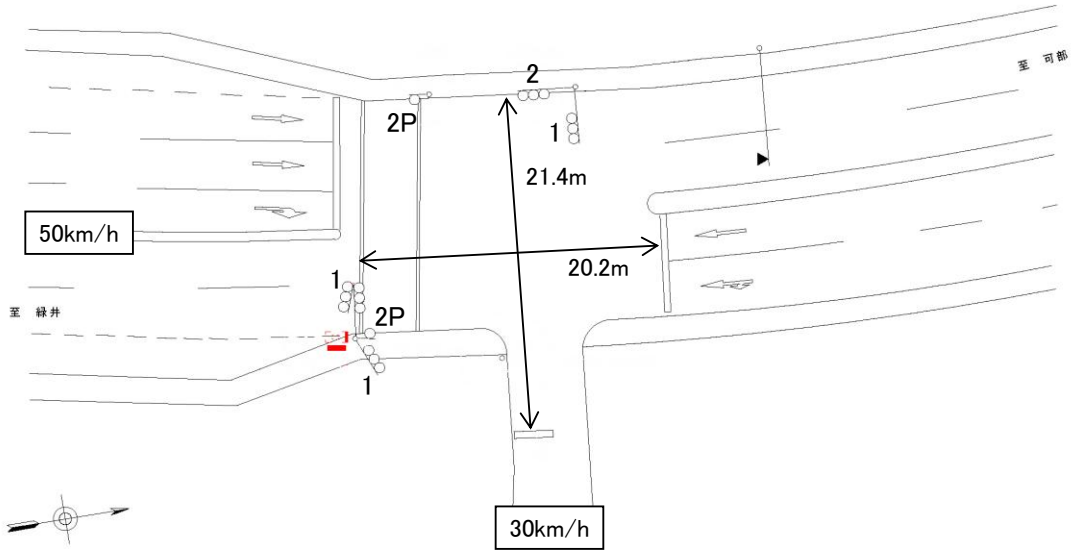

ステータス機能

ステップ番号	1	2	3	4	5＊	6	7	8	9	10＊	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図																				
（1P）[1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
PU	109					109														
PL （ 54秒 ）	10	5	2	3	2	18	6	2	3	3										
保安秒時（ 140秒 ）	96	5	2	3	2	18	6	2	3	3										
最長時間（秒）	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間（秒）	8	0.95	0.95	0.95	0.95	8	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB連動出力																				

規制番号 名称	1-0503 安佐病院前	運 用	H. 19年7月2日	製造番号	3M4380
管制番号 名称	140503 安佐病院前 （X1集中）	開始日時	9時30分 ～	製造年月	昭和58年11月

至 広島インター

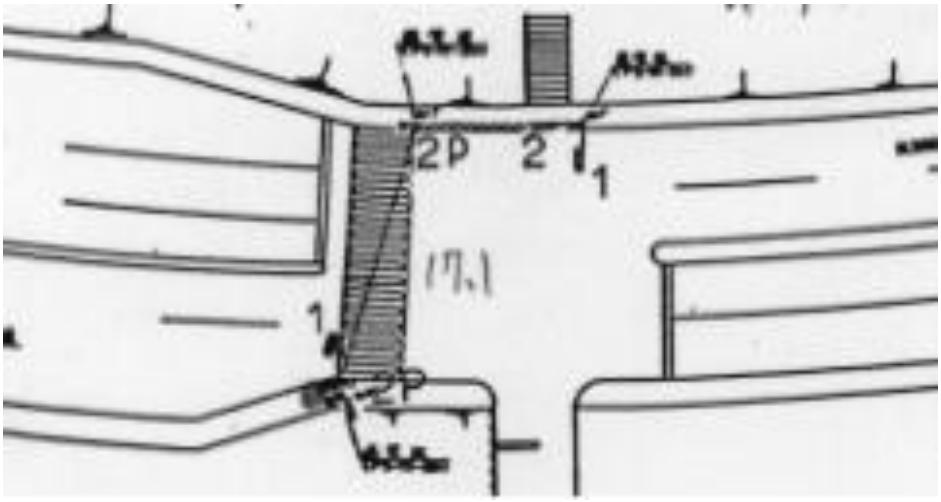

至 可部

ステータス機能

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									
流動図																				
（1P）[1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
保安秒時(170秒)	62	50	10	6	3	2	18	12	2	3	2									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	8	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	8	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									