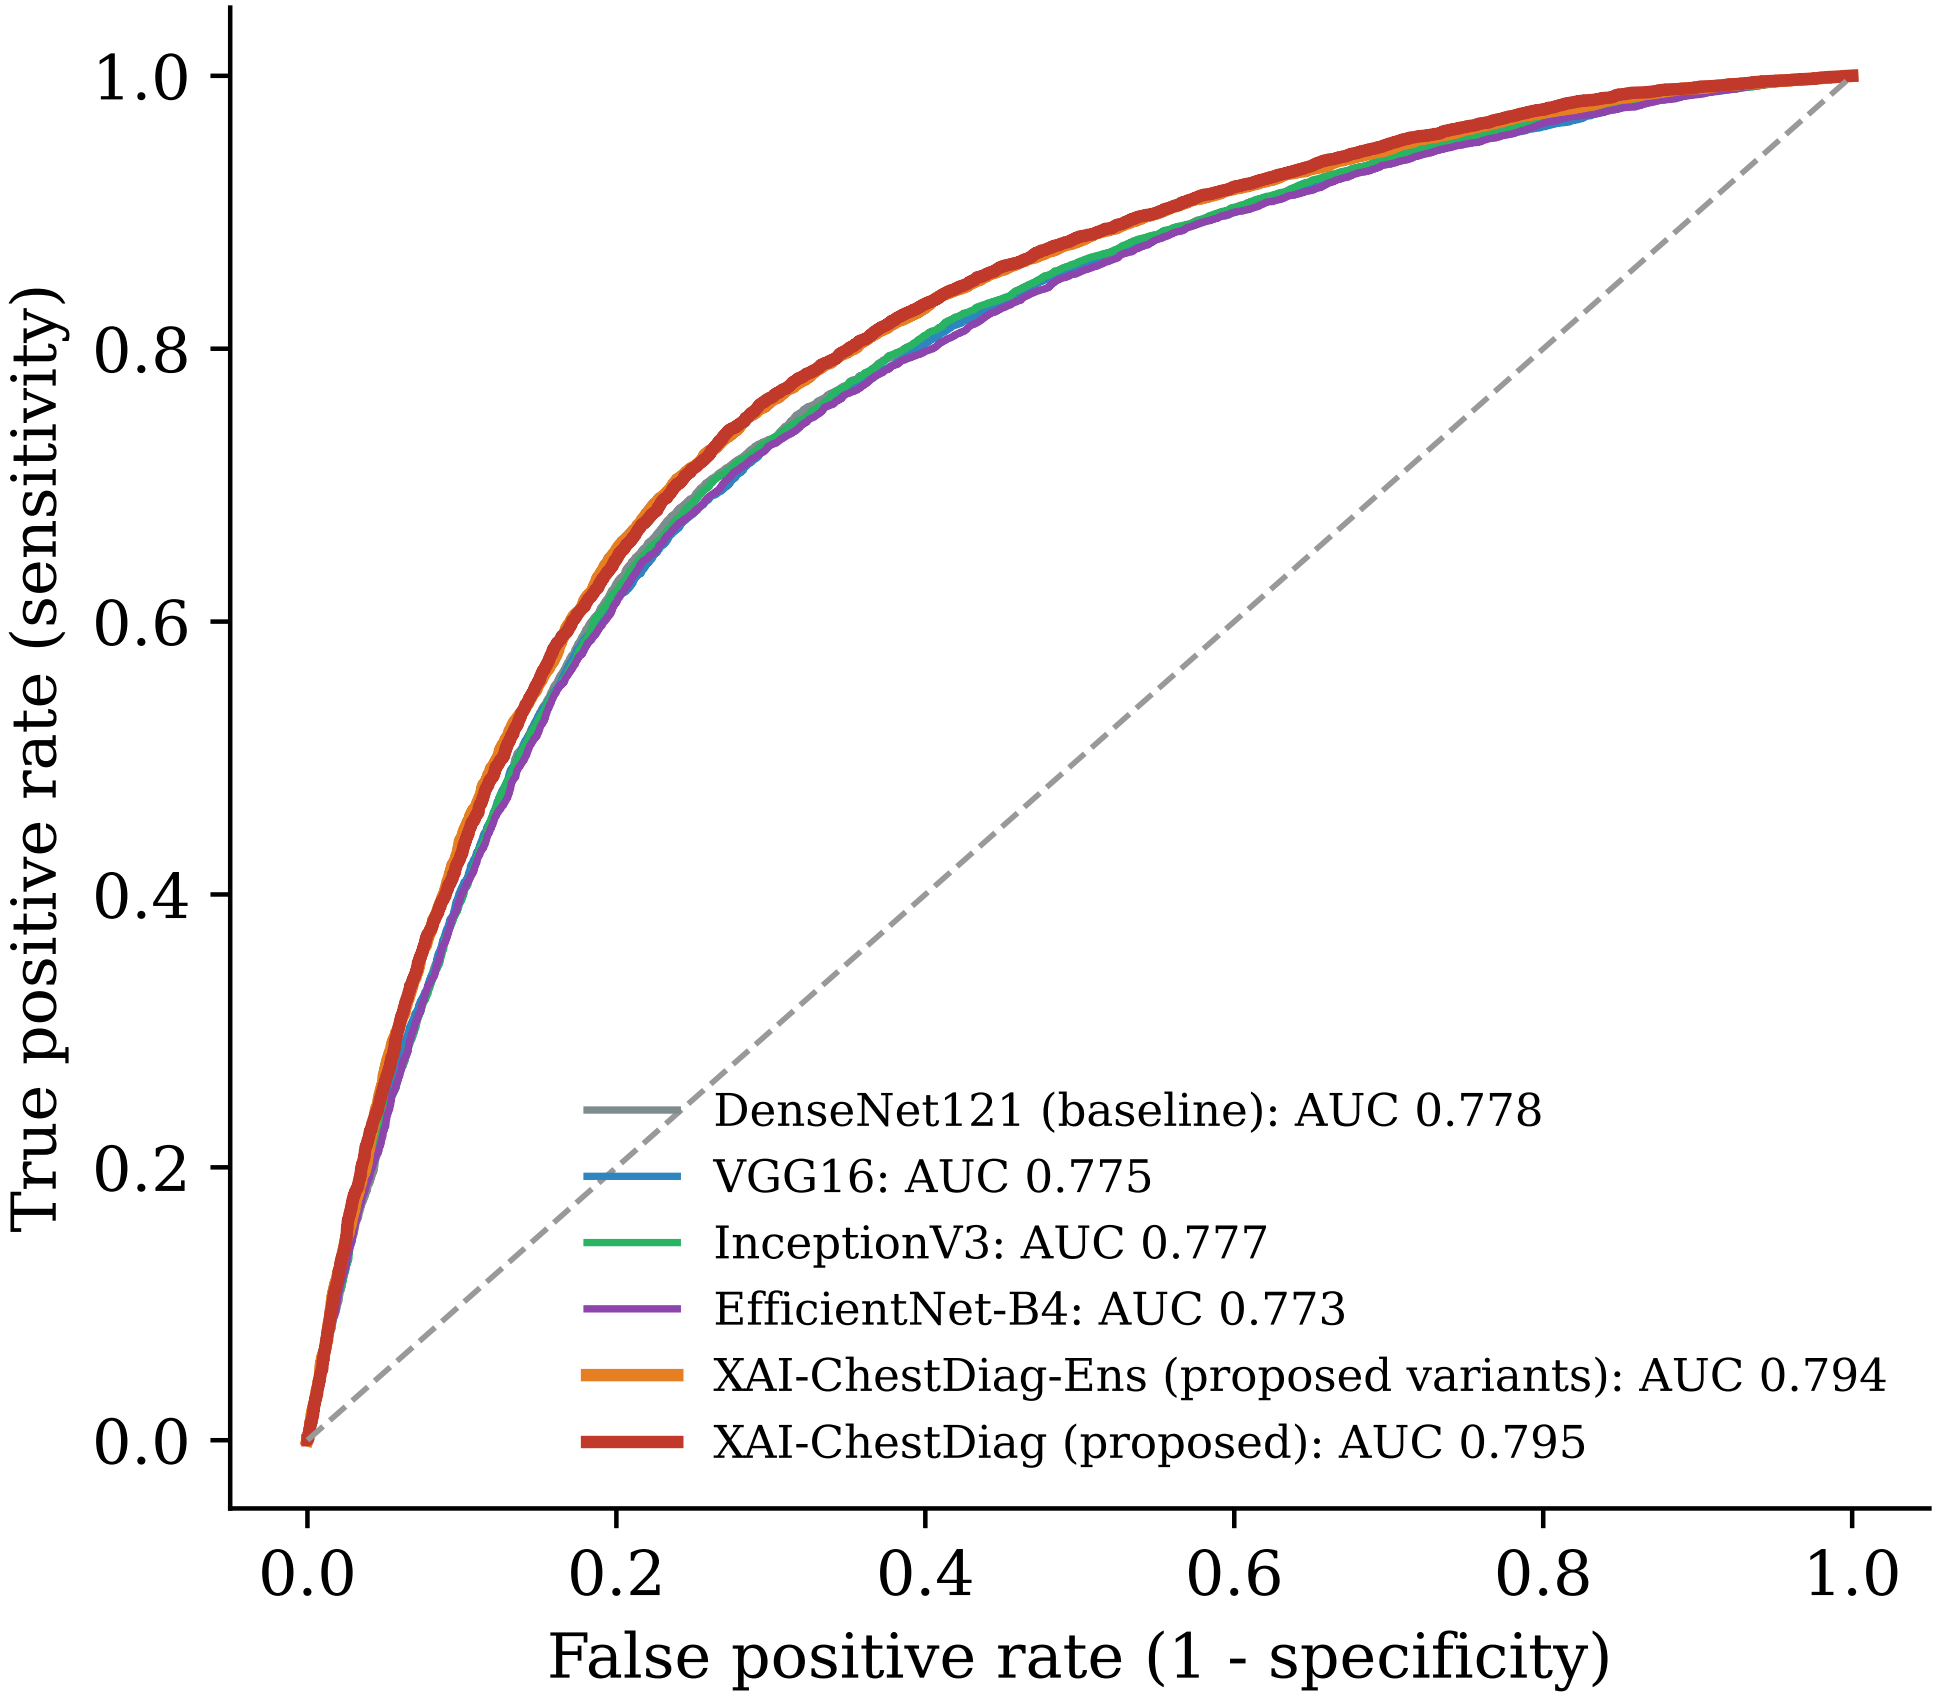

True positive rate (sensitivity)
False positive rate (1 - specificity)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
DenseNet121 (baseline): AUC 0.778
VGG16: AUC 0.775
InceptionV3: AUC 0.777
EfficientNet-B4: AUC 0.773
XAI-ChestDiag-Ens (proposed variants): AUC 0.794
XAI-ChestDiag (proposed): AUC 0.795