


Charge scan (THR: 213, 1000 events)

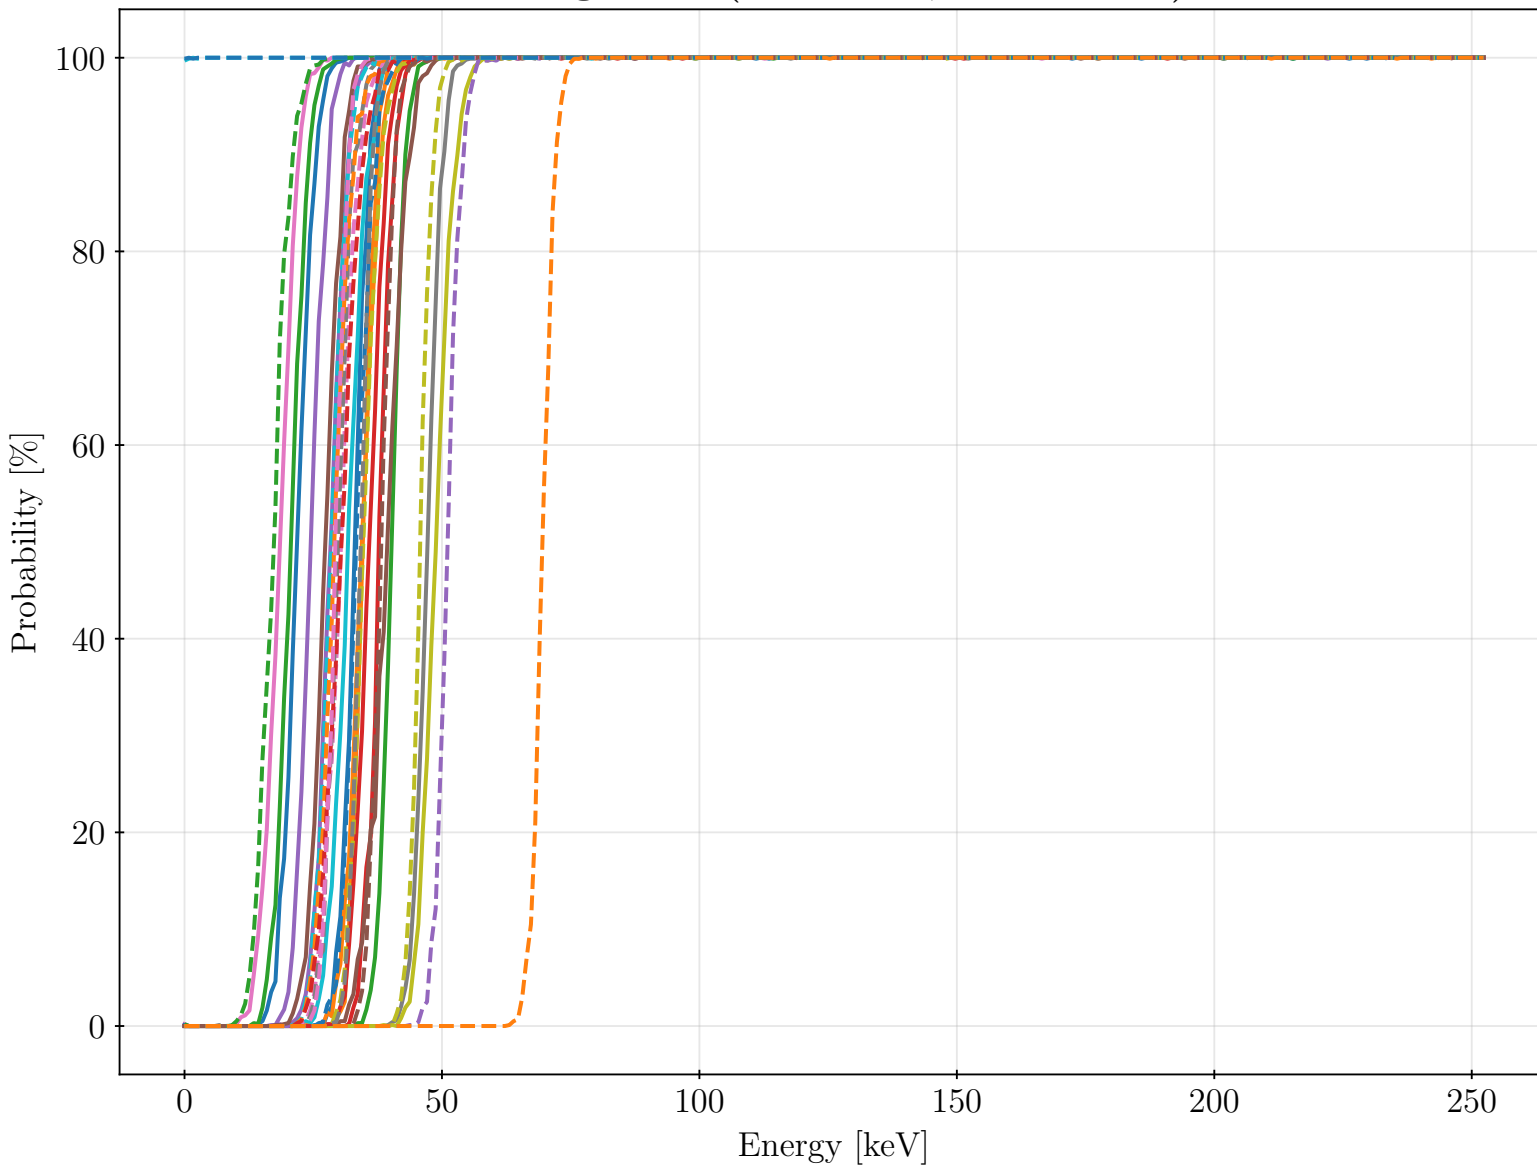

Channel			
0	THR: 33.06 keV ENC: 5.42 keV	16	THR: 30.27 keV ENC: 6.9 keV
1	THR: 34.64 keV ENC: 5.07 keV	17	THR: 29.84 keV ENC: 5.75 keV
2	THR: 40.2 keV ENC: 5.11 keV	18	THR: 34.84 keV ENC: 6.12 keV
3	THR: 37.85 keV ENC: 5.36 keV	19	THR: 28.52 keV ENC: 6.26 keV
4	THR: 24.57 keV ENC: 6.29 keV	20	THR: 33.51 keV ENC: 6.36 keV
5	THR: 39.3 keV ENC: 8.13 keV	21	THR: 29.16 keV ENC: 6.8 keV
6	THR: 18.49 keV ENC: 7.11 keV	22	THR: 17.17 keV ENC: 6.92 keV
7	THR: 47.18 keV ENC: 5.57 keV	23	THR: 30.41 keV ENC: 8.07 keV
8	THR: 48.84 keV ENC: 6.94 keV	24	THR: 51.1 keV ENC: 5.12 keV
9	THR: 31.84 keV ENC: 7.37 keV	25	THR: 38.2 keV ENC: 5.04 keV
10	THR: 21.91 keV ENC: 6.62 keV	26	THR: 29.38 keV ENC: 4.66 keV
11	THR: 34.52 keV ENC: 6.81 keV	27	THR: 34.2 keV ENC: 4.39 keV
12	THR: 20.64 keV ENC: 6.57 keV	28	THR: 45.8 keV ENC: 4.48 keV
13	THR: 35.89 keV ENC: 6.69 keV	29	THR: -7.18 keV ENC: 6.13 keV
14	THR: 28.4 keV ENC: 6.38 keV	30	THR: -17.64 keV ENC: 13.25 keV
15	THR: 27.41 keV ENC: 6.61 keV	31	THR: 69.6 keV ENC: 4.68 keV