


Charge scan (THR: 223, 1000 events)

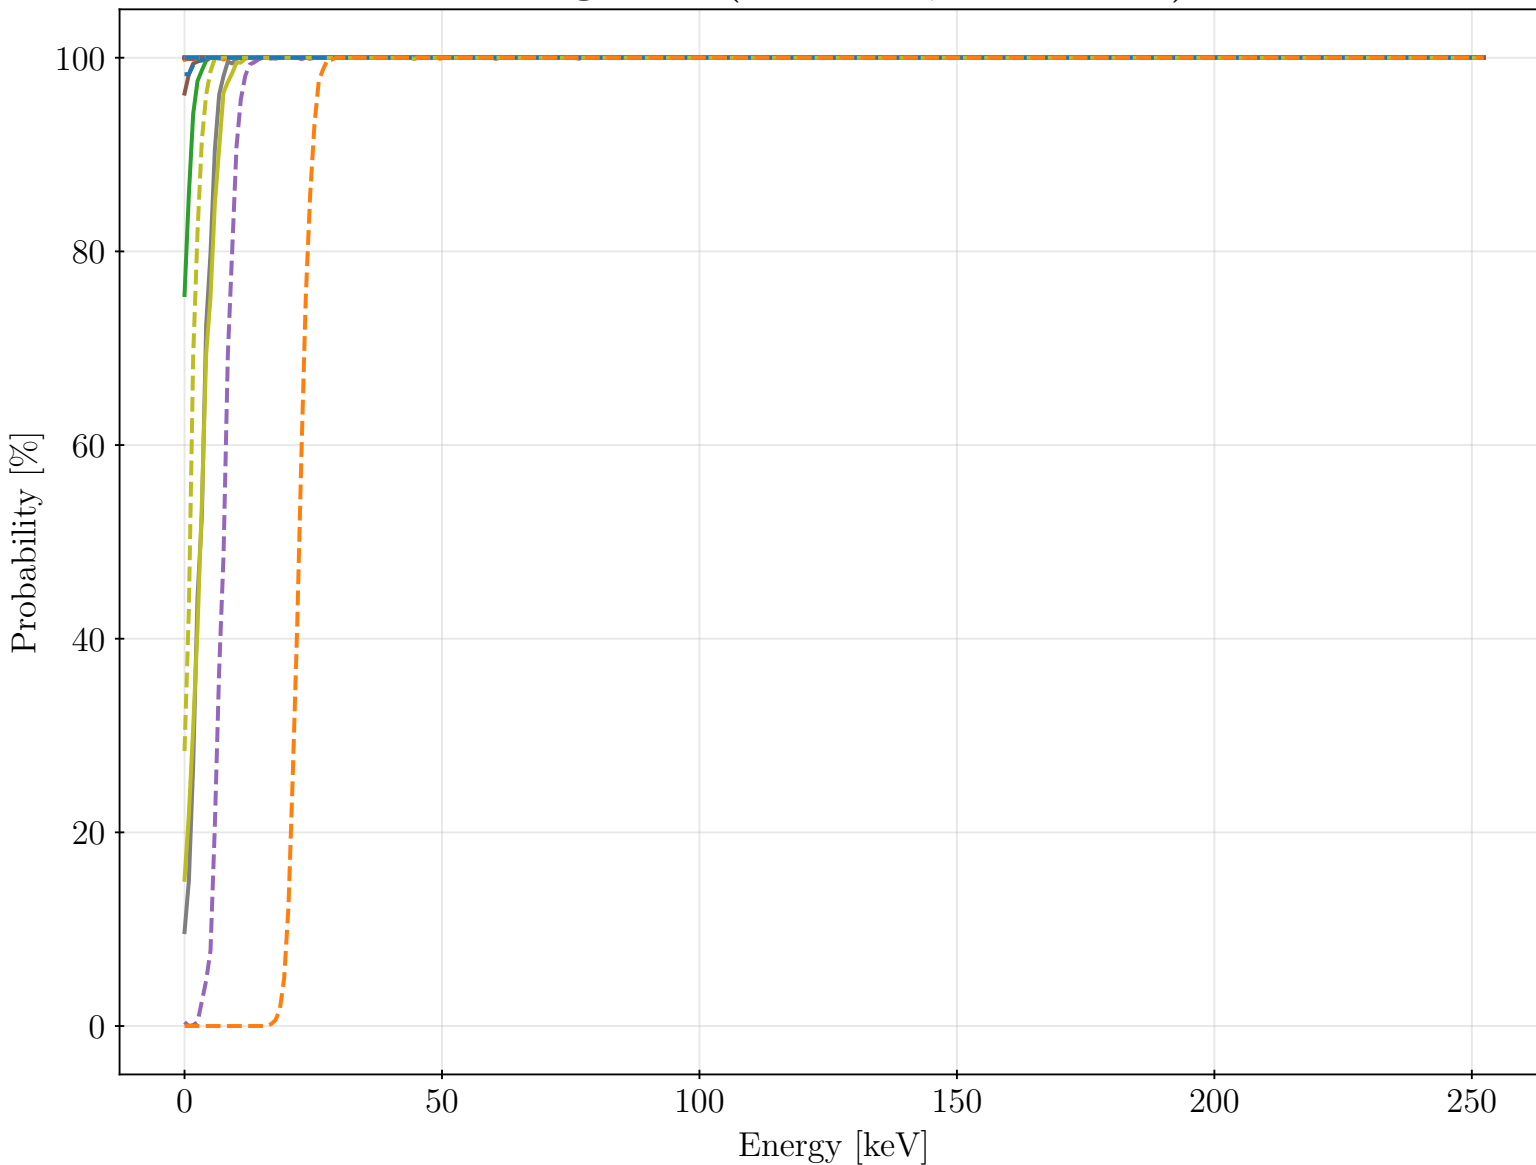

Channel			
0 THR: -30.63 keV ENC: 21.27 keV	16 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	16 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
1 THR: -0.96 keV ENC: 0.79 keV	17 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	17 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
2 THR: -1.37 keV ENC: 4.7 keV	18 THR: -15.65 keV ENC: 12.6 keV	18 THR: -15.65 keV ENC: 12.6 keV	
3 THR: -17.64 keV ENC: 13.25 keV	19 THR: -225.6 keV ENC: 139.21 keV	19 THR: -225.6 keV ENC: 139.21 keV	
4 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	20 THR: -10.08 keV ENC: 11.45 keV	20 THR: -10.08 keV ENC: 11.45 keV	
5 THR: -4.55 keV ENC: 5.99 keV	21 THR: -12.86 keV ENC: 10.51 keV	21 THR: -12.86 keV ENC: 10.51 keV	
6 THR: -60.09 keV ENC: 26.15 keV	22 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	22 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
7 THR: 3.02 keV ENC: 5.25 keV	23 THR: -17.64 keV ENC: 13.25 keV	23 THR: -17.64 keV ENC: 13.25 keV	
8 THR: 3.03 keV ENC: 6.49 keV	24 THR: 7.52 keV ENC: 4.61 keV	24 THR: 7.52 keV ENC: 4.61 keV	
9 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	25 THR: -37.59 keV ENC: 27.12 keV	25 THR: -37.59 keV ENC: 27.12 keV	
10 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	26 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	26 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
11 THR: -1.18 keV ENC: 0.9 keV	27 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	27 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
12 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	28 THR: 1.0 keV ENC: 3.89 keV	28 THR: 1.0 keV ENC: 3.89 keV	
13 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	29 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	29 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
14 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	30 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	30 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
15 THR: -51.41 keV ENC: 22.34 keV	31 THR: 22.29 keV ENC: 4.43 keV	31 THR: 22.29 keV ENC: 4.43 keV	