


Charge scan (THR: 230, 1000 events)

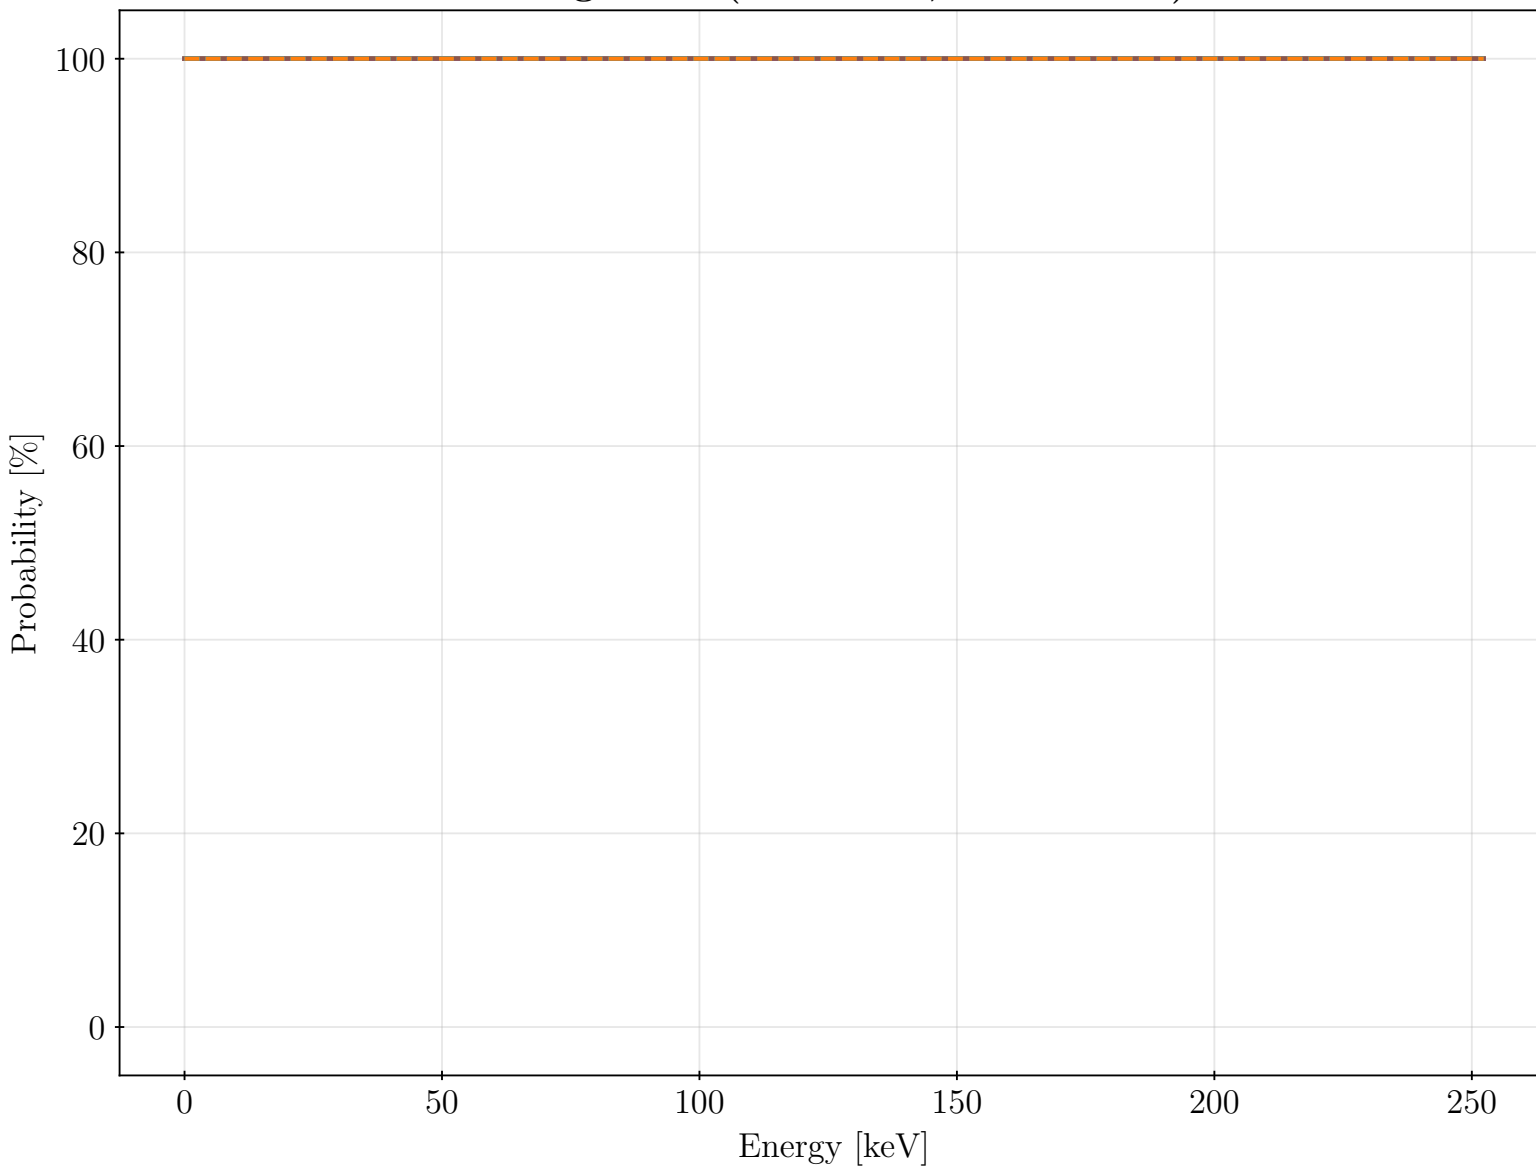

Channel			
0 THR: -38.05 keV ENC: 13.98 keV		16 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
1 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		17 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
2 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		18 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
3 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		19 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
4 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		20 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
5 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		21 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
6 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		22 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
7 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		23 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
8 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		24 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
9 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		25 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
10 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		26 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
11 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		27 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
12 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		28 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
13 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		29 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
14 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		30 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
15 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		31 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	