


Charge scan (THR: 210, 1000 events)

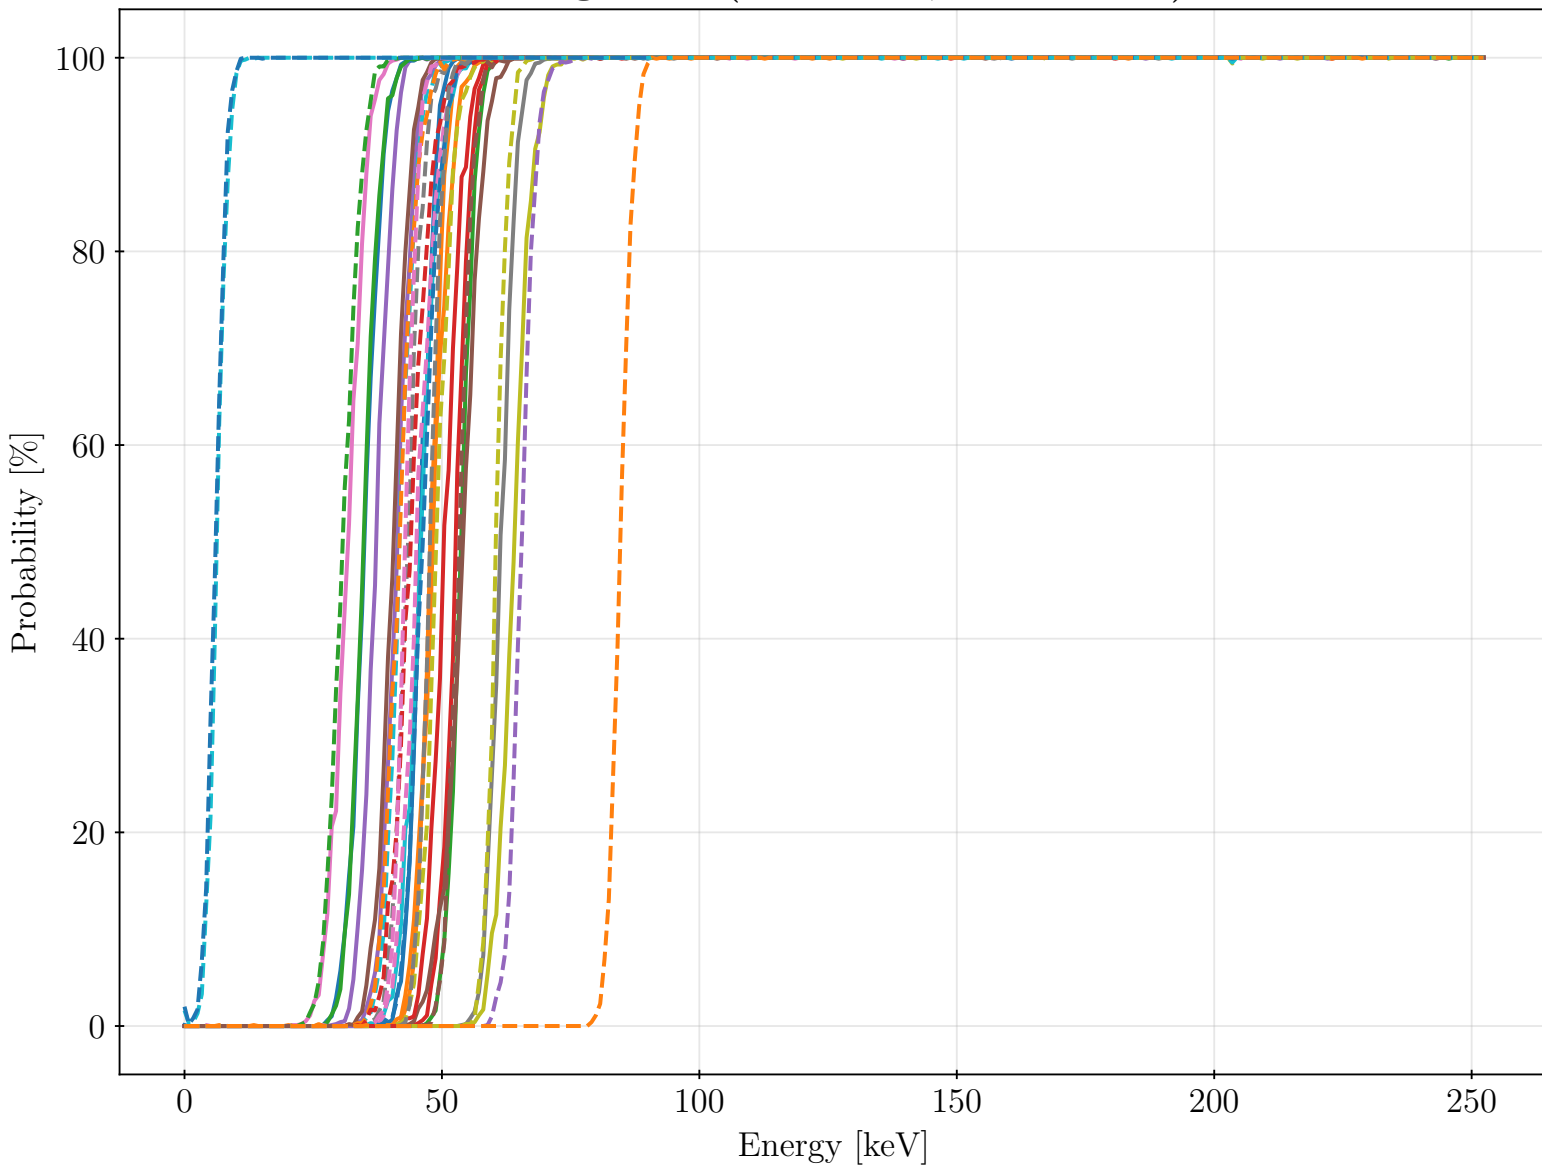

Channel	
0 THR: 45.89 keV ENC: 5.62 keV	16 THR: 45.3 keV ENC: 7.54 keV
1 THR: 47.87 keV ENC: 5.46 keV	17 THR: 43.36 keV ENC: 6.12 keV
2 THR: 53.71 keV ENC: 5.59 keV	18 THR: 49.01 keV ENC: 6.34 keV
3 THR: 52.68 keV ENC: 5.91 keV	19 THR: 41.88 keV ENC: 6.31 keV
4 THR: 37.2 keV ENC: 6.46 keV	20 THR: 46.27 keV ENC: 6.76 keV
5 THR: 54.01 keV ENC: 8.1 keV	21 THR: 41.71 keV ENC: 6.98 keV
6 THR: 31.67 keV ENC: 7.61 keV	22 THR: 30.81 keV ENC: 7.18 keV
7 THR: 61.48 keV ENC: 5.98 keV	23 THR: 43.9 keV ENC: 8.29 keV
8 THR: 64.0 keV ENC: 7.2 keV	24 THR: 65.45 keV ENC: 5.42 keV
9 THR: 45.9 keV ENC: 7.4 keV	25 THR: 53.31 keV ENC: 5.43 keV
10 THR: 34.97 keV ENC: 6.83 keV	26 THR: 42.93 keV ENC: 4.71 keV
11 THR: 48.28 keV ENC: 7.2 keV	27 THR: 47.69 keV ENC: 4.83 keV
12 THR: 34.78 keV ENC: 6.42 keV	28 THR: 60.56 keV ENC: 4.49 keV
13 THR: 50.59 keV ENC: 7.1 keV	29 THR: 6.3 keV ENC: 4.04 keV
14 THR: 41.28 keV ENC: 6.58 keV	30 THR: 6.03 keV ENC: 4.21 keV
15 THR: 40.51 keV ENC: 6.77 keV	31 THR: 84.67 keV ENC: 4.95 keV