


Charge scan (THR: 221, 1000 events)

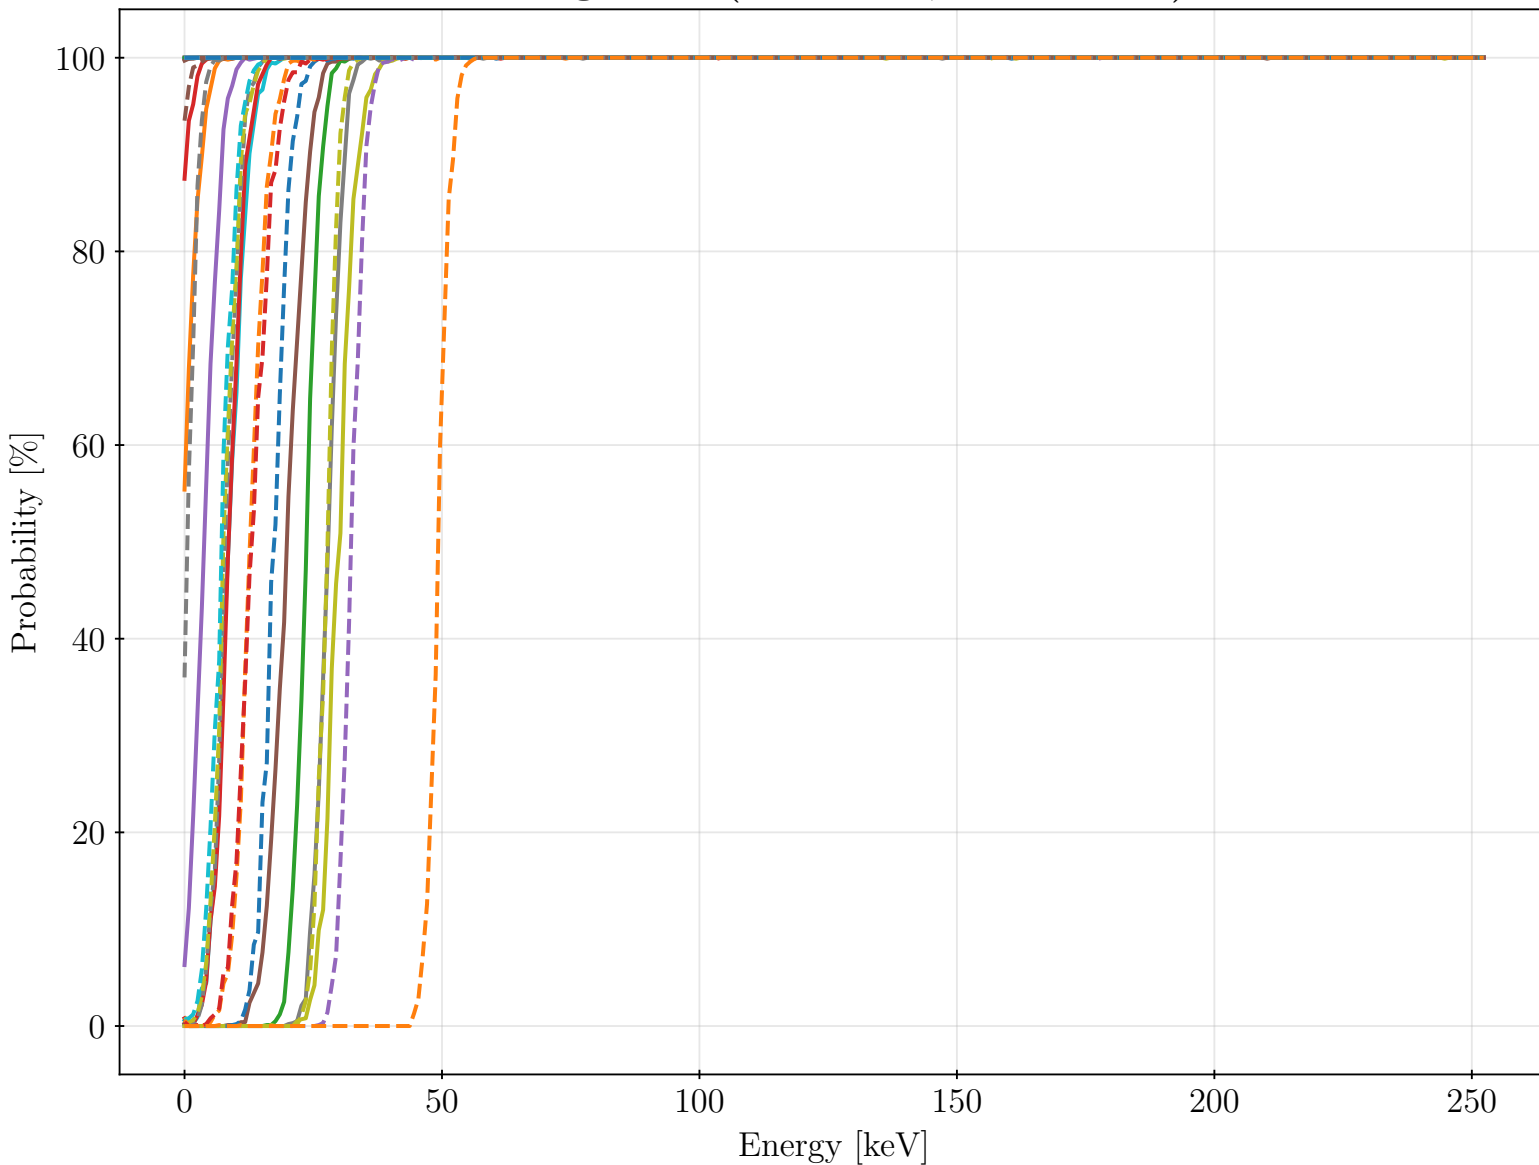

Channel			
0 THR: -30.63 keV ENC: 21.27 keV	16 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	16 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
1 THR: -441.4 keV ENC: 262.49 keV	17 THR: 8.04 keV ENC: 5.81 keV	17 THR: 8.04 keV ENC: 5.81 keV	
2 THR: 23.63 keV ENC: 5.51 keV	18 THR: 7.82 keV ENC: 5.91 keV	18 THR: 7.82 keV ENC: 5.91 keV	
3 THR: -3.24 keV ENC: 6.56 keV	19 THR: 7.23 keV ENC: 6.01 keV	19 THR: 7.23 keV ENC: 6.01 keV	
4 THR: -255.54 keV ENC: 156.58 keV	20 THR: 17.39 keV ENC: 6.36 keV	20 THR: 17.39 keV ENC: 6.36 keV	
5 THR: 19.9 keV ENC: 8.12 keV	21 THR: 12.84 keV ENC: 6.74 keV	21 THR: 12.84 keV ENC: 6.74 keV	
6 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	22 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	22 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
7 THR: 27.85 keV ENC: 5.94 keV	23 THR: 13.17 keV ENC: 8.17 keV	23 THR: 13.17 keV ENC: 8.17 keV	
8 THR: 29.9 keV ENC: 6.84 keV	24 THR: 32.43 keV ENC: 5.24 keV	24 THR: 32.43 keV ENC: 5.24 keV	
9 THR: 8.72 keV ENC: 7.05 keV	25 THR: -3.54 keV ENC: 5.49 keV	25 THR: -3.54 keV ENC: 5.49 keV	
10 THR: -0.78 keV ENC: 0.59 keV	26 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	26 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
11 THR: -0.44 keV ENC: 6.72 keV	27 THR: 0.6 keV ENC: 4.23 keV	27 THR: 0.6 keV ENC: 4.23 keV	
12 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	28 THR: 27.62 keV ENC: 4.75 keV	28 THR: 27.62 keV ENC: 4.75 keV	
13 THR: 8.68 keV ENC: 6.41 keV	29 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	29 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
14 THR: 3.82 keV ENC: 6.34 keV	30 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	30 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
15 THR: -8.86 keV ENC: 7.56 keV	31 THR: 49.3 keV ENC: 4.66 keV	31 THR: 49.3 keV ENC: 4.66 keV	