


Charge scan (THR: 200, 1000 events)

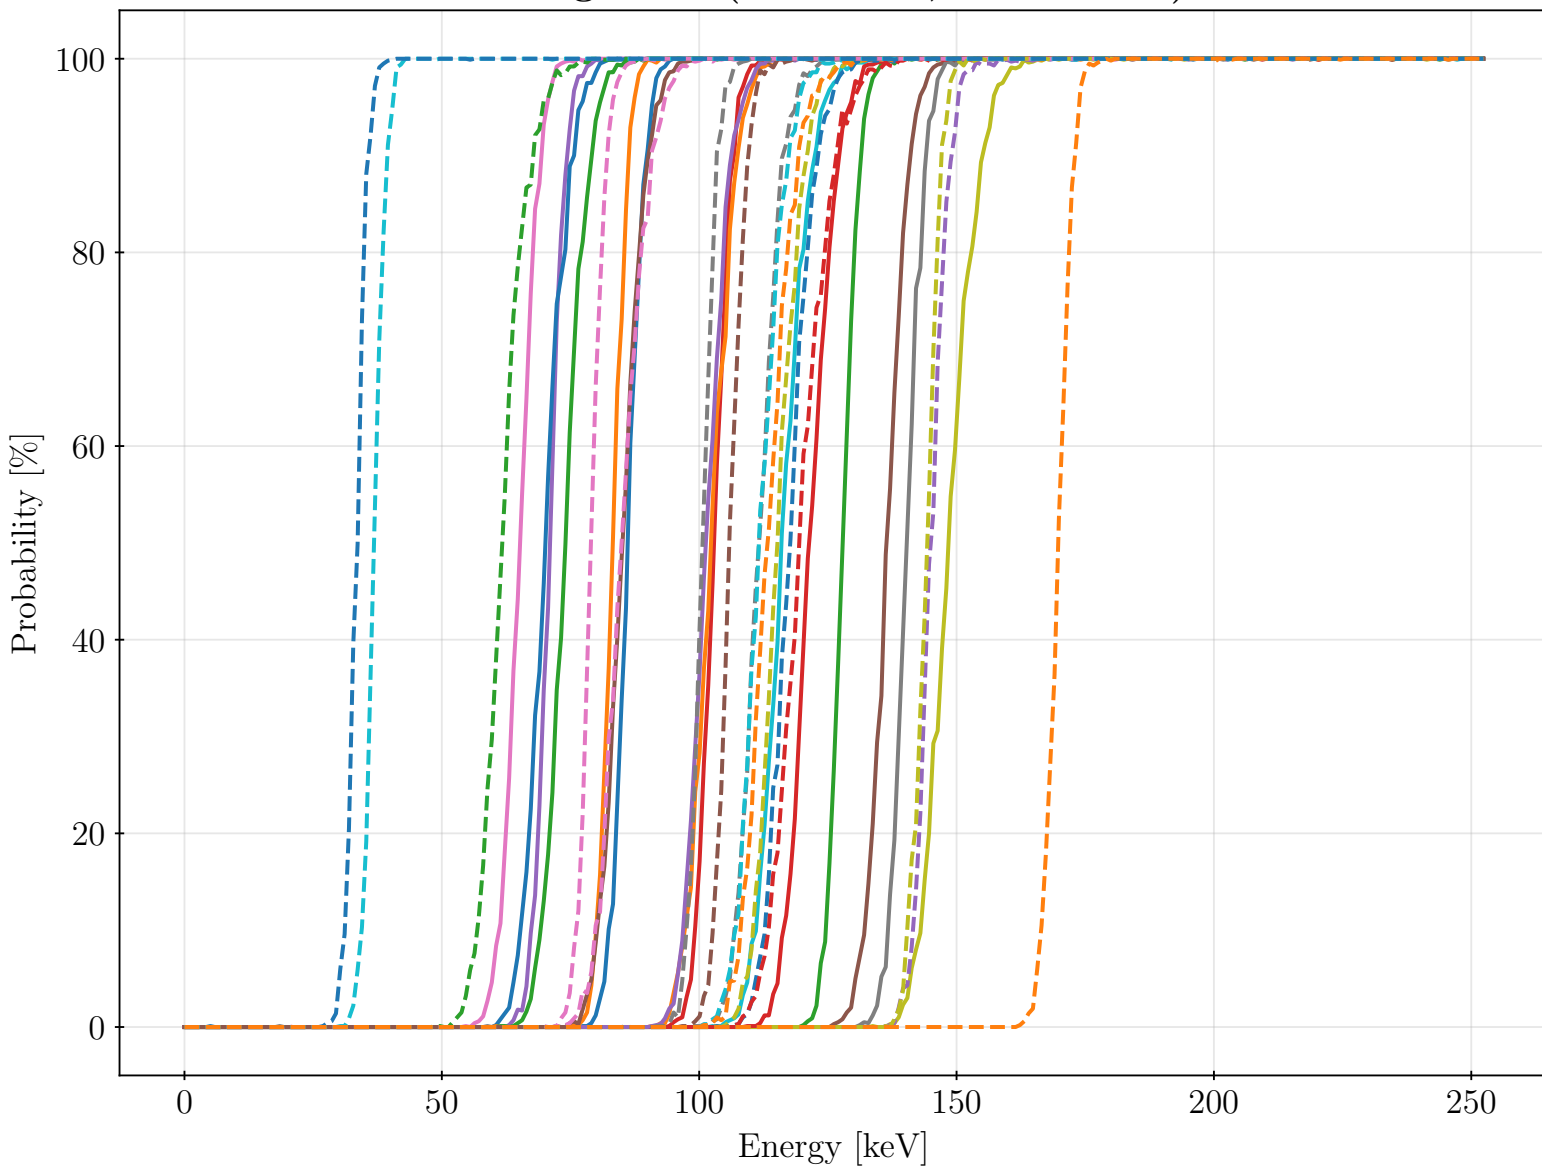

Channel			
0 THR: 86.11 keV ENC: 6.43 keV	16 THR: 85.09 keV ENC: 10.18 keV		
1 THR: 83.22 keV ENC: 5.83 keV	17 THR: 111.65 keV ENC: 8.94 keV		
2 THR: 127.89 keV ENC: 6.35 keV	18 THR: 115.27 keV ENC: 9.5 keV		
3 THR: 102.87 keV ENC: 6.88 keV	19 THR: 111.85 keV ENC: 9.61 keV		
4 THR: 70.91 keV ENC: 6.12 keV	20 THR: 117.54 keV ENC: 9.62 keV		
5 THR: 136.54 keV ENC: 8.25 keV	21 THR: 113.39 keV ENC: 10.47 keV		
6 THR: 65.14 keV ENC: 7.47 keV	22 THR: 61.76 keV ENC: 9.54 keV		
7 THR: 140.34 keV ENC: 6.86 keV	23 THR: 119.66 keV ENC: 12.21 keV		
8 THR: 148.57 keV ENC: 11.26 keV	24 THR: 145.06 keV ENC: 6.78 keV		
9 THR: 116.26 keV ENC: 10.45 keV	25 THR: 106.0 keV ENC: 6.3 keV		
10 THR: 70.14 keV ENC: 9.11 keV	26 THR: 79.04 keV ENC: 5.42 keV		
11 THR: 102.34 keV ENC: 9.51 keV	27 THR: 100.67 keV ENC: 5.53 keV		
12 THR: 73.95 keV ENC: 8.72 keV	28 THR: 144.14 keV ENC: 6.09 keV		
13 THR: 121.62 keV ENC: 9.82 keV	29 THR: 36.85 keV ENC: 4.53 keV		
14 THR: 101.45 keV ENC: 8.93 keV	30 THR: 33.42 keV ENC: 4.28 keV		
15 THR: 85.1 keV ENC: 8.99 keV	31 THR: 169.76 keV ENC: 5.9 keV		