


Charge scan (THR: 200, 1000 events, parasitic injection removed, excl. ch.)

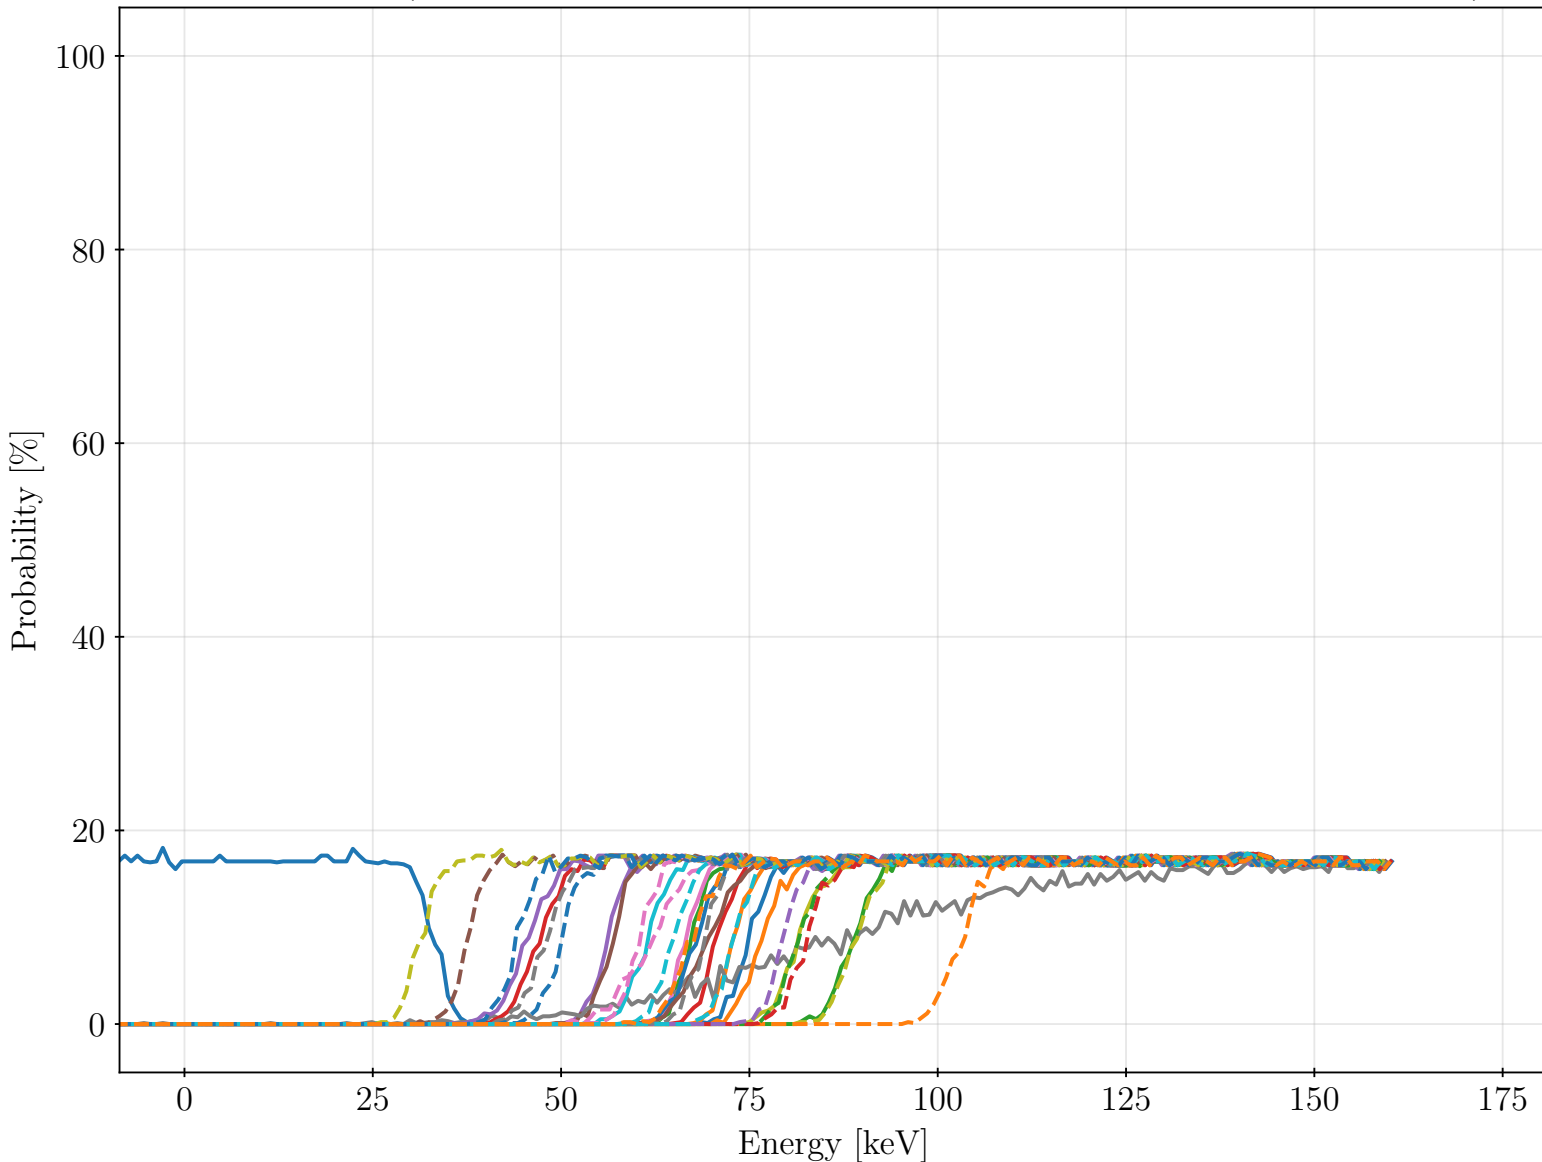

Channel			
0 THR: 697.74 keV	ENC: 1282.93 keV	16 THR: 258.4 keV	ENC: 319.06 keV
1 THR: 245.81 keV	ENC: 278.05 keV	17 THR: 278.22 keV	ENC: 380.26 keV
2 THR: 251.25 keV	ENC: 296.98 keV	18 THR: 224.68 keV	ENC: 217.08 keV
3 THR: 250.51 keV	ENC: 289.74 keV	19 THR: 254.11 keV	ENC: 306.02 keV
4 THR: 265.34 keV	ENC: 341.41 keV	20 THR: 274.02 keV	ENC: 368.61 keV
5 THR: 269.17 keV	ENC: 347.25 keV	21 THR: 211.14 keV	ENC: 172.94 keV
6 THR: 253.05 keV	ENC: 301.26 keV	22 THR: 235.2 keV	ENC: 246.27 keV
7 THR: 245.55 keV	ENC: 254.31 keV	23 THR: 235.68 keV	ENC: 245.55 keV
8 THR: 235.86 keV	ENC: 247.4 keV	24 THR: 235.35 keV	ENC: 249.92 keV
9 THR: 259.94 keV	ENC: 322.41 keV	25 THR: 306.53 keV	ENC: 455.42 keV
10 THR: 249.21 keV	ENC: 292.6 keV	26 THR: 259.37 keV	ENC: 323.17 keV
11 THR: 239.28 keV	ENC: 261.04 keV	27 THR: 246.72 keV	ENC: 286.53 keV
12 THR: 227.59 keV	ENC: 222.32 keV	28 THR: 325.89 keV	ENC: 507.99 keV
13 THR: 283.4 keV	ENC: 391.68 keV	29 THR: 244.86 keV	ENC: 276.53 keV
14 THR: 282.18 keV	ENC: 392.29 keV	30 THR: 288.04 keV	ENC: 406.02 keV
15 THR: 247.29 keV	ENC: 286.58 keV	31 THR: 254.95 keV	ENC: 303.24 keV