


Charge scan (THR: 210, 1000 events)

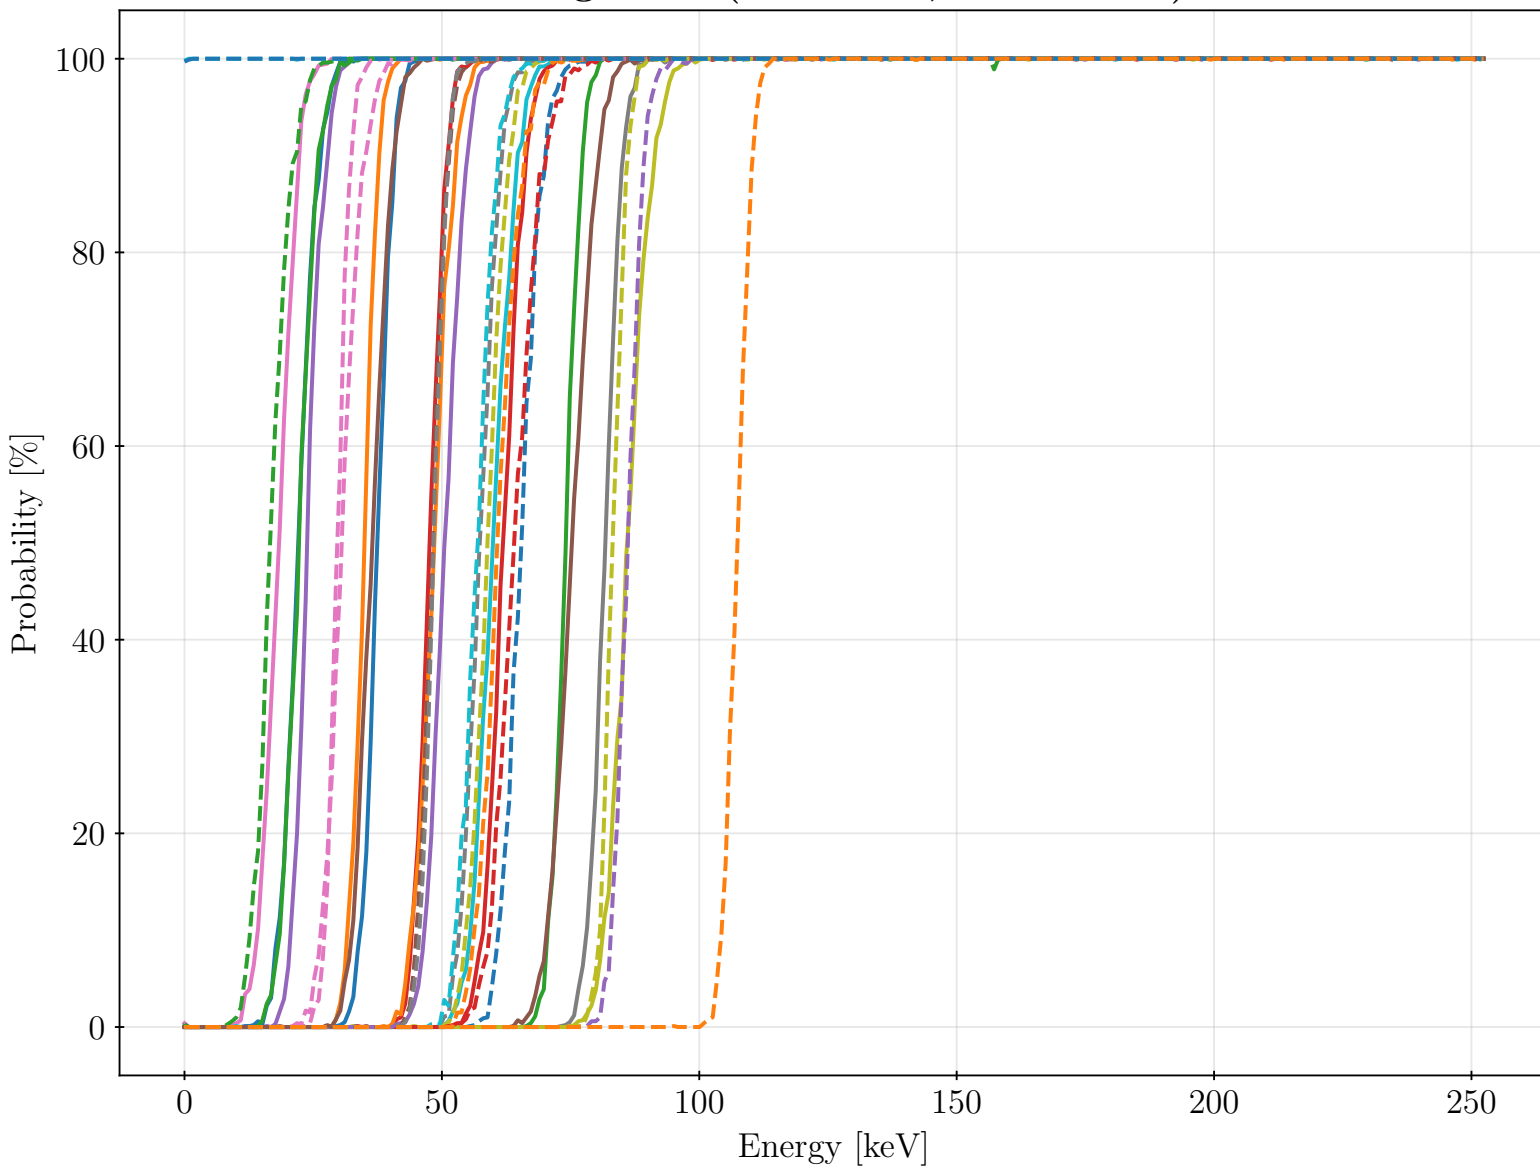

Channel			
0 THR: 37.51 keV ENC: 5.98 keV	16 THR: 30.61 keV ENC: 7.69 keV	17 THR: 57.45 keV ENC: 7.65 keV	
1 THR: 34.89 keV ENC: 5.48 keV	18 THR: 58.91 keV ENC: 7.61 keV	19 THR: 56.84 keV ENC: 7.6 keV	
2 THR: 74.03 keV ENC: 5.97 keV	20 THR: 65.38 keV ENC: 8.05 keV	21 THR: 60.98 keV ENC: 8.65 keV	
3 THR: 47.67 keV ENC: 6.21 keV	22 THR: 16.85 keV ENC: 7.55 keV	23 THR: 64.23 keV ENC: 10.15 keV	
4 THR: 23.9 keV ENC: 6.05 keV	24 THR: 86.1 keV ENC: 6.07 keV	25 THR: 48.16 keV ENC: 5.57 keV	
5 THR: 75.36 keV ENC: 9.3 keV	26 THR: 29.72 keV ENC: 4.71 keV	27 THR: 48.44 keV ENC: 5.11 keV	
6 THR: 18.28 keV ENC: 7.58 keV	28 THR: 83.25 keV ENC: 5.23 keV	29 THR: -0.95 keV ENC: 0.78 keV	
7 THR: 81.7 keV ENC: 6.5 keV	30 THR: -5.98 keV ENC: 5.12 keV	31 THR: 107.37 keV ENC: 5.62 keV	
8 THR: 86.18 keV ENC: 8.87 keV			
9 THR: 59.99 keV ENC: 8.8 keV			
10 THR: 22.15 keV ENC: 7.29 keV			
11 THR: 48.47 keV ENC: 7.77 keV			
12 THR: 22.22 keV ENC: 7.1 keV			
13 THR: 62.01 keV ENC: 7.86 keV			
14 THR: 50.63 keV ENC: 7.67 keV			
15 THR: 36.47 keV ENC: 7.62 keV			