


Charge scan (THR: 214, 1000 events)

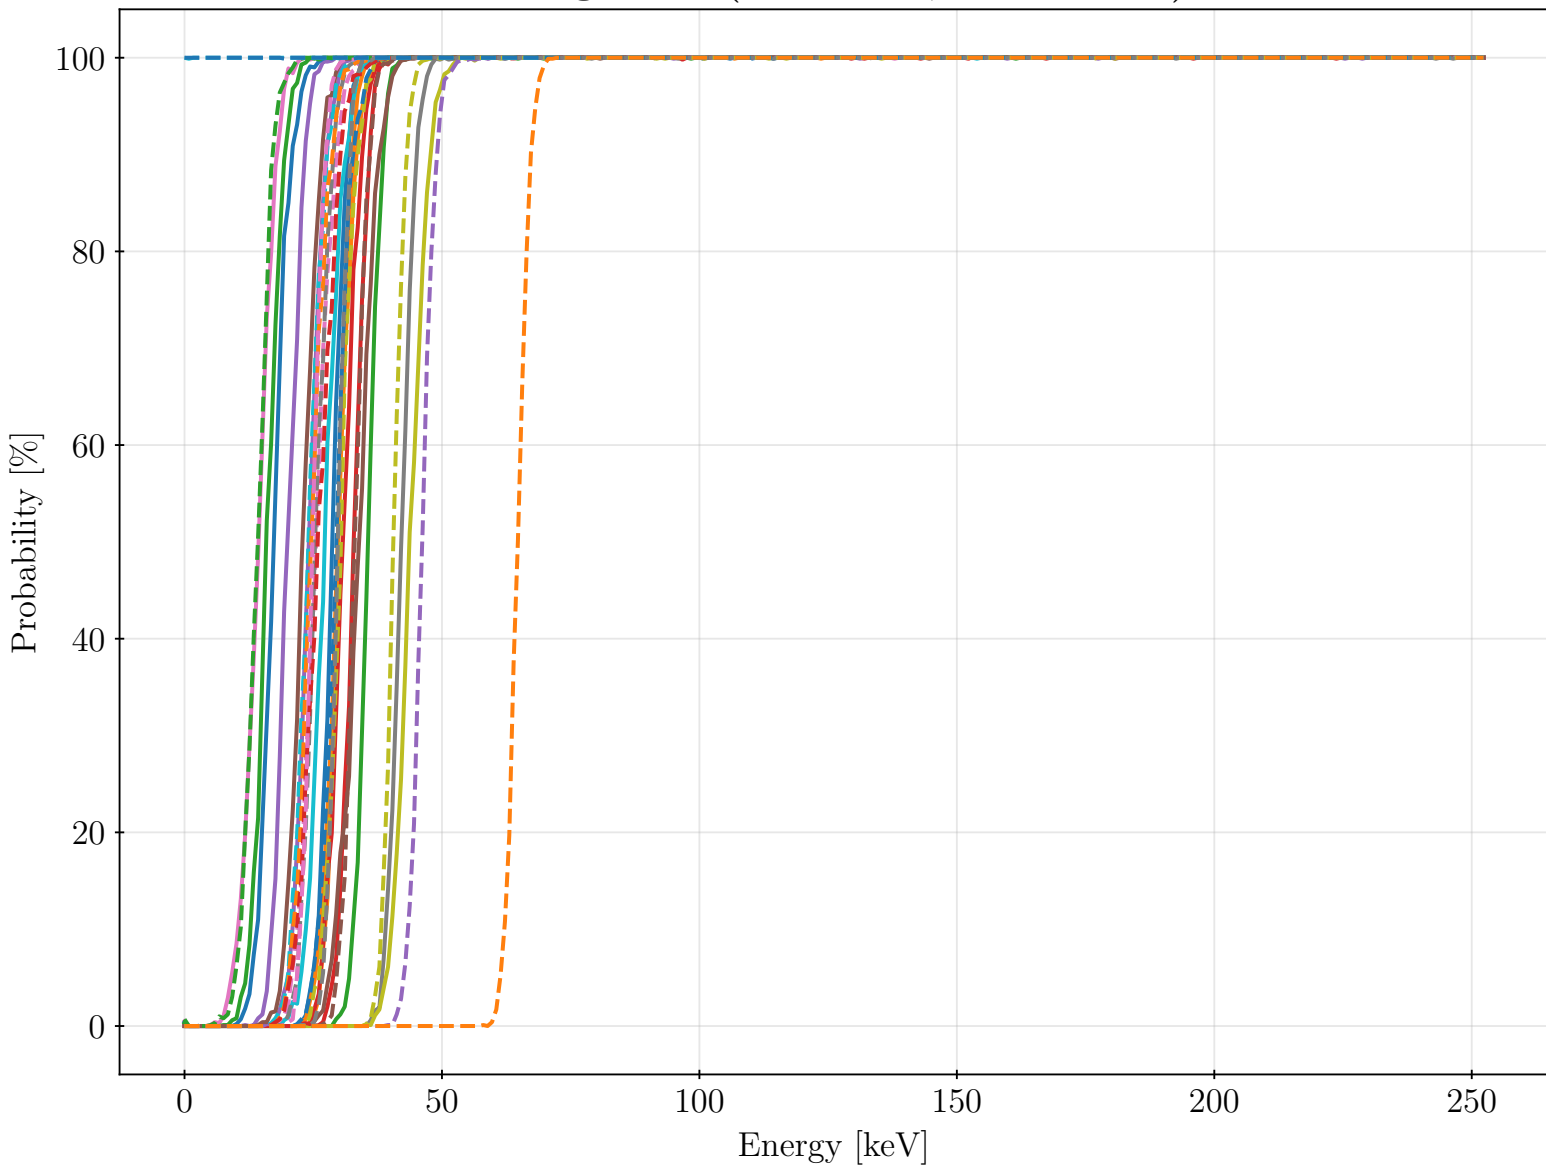

Channel			
0	THR: 28.71 keV ENC: 5.32 keV	16	THR: 25.54 keV ENC: 6.97 keV
1	THR: 30.0 keV ENC: 4.9 keV	17	THR: 25.52 keV ENC: 5.89 keV
2	THR: 35.64 keV ENC: 5.21 keV	18	THR: 30.24 keV ENC: 5.93 keV
3	THR: 32.87 keV ENC: 5.61 keV	19	THR: 24.1 keV ENC: 6.41 keV
4	THR: 20.12 keV ENC: 6.14 keV	20	THR: 29.42 keV ENC: 6.07 keV
5	THR: 33.77 keV ENC: 7.79 keV	21	THR: 24.68 keV ENC: 6.61 keV
6	THR: 14.28 keV ENC: 6.89 keV	22	THR: 14.13 keV ENC: 6.07 keV
7	THR: 42.12 keV ENC: 5.49 keV	23	THR: 26.02 keV ENC: 8.1 keV
8	THR: 43.9 keV ENC: 6.96 keV	24	THR: 46.15 keV ENC: 4.98 keV
9	THR: 27.25 keV ENC: 7.04 keV	25	THR: 33.1 keV ENC: 5.02 keV
10	THR: 17.32 keV ENC: 6.22 keV	26	THR: 24.89 keV ENC: 4.41 keV
11	THR: 29.84 keV ENC: 6.4 keV	27	THR: 29.77 keV ENC: 4.28 keV
12	THR: 16.09 keV ENC: 6.13 keV	28	THR: 40.62 keV ENC: 4.49 keV
13	THR: 30.81 keV ENC: 6.65 keV	29	THR: -30.63 keV ENC: 21.27 keV
14	THR: 24.19 keV ENC: 6.12 keV	30	THR: -60.38 keV ENC: 26.28 keV
15	THR: 23.07 keV ENC: 6.46 keV	31	THR: 64.71 keV ENC: 4.8 keV