


Charge scan (THR: 222, 1000 events)

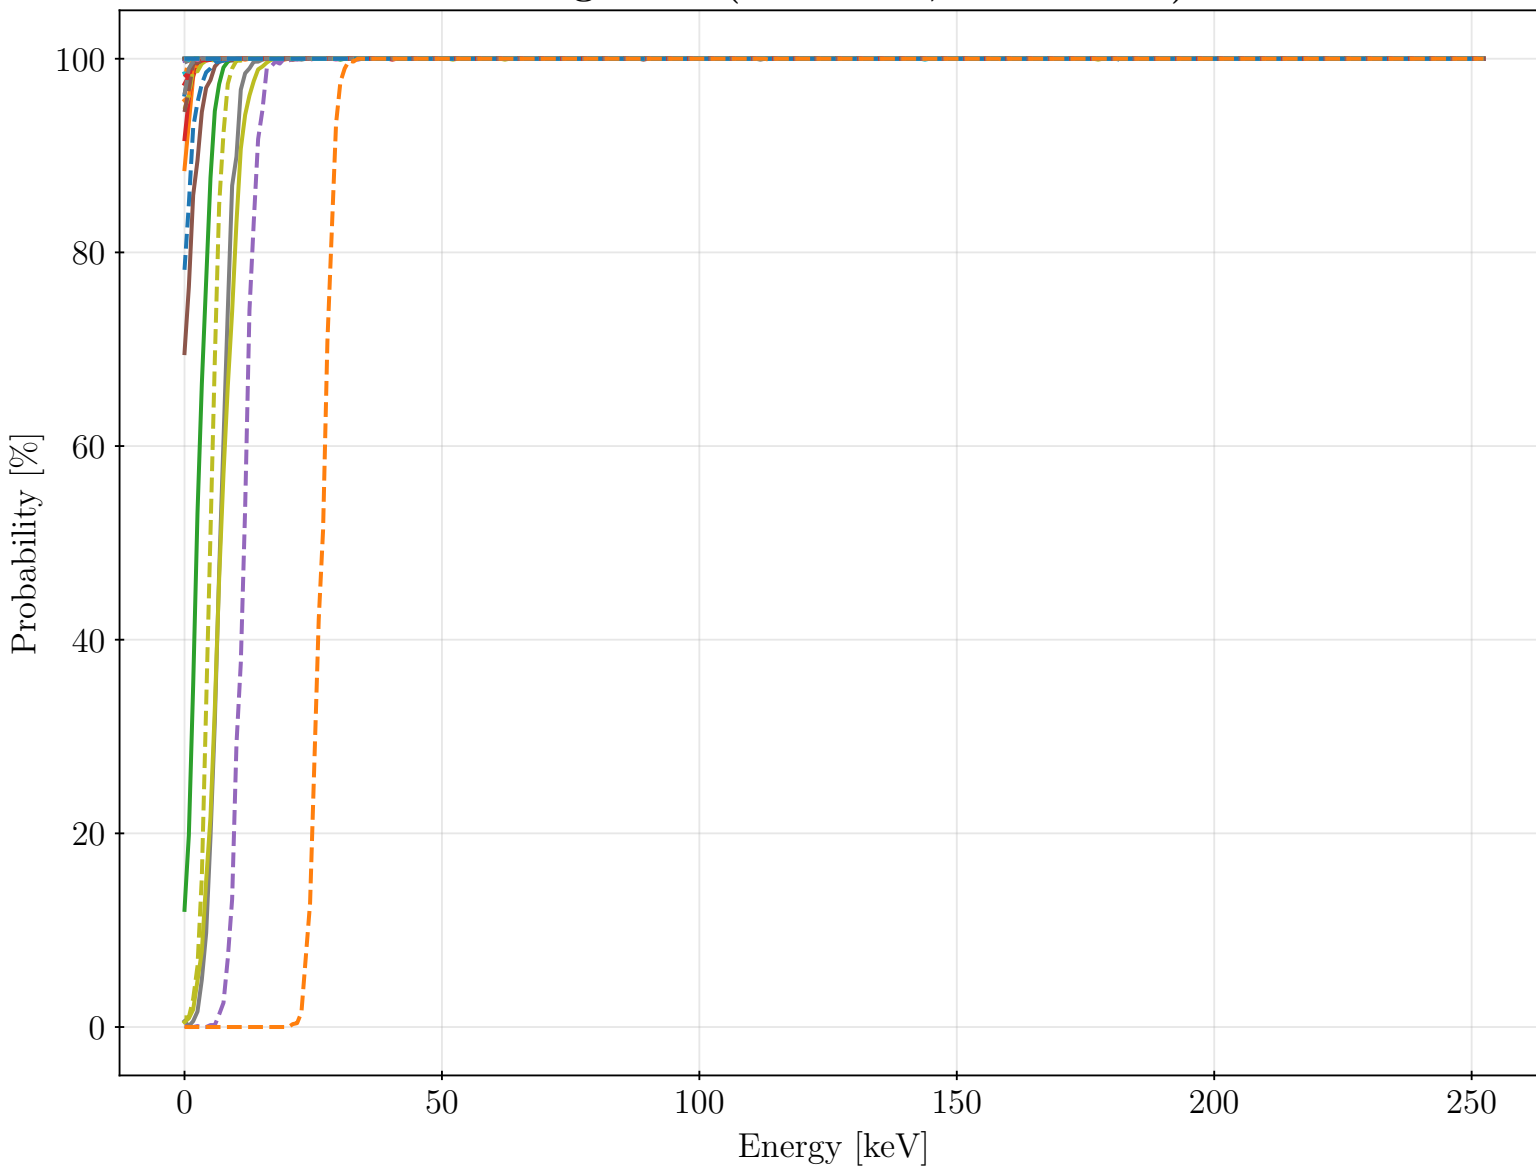

Channel			
0 THR: -4.17 keV ENC: 5.48 keV	16 THR: -36.0 keV ENC: 26.87 keV		
1 THR: -2.56 keV ENC: 5.05 keV	17 THR: -9.36 keV ENC: 8.28 keV		
2 THR: 2.49 keV ENC: 5.01 keV	18 THR: -5.75 keV ENC: 8.39 keV		
3 THR: -3.22 keV ENC: 5.46 keV	19 THR: -66.31 keV ENC: 48.35 keV		
4 THR: -559.25 keV ENC: 340.03 keV	20 THR: -2.12 keV ENC: 6.46 keV		
5 THR: -1.57 keV ENC: 7.42 keV	21 THR: -9.9 keV ENC: 10.38 keV		
6 THR: -60.13 keV ENC: 26.17 keV	22 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		
7 THR: 6.95 keV ENC: 5.17 keV	23 THR: -7.88 keV ENC: 8.99 keV		
8 THR: 7.19 keV ENC: 6.82 keV	24 THR: 11.46 keV ENC: 4.87 keV		
9 THR: -7.95 keV ENC: 8.76 keV	25 THR: -3.79 keV ENC: 5.62 keV		
10 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	26 THR: -86.64 keV ENC: 56.61 keV		
11 THR: -5.66 keV ENC: 7.95 keV	27 THR: -2.91 keV ENC: 3.82 keV		
12 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	28 THR: 5.01 keV ENC: 4.03 keV		
13 THR: -6.4 keV ENC: 7.8 keV	29 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		
14 THR: -8.11 keV ENC: 6.64 keV	30 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		
15 THR: -425.85 keV ENC: 263.67 keV	31 THR: 26.62 keV ENC: 4.89 keV		