


Charge scan (THR: 220, 1000 events)

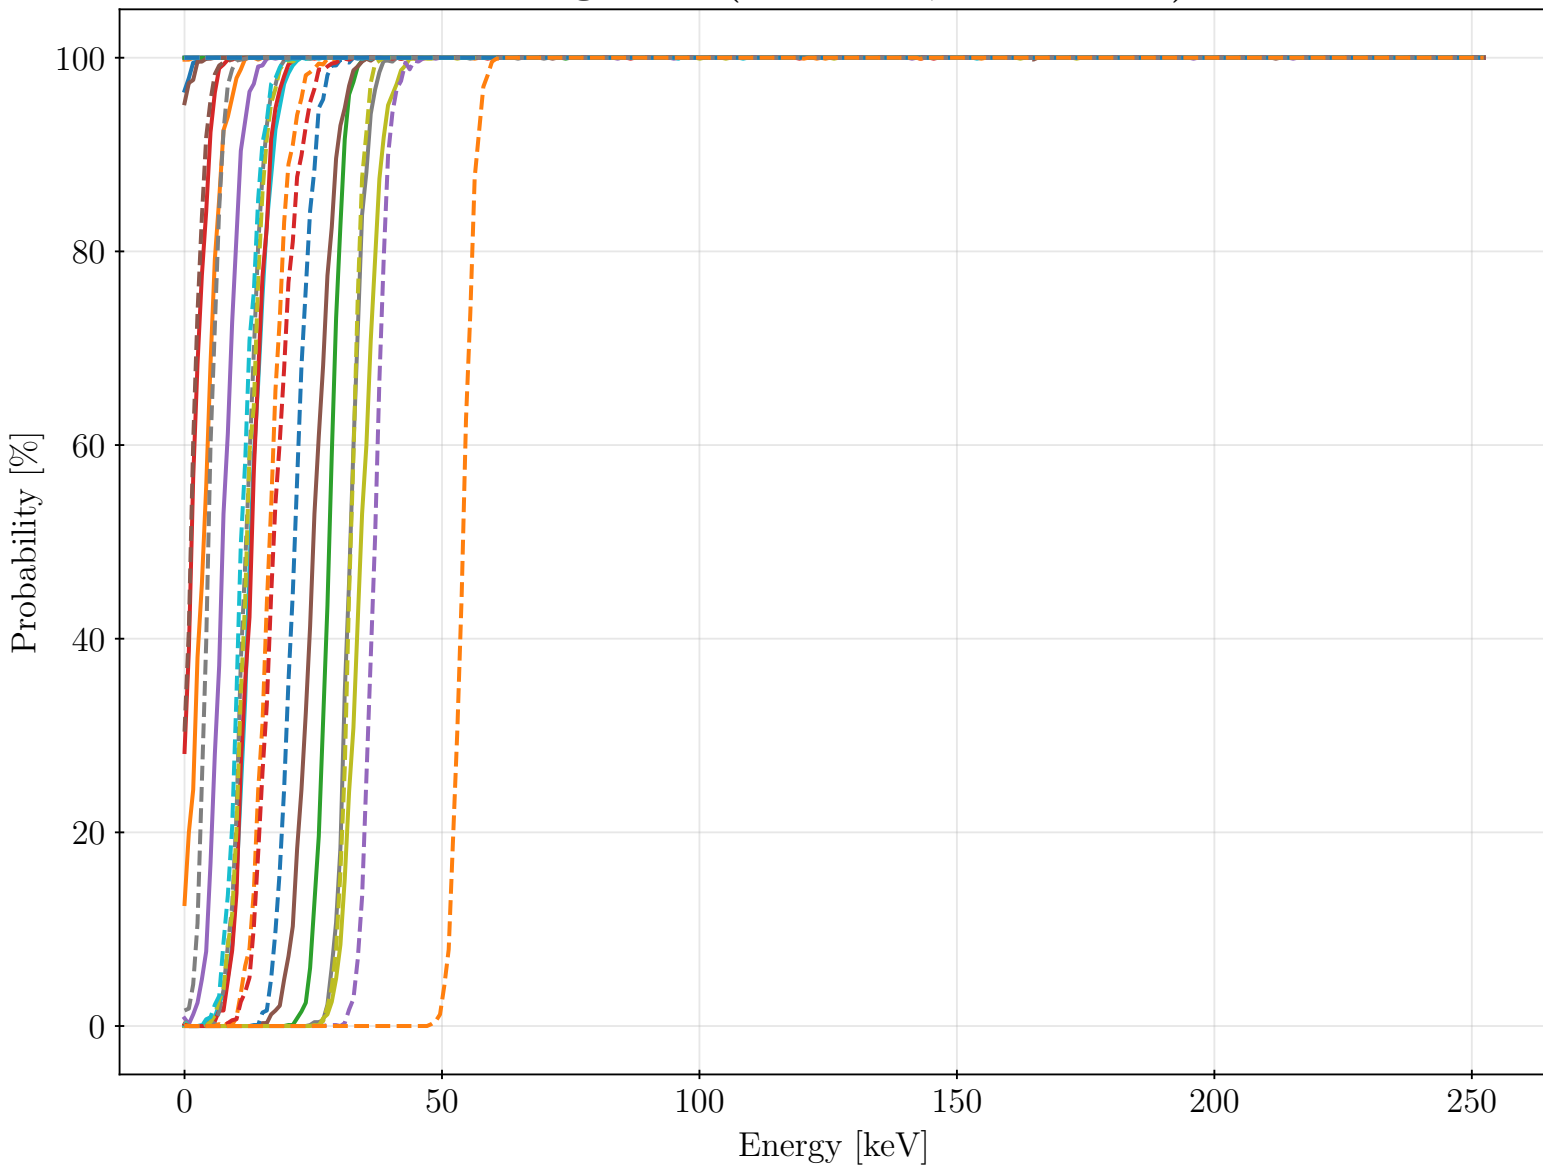

Channel			
0 THR: -5.17 keV ENC: 6.71 keV	16 THR: -0.78 keV ENC: 0.59 keV		
1 THR: -11.39 keV ENC: 9.43 keV	17 THR: 12.02 keV ENC: 6.19 keV		
2 THR: 28.05 keV ENC: 5.48 keV	18 THR: 12.22 keV ENC: 6.43 keV		
3 THR: 1.42 keV ENC: 5.93 keV	19 THR: 11.26 keV ENC: 6.48 keV		
4 THR: -409.83 keV ENC: 244.69 keV	20 THR: 21.4 keV ENC: 6.94 keV		
5 THR: 25.14 keV ENC: 8.22 keV	21 THR: 16.55 keV ENC: 7.15 keV		
6 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	22 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		
7 THR: 32.24 keV ENC: 5.61 keV	23 THR: 17.58 keV ENC: 8.54 keV		
8 THR: 34.37 keV ENC: 7.43 keV	24 THR: 36.89 keV ENC: 5.2 keV		
9 THR: 13.02 keV ENC: 7.11 keV	25 THR: 1.19 keV ENC: 5.12 keV		
10 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	26 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		
11 THR: 3.59 keV ENC: 7.12 keV	27 THR: 4.7 keV ENC: 4.49 keV		
12 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	28 THR: 32.29 keV ENC: 4.71 keV		
13 THR: 13.0 keV ENC: 6.77 keV	29 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		
14 THR: 7.58 keV ENC: 6.29 keV	30 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		
15 THR: -6.01 keV ENC: 8.44 keV	31 THR: 54.06 keV ENC: 4.93 keV		