


Charge scan (THR: 209, 1000 events)

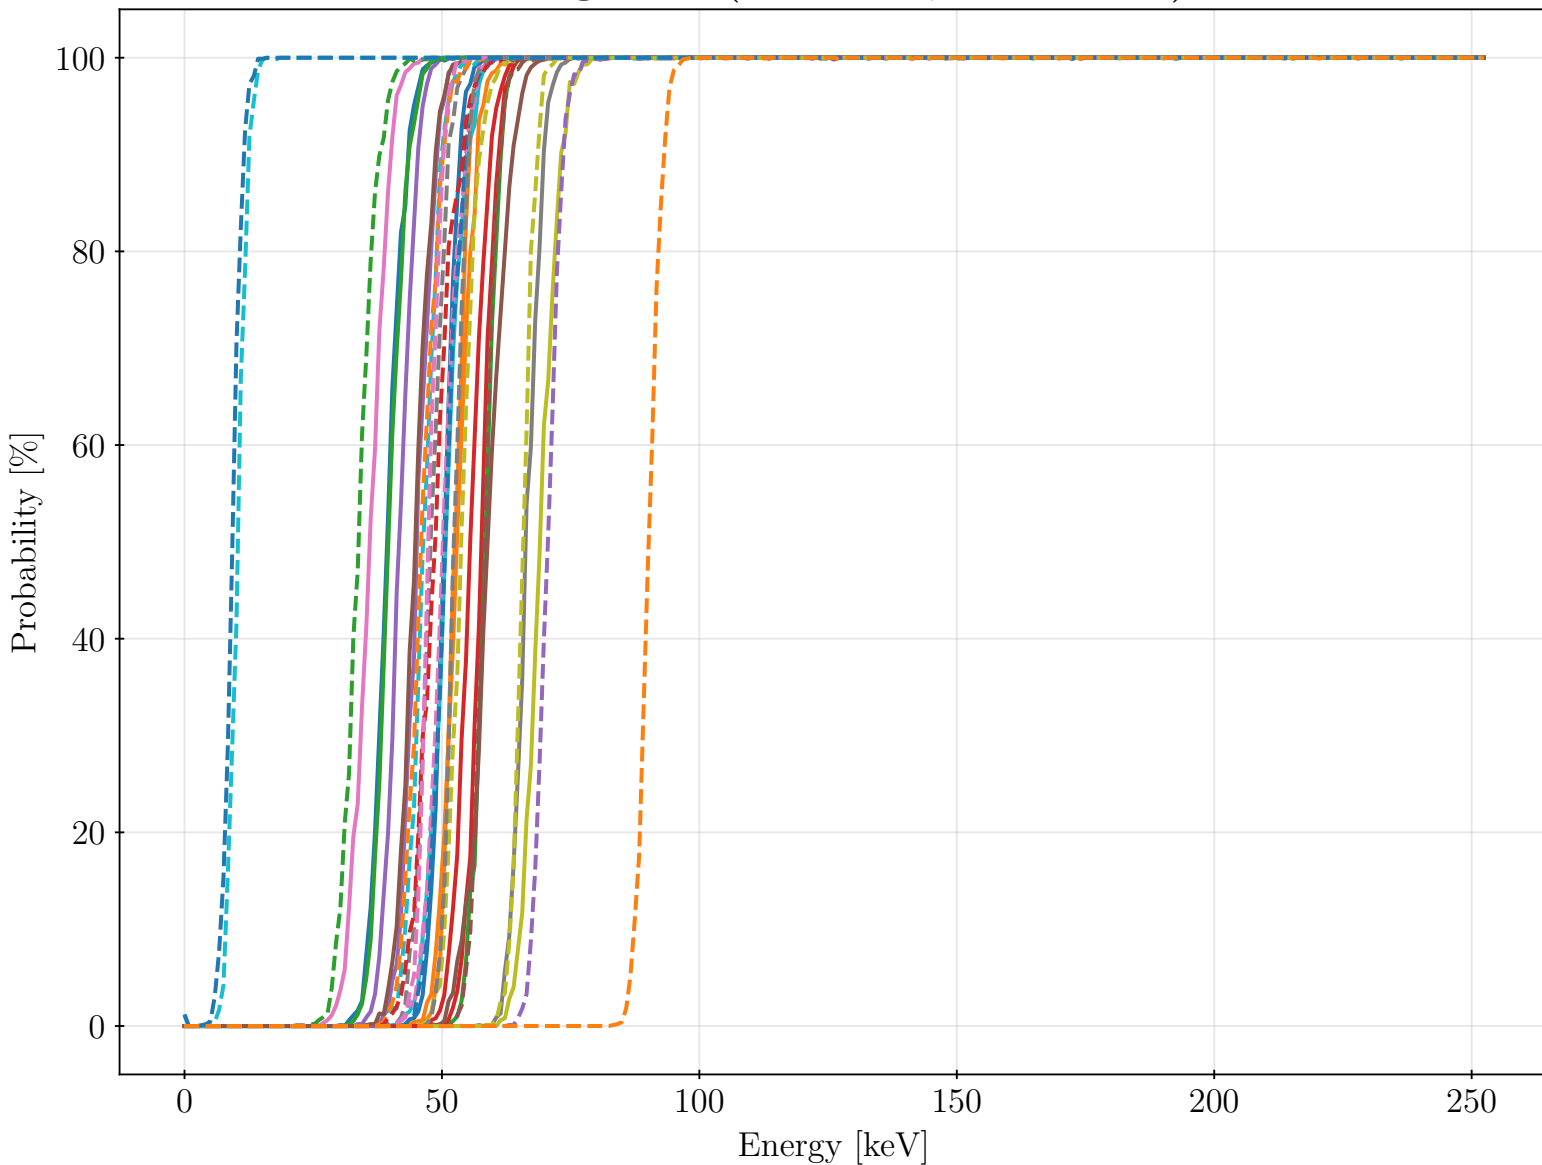

Channel	
0 THR: 50.45 keV ENC: 5.49 keV	16 THR: 50.29 keV ENC: 7.39 keV
1 THR: 52.57 keV ENC: 5.3 keV	17 THR: 47.9 keV ENC: 6.49 keV
2 THR: 58.39 keV ENC: 5.57 keV	18 THR: 53.78 keV ENC: 6.33 keV
3 THR: 57.65 keV ENC: 5.92 keV	19 THR: 46.5 keV ENC: 6.61 keV
4 THR: 41.79 keV ENC: 6.52 keV	20 THR: 50.7 keV ENC: 6.8 keV
5 THR: 59.03 keV ENC: 8.52 keV	21 THR: 46.13 keV ENC: 7.37 keV
6 THR: 35.99 keV ENC: 7.78 keV	22 THR: 33.75 keV ENC: 7.29 keV
7 THR: 66.48 keV ENC: 6.23 keV	23 THR: 48.57 keV ENC: 8.78 keV
8 THR: 69.12 keV ENC: 7.49 keV	24 THR: 70.52 keV ENC: 5.71 keV
9 THR: 50.71 keV ENC: 7.61 keV	25 THR: 58.25 keV ENC: 5.31 keV
10 THR: 39.39 keV ENC: 6.85 keV	26 THR: 47.47 keV ENC: 4.79 keV
11 THR: 52.97 keV ENC: 7.08 keV	27 THR: 52.45 keV ENC: 4.8 keV
12 THR: 39.73 keV ENC: 6.81 keV	28 THR: 65.77 keV ENC: 4.73 keV
13 THR: 55.57 keV ENC: 7.02 keV	29 THR: 10.31 keV ENC: 4.12 keV
14 THR: 45.25 keV ENC: 6.81 keV	30 THR: 9.29 keV ENC: 3.99 keV
15 THR: 44.79 keV ENC: 7.06 keV	31 THR: 90.19 keV ENC: 5.16 keV