


Charge scan (THR: 206, 1000 events)

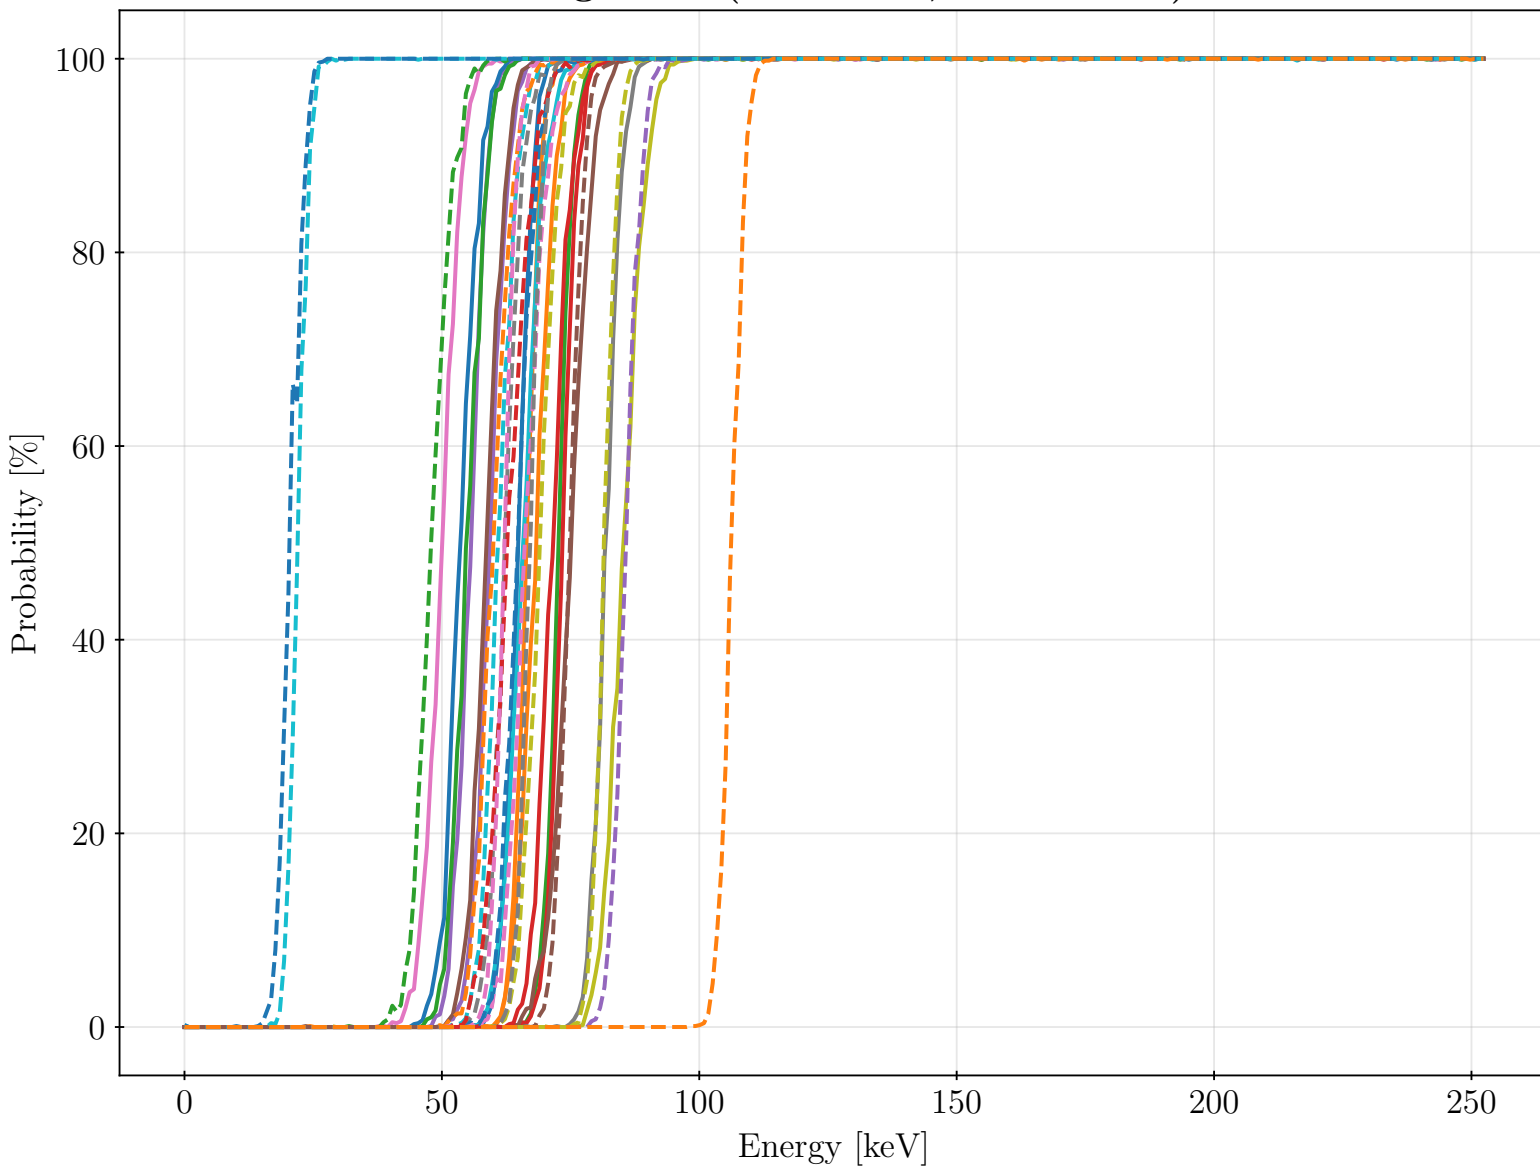

Channel			
0 THR: 64.79 keV ENC: 5.95 keV	16 THR: 66.32 keV ENC: 8.05 keV		
1 THR: 66.48 keV ENC: 5.42 keV	17 THR: 62.36 keV ENC: 6.59 keV		
2 THR: 72.66 keV ENC: 5.45 keV	18 THR: 69.05 keV ENC: 7.43 keV		
3 THR: 73.39 keV ENC: 5.96 keV	19 THR: 61.04 keV ENC: 7.15 keV		
4 THR: 55.51 keV ENC: 6.69 keV	20 THR: 64.72 keV ENC: 7.22 keV		
5 THR: 75.04 keV ENC: 8.58 keV	21 THR: 59.99 keV ENC: 7.81 keV		
6 THR: 50.02 keV ENC: 7.73 keV	22 THR: 48.07 keV ENC: 8.25 keV		
7 THR: 81.9 keV ENC: 6.07 keV	23 THR: 62.97 keV ENC: 9.27 keV		
8 THR: 85.37 keV ENC: 8.39 keV	24 THR: 85.75 keV ENC: 5.86 keV		
9 THR: 65.76 keV ENC: 8.27 keV	25 THR: 74.8 keV ENC: 5.76 keV		
10 THR: 53.65 keV ENC: 7.54 keV	26 THR: 62.12 keV ENC: 4.79 keV		
11 THR: 68.19 keV ENC: 7.71 keV	27 THR: 67.05 keV ENC: 4.91 keV		
12 THR: 54.99 keV ENC: 7.6 keV	28 THR: 81.61 keV ENC: 4.97 keV		
13 THR: 71.47 keV ENC: 7.6 keV	29 THR: 22.0 keV ENC: 4.35 keV		
14 THR: 59.31 keV ENC: 6.96 keV	30 THR: 20.56 keV ENC: 5.43 keV		
15 THR: 58.7 keV ENC: 7.4 keV	31 THR: 106.35 keV ENC: 5.19 keV		