


Charge scan (THR: 221, 1000 events)

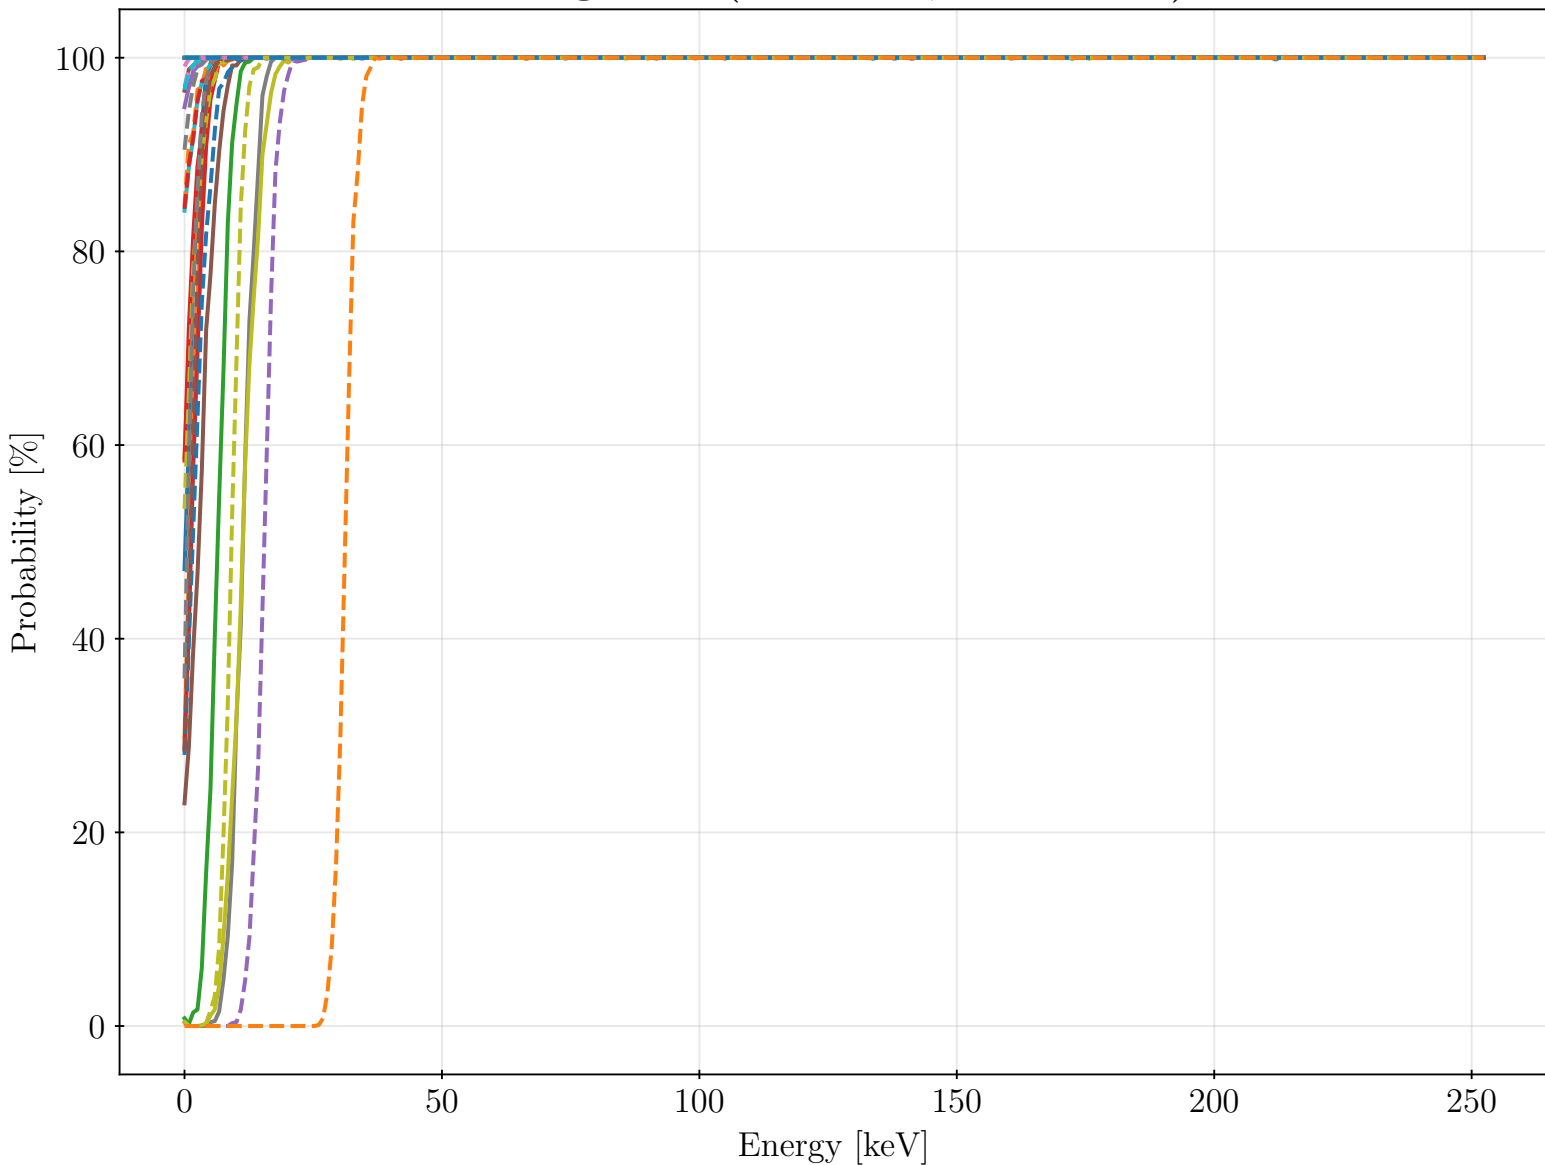

Channel	
0 THR: 0.2 keV ENC: 4.8 keV	16 THR: -5.36 keV ENC: 6.66 keV
1 THR: 1.03 keV ENC: 4.8 keV	17 THR: -3.62 keV ENC: 6.51 keV
2 THR: 6.47 keV ENC: 4.99 keV	18 THR: -0.29 keV ENC: 6.57 keV
3 THR: 1.3 keV ENC: 5.25 keV	19 THR: -5.17 keV ENC: 6.58 keV
4 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	20 THR: 1.61 keV ENC: 6.76 keV
5 THR: 2.61 keV ENC: 7.48 keV	21 THR: -3.71 keV ENC: 8.39 keV
6 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	22 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV
7 THR: 11.34 keV ENC: 5.4 keV	23 THR: -3.93 keV ENC: 9.18 keV
8 THR: 11.38 keV ENC: 6.87 keV	24 THR: 15.45 keV ENC: 4.77 keV
9 THR: -3.59 keV ENC: 8.56 keV	25 THR: 1.08 keV ENC: 4.33 keV
10 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	26 THR: -2.75 keV ENC: 2.73 keV
11 THR: -0.66 keV ENC: 7.02 keV	27 THR: 0.55 keV ENC: 4.03 keV
12 THR: -196.09 keV ENC: 121.96 keV	28 THR: 9.15 keV ENC: 4.22 keV
13 THR: -0.64 keV ENC: 6.26 keV	29 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV
14 THR: -5.56 keV ENC: 7.99 keV	30 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV
15 THR: -4.58 keV ENC: 5.86 keV	31 THR: 31.2 keV ENC: 4.33 keV