


Charge scan (THR: 223, 1000 events)

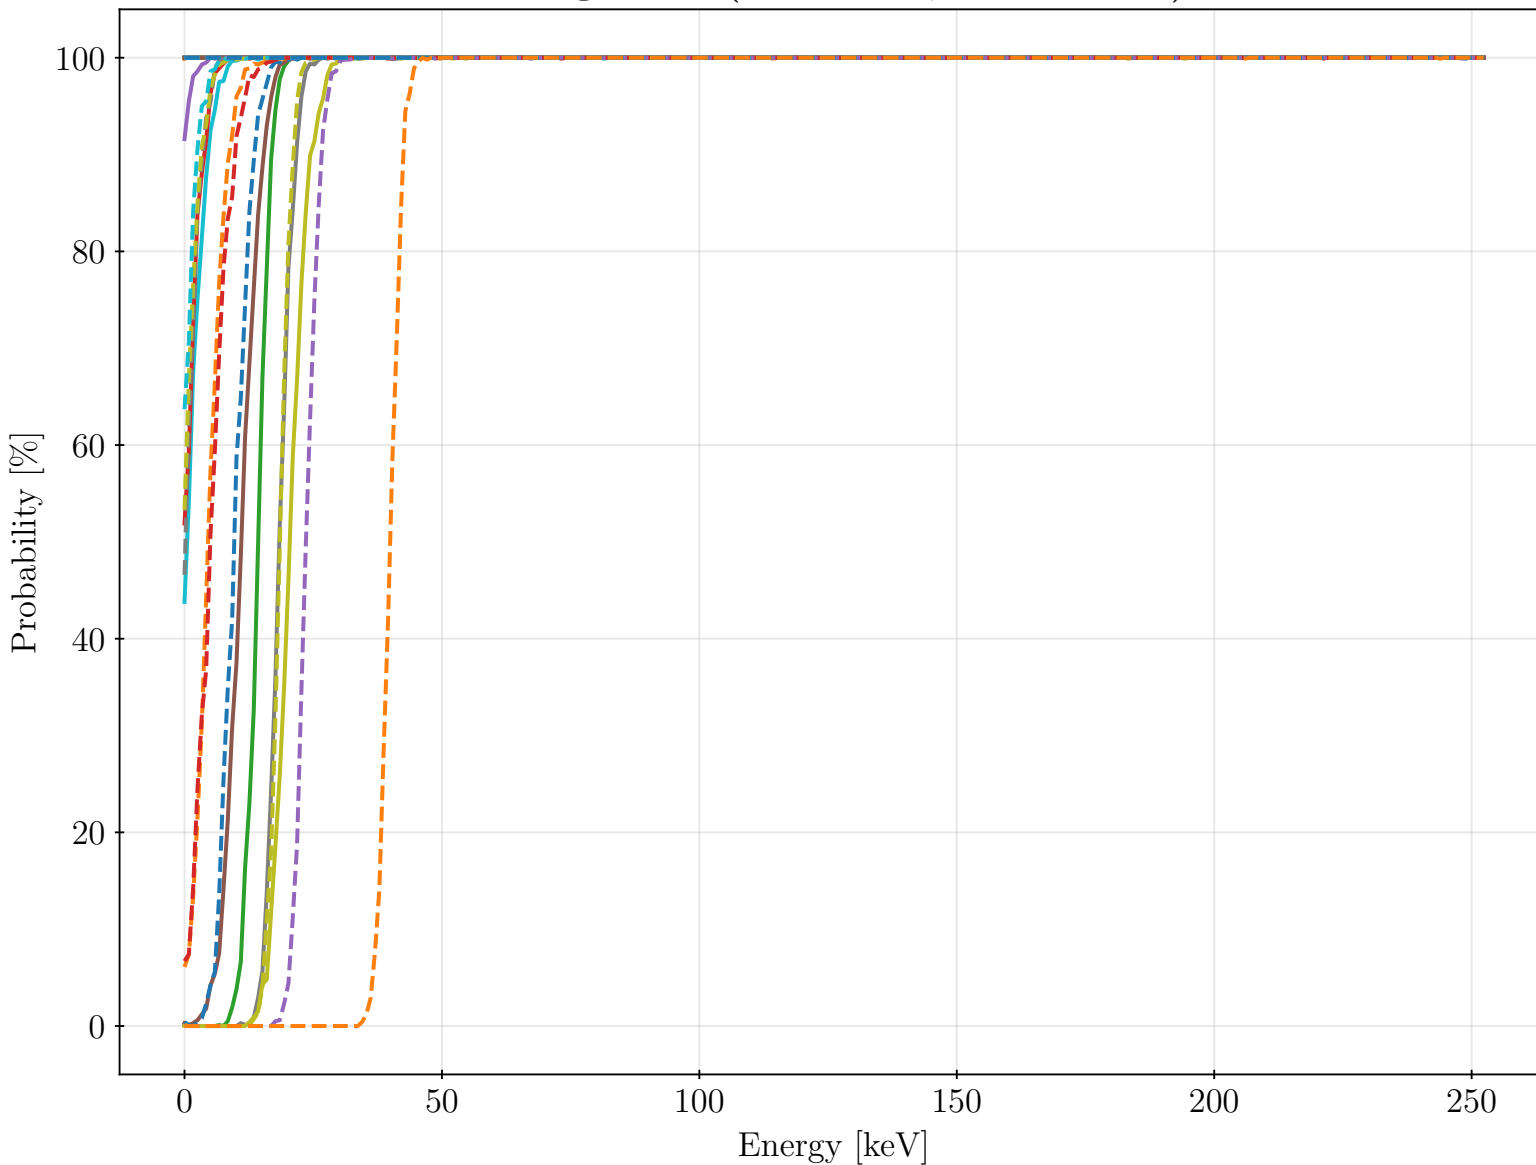

Channel			
0 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	16 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	32 THR: 39.96 keV ENC: 4.85 keV	
1 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	17 THR: 0.13 keV ENC: 5.97 keV		
2 THR: 14.24 keV ENC: 5.15 keV	18 THR: -0.31 keV ENC: 6.57 keV		
3 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	19 THR: -0.85 keV ENC: 6.28 keV		
4 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	20 THR: 9.72 keV ENC: 6.82 keV		
5 THR: 11.04 keV ENC: 7.69 keV	21 THR: 4.7 keV ENC: 6.75 keV		
6 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	22 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		
7 THR: 18.49 keV ENC: 5.48 keV	23 THR: 5.11 keV ENC: 8.07 keV		
8 THR: 20.5 keV ENC: 7.3 keV	24 THR: 23.68 keV ENC: 5.23 keV		
9 THR: 0.43 keV ENC: 7.52 keV	25 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		
10 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	26 THR: -255.54 keV ENC: 156.58 keV		
11 THR: -1.1 keV ENC: 0.84 keV	27 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		
12 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	28 THR: 18.54 keV ENC: 4.56 keV		
13 THR: -0.04 keV ENC: 6.75 keV	29 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		
14 THR: -3.81 keV ENC: 6.48 keV	30 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV		
15 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV			