


Charge scan (THR: 219, 1000 events)

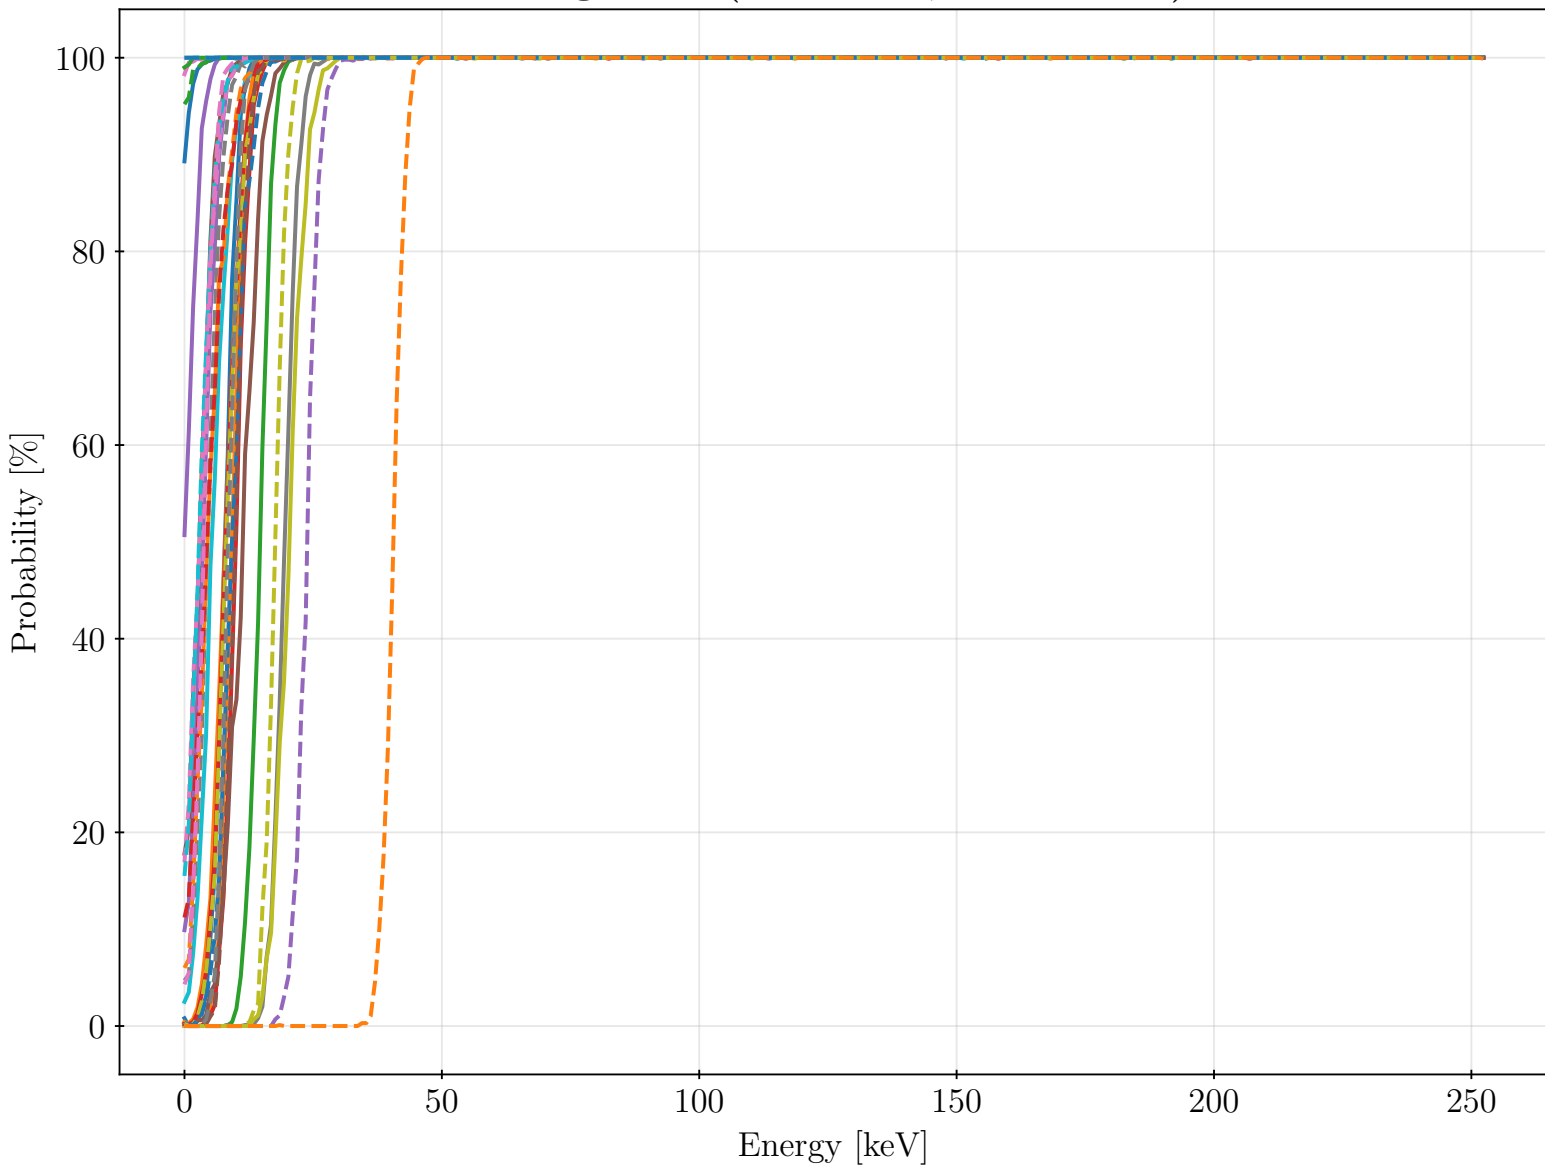

Channel			
0	THR: 7.84 keV ENC: 4.81 keV	16	THR: 2.85 keV ENC: 6.72 keV
1	THR: 9.17 keV ENC: 4.79 keV	17	THR: 4.48 keV ENC: 5.52 keV
2	THR: 14.61 keV ENC: 5.02 keV	18	THR: 8.24 keV ENC: 6.2 keV
3	THR: 9.93 keV ENC: 5.03 keV	19	THR: 2.83 keV ENC: 6.2 keV
4	THR: 0.03 keV ENC: 5.86 keV	20	THR: 9.3 keV ENC: 6.46 keV
5	THR: 11.23 keV ENC: 7.65 keV	21	THR: 4.67 keV ENC: 7.34 keV
6	THR: -5.23 keV ENC: 5.77 keV	22	THR: -6.3 keV ENC: 9.05 keV
7	THR: 19.48 keV ENC: 5.3 keV	23	THR: 4.42 keV ENC: 8.38 keV
8	THR: 20.3 keV ENC: 6.82 keV	24	THR: 23.74 keV ENC: 4.98 keV
9	THR: 5.52 keV ENC: 6.68 keV	25	THR: 9.79 keV ENC: 4.85 keV
10	THR: -3.14 keV ENC: 5.94 keV	26	THR: 3.72 keV ENC: 4.34 keV
11	THR: 7.96 keV ENC: 6.64 keV	27	THR: 8.55 keV ENC: 4.31 keV
12	THR: -6.7 keV ENC: 6.83 keV	28	THR: 17.62 keV ENC: 4.55 keV
13	THR: 8.12 keV ENC: 6.19 keV	29	THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV
14	THR: 3.55 keV ENC: 5.98 keV	30	THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV
15	THR: 2.83 keV ENC: 6.21 keV	31	THR: 40.56 keV ENC: 4.65 keV