


Charge scan (THR: 222, 1000 events)

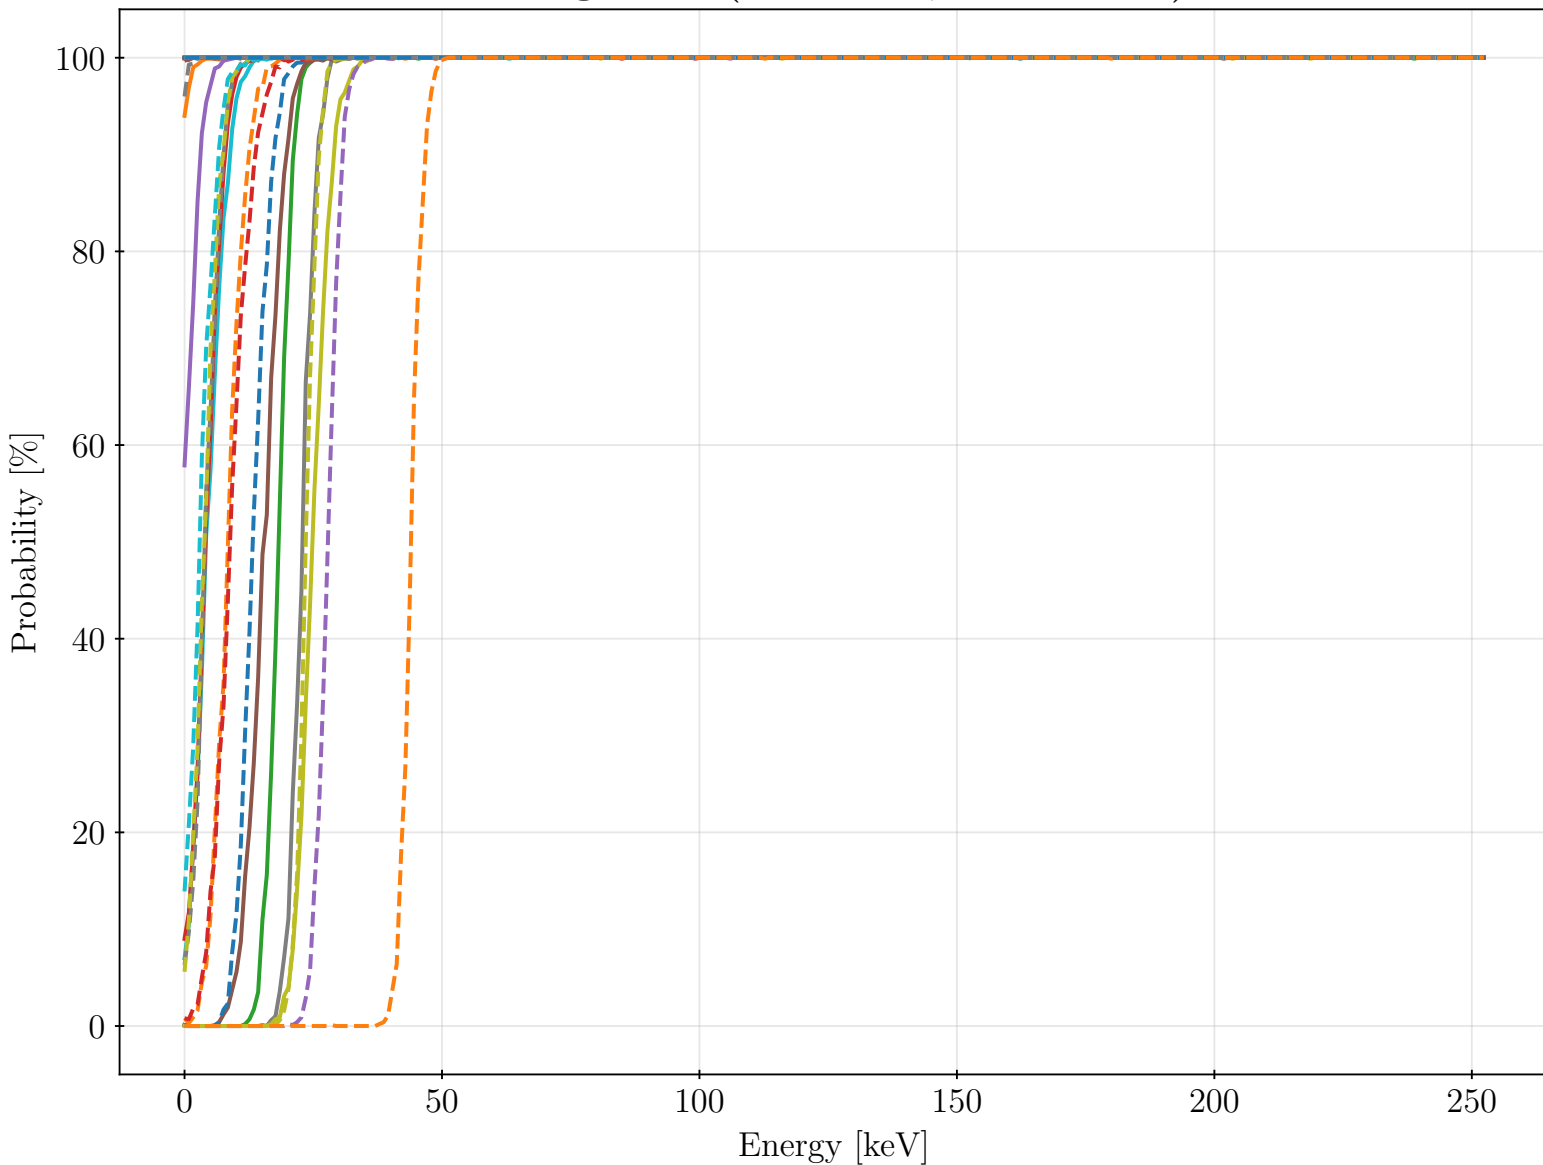

Channel			
0 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	16 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	32	
1 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	17 THR: 4.16 keV ENC: 6.05 keV	31	THR: 44.0 keV ENC: 4.66 keV
2 THR: 18.27 keV ENC: 5.4 keV	18 THR: 3.88 keV ENC: 6.02 keV	30	THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV
3 THR: -16.34 keV ENC: 12.88 keV	19 THR: 3.01 keV ENC: 6.34 keV	29	THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV
4 THR: -60.48 keV ENC: 26.32 keV	20 THR: 13.38 keV ENC: 6.9 keV	28	THR: 23.63 keV ENC: 4.45 keV
5 THR: 15.45 keV ENC: 7.98 keV	21 THR: 8.44 keV ENC: 6.98 keV	27	THR: -2.37 keV ENC: 3.17 keV
6 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	22 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	26	THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV
7 THR: 22.83 keV ENC: 5.52 keV	23 THR: 8.95 keV ENC: 8.28 keV	25	THR: -8.75 keV ENC: 7.53 keV
8 THR: 24.96 keV ENC: 7.06 keV	24 THR: 27.82 keV ENC: 5.32 keV	24	THR: 27.82 keV ENC: 5.32 keV
9 THR: 4.47 keV ENC: 7.46 keV	25 THR: -8.75 keV ENC: 7.53 keV	23	THR: 8.95 keV ENC: 8.28 keV
10 THR: -82.74 keV ENC: 54.13 keV	26 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	22	THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV
11 THR: -3.9 keV ENC: 5.91 keV	27 THR: -2.37 keV ENC: 3.17 keV	21	THR: 8.44 keV ENC: 6.98 keV
12 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	28 THR: 23.63 keV ENC: 4.45 keV	20	THR: 13.38 keV ENC: 6.9 keV
13 THR: 4.16 keV ENC: 6.67 keV	29 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	19	THR: 3.01 keV ENC: 6.34 keV
14 THR: -0.45 keV ENC: 6.8 keV	30 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	18	THR: 3.88 keV ENC: 6.02 keV
15 THR: -60.48 keV ENC: 26.32 keV	31 THR: 44.0 keV ENC: 4.66 keV	17	THR: 4.16 keV ENC: 6.05 keV