


Charge scan (THR: 200, 1000 events)

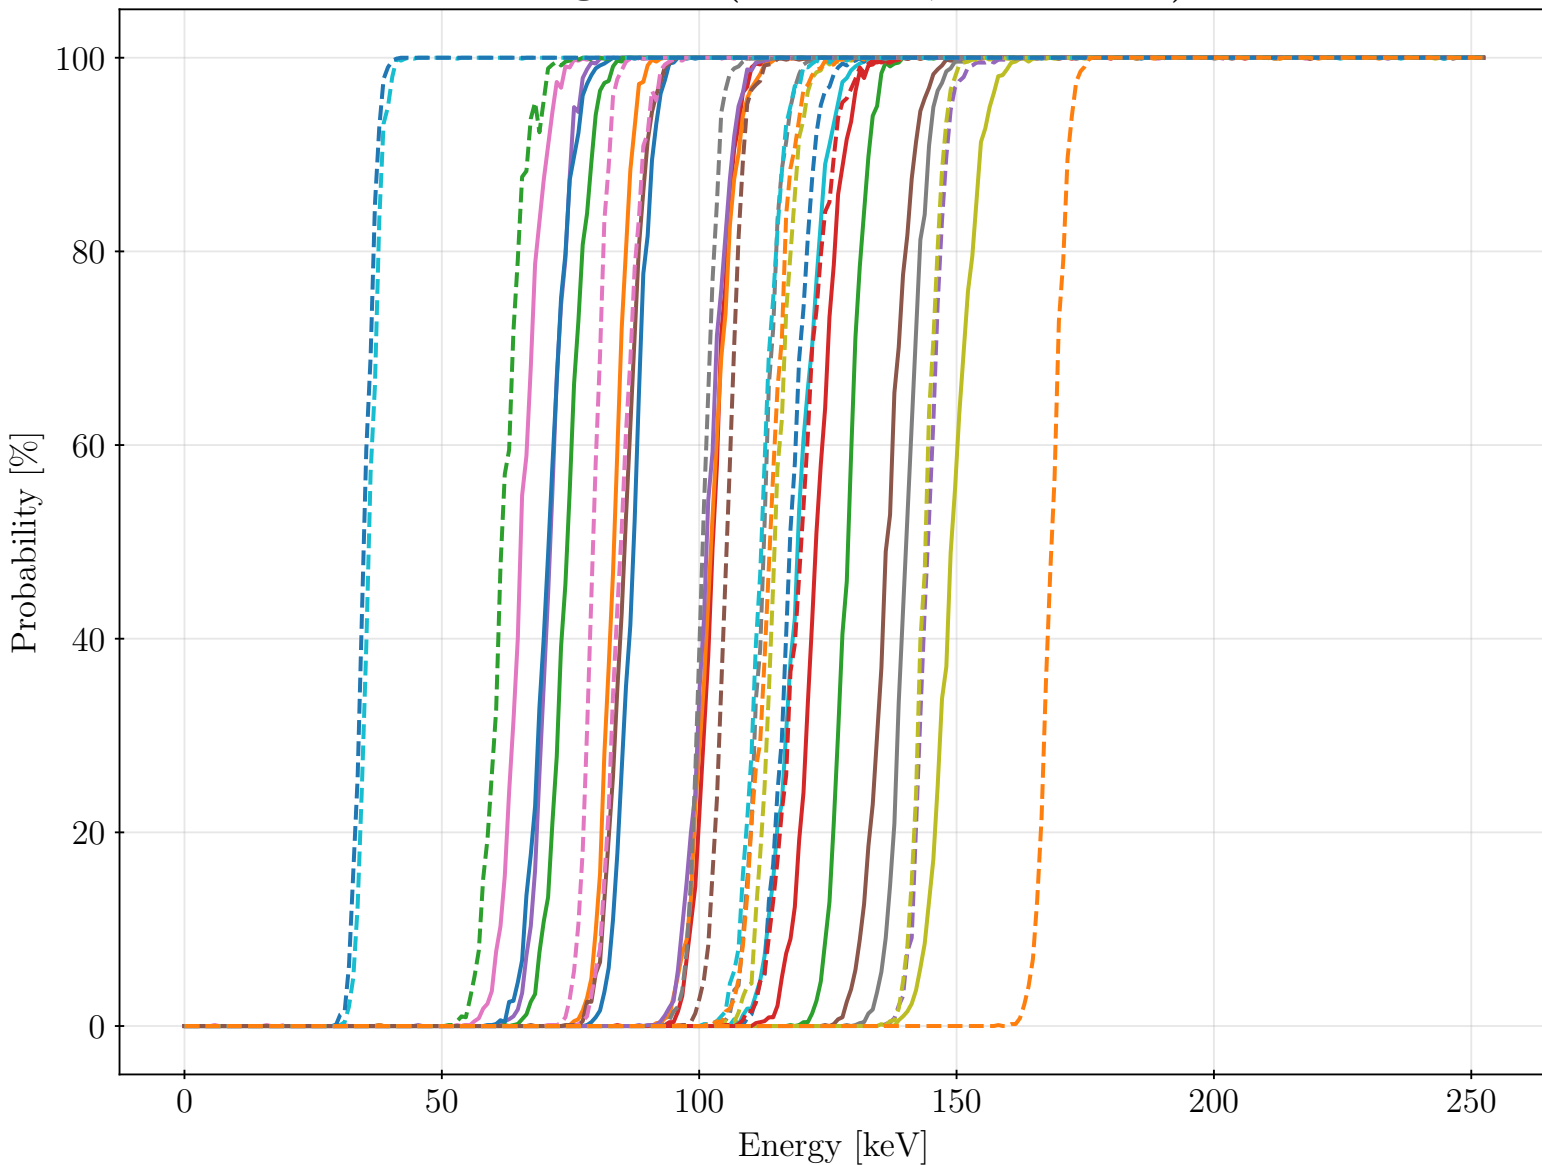

Channel			
0 THR: 87.08 keV ENC: 7.28 keV	16 THR: 84.87 keV ENC: 7.82 keV		
1 THR: 83.39 keV ENC: 6.48 keV	17 THR: 112.5 keV ENC: 7.08 keV		
2 THR: 128.76 keV ENC: 7.48 keV	18 THR: 114.87 keV ENC: 7.72 keV		
3 THR: 102.65 keV ENC: 7.67 keV	19 THR: 112.03 keV ENC: 7.91 keV		
4 THR: 71.09 keV ENC: 7.43 keV	20 THR: 117.8 keV ENC: 8.41 keV		
5 THR: 136.61 keV ENC: 9.47 keV	21 THR: 113.66 keV ENC: 8.85 keV		
6 THR: 65.57 keV ENC: 8.2 keV	22 THR: 61.91 keV ENC: 8.36 keV		
7 THR: 140.31 keV ENC: 7.51 keV	23 THR: 119.77 keV ENC: 11.23 keV		
8 THR: 149.23 keV ENC: 9.9 keV	24 THR: 144.46 keV ENC: 6.61 keV		
9 THR: 119.23 keV ENC: 10.77 keV	25 THR: 105.35 keV ENC: 6.21 keV		
10 THR: 70.76 keV ENC: 8.78 keV	26 THR: 79.43 keV ENC: 5.5 keV		
11 THR: 102.4 keV ENC: 9.23 keV	27 THR: 100.78 keV ENC: 5.62 keV		
12 THR: 74.35 keV ENC: 8.46 keV	28 THR: 143.93 keV ENC: 6.25 keV		
13 THR: 122.89 keV ENC: 9.4 keV	29 THR: 35.92 keV ENC: 4.8 keV		
14 THR: 101.59 keV ENC: 8.73 keV	30 THR: 34.94 keV ENC: 4.79 keV		
15 THR: 85.5 keV ENC: 7.99 keV	31 THR: 168.47 keV ENC: 6.0 keV		