


Charge scan (THR: 200, 1000 events)

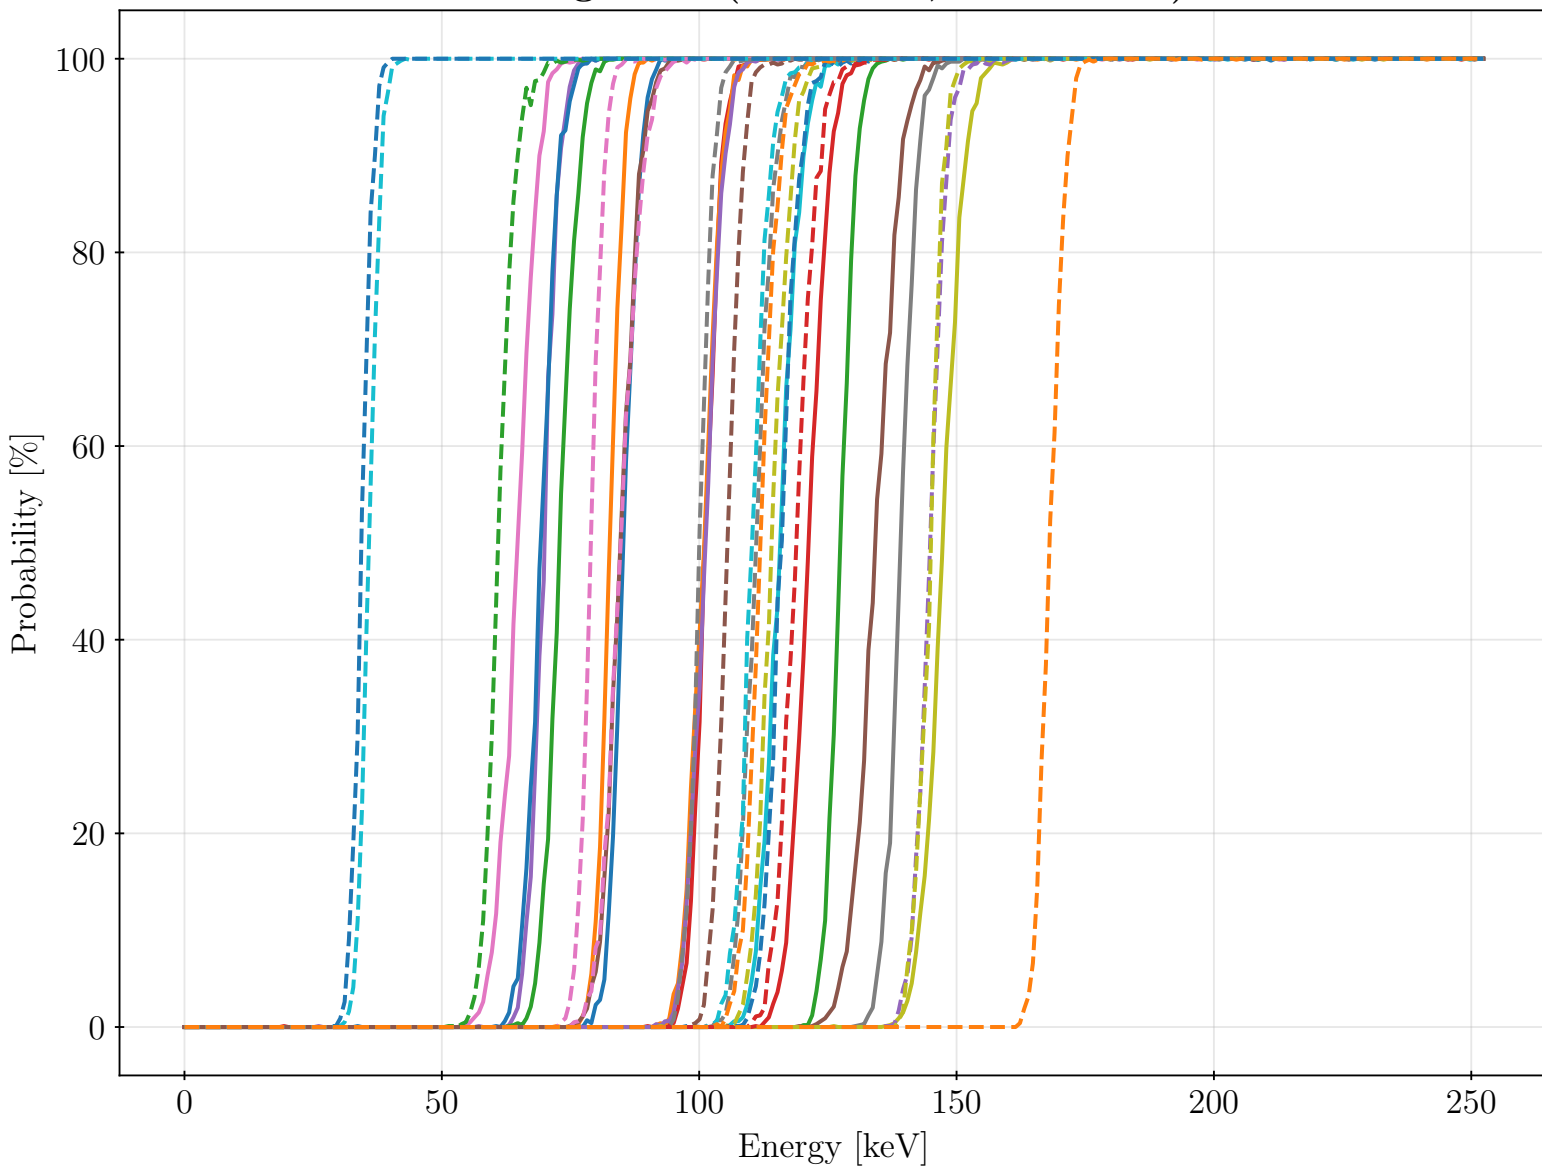

Channel			
0 THR: 85.38 keV ENC: 6.04 keV	16 THR: 84.82 keV ENC: 8.27 keV	17 THR: 111.05 keV ENC: 7.23 keV	18 THR: 114.18 keV ENC: 7.3 keV
1 THR: 82.66 keV ENC: 5.3 keV	19 THR: 110.32 keV ENC: 6.73 keV	20 THR: 115.94 keV ENC: 6.88 keV	21 THR: 111.96 keV ENC: 6.95 keV
2 THR: 127.45 keV ENC: 6.04 keV	22 THR: 61.06 keV ENC: 6.25 keV	23 THR: 118.84 keV ENC: 8.2 keV	24 THR: 144.84 keV ENC: 6.47 keV
3 THR: 101.26 keV ENC: 6.15 keV	25 THR: 105.48 keV ENC: 5.88 keV	26 THR: 78.97 keV ENC: 4.97 keV	27 THR: 100.13 keV ENC: 5.13 keV
4 THR: 69.77 keV ENC: 5.99 keV	28 THR: 144.8 keV ENC: 5.76 keV	29 THR: 35.9 keV ENC: 4.47 keV	30 THR: 34.44 keV ENC: 4.23 keV
5 THR: 134.32 keV ENC: 9.66 keV	31 THR: 168.2 keV ENC: 5.93 keV		
6 THR: 64.71 keV ENC: 8.06 keV			
7 THR: 139.18 keV ENC: 6.43 keV			
8 THR: 147.34 keV ENC: 8.31 keV			
9 THR: 115.67 keV ENC: 8.22 keV			
10 THR: 69.32 keV ENC: 6.87 keV			
11 THR: 100.82 keV ENC: 7.35 keV			
12 THR: 72.98 keV ENC: 7.03 keV			
13 THR: 121.28 keV ENC: 8.1 keV			
14 THR: 101.14 keV ENC: 7.24 keV			
15 THR: 84.77 keV ENC: 7.59 keV			