


Charge scan (THR: 225, 1000 events)

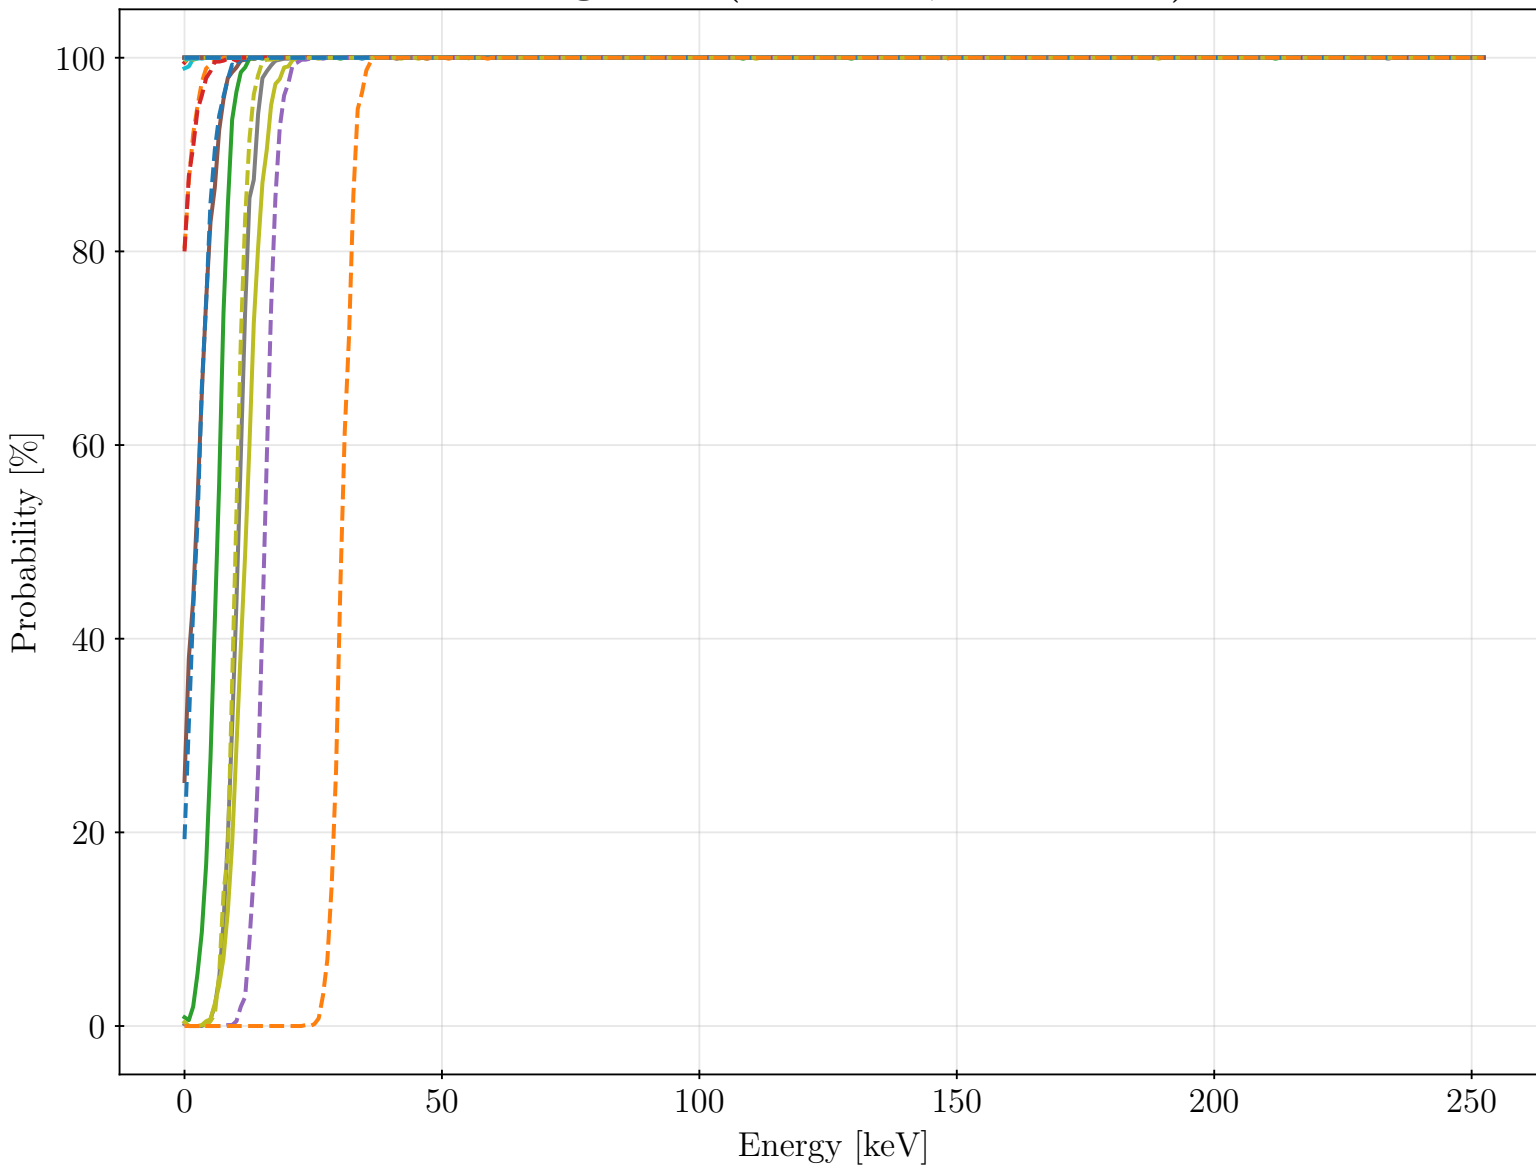

Channel			
0 THR: -35.84 keV ENC: 15.68 keV	16 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	32	
1 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	17 THR: -25.02 keV ENC: 19.62 keV	31	THR: 30.63 keV ENC: 4.72 keV
2 THR: 6.29 keV ENC: 4.99 keV	18 THR: -8.54 keV ENC: 7.47 keV	30	THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV
3 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	19 THR: -18.11 keV ENC: 14.75 keV	29	THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV
4 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	20 THR: 2.28 keV ENC: 6.55 keV	28	THR: 9.94 keV ENC: 4.47 keV
5 THR: 2.07 keV ENC: 7.66 keV	21 THR: -2.63 keV ENC: 7.21 keV	27	THR: -110.13 keV ENC: 70.83 keV
6 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	22 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	26	THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV
7 THR: 10.41 keV ENC: 5.4 keV	23 THR: -3.04 keV ENC: 8.24 keV	25	THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV
8 THR: 11.81 keV ENC: 6.95 keV	24 THR: 15.53 keV ENC: 4.81 keV	24	THR: 15.53 keV ENC: 4.81 keV
9 THR: -7.73 keV ENC: 8.03 keV	25 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	23	THR: -3.04 keV ENC: 8.24 keV
10 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	26 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	22	THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV
11 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	27 THR: -110.13 keV ENC: 70.83 keV	21	THR: -2.63 keV ENC: 7.21 keV
12 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	28 THR: 9.94 keV ENC: 4.47 keV	20	THR: 2.28 keV ENC: 6.55 keV
13 THR: -0.75 keV ENC: 0.68 keV	29 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	19	THR: -18.11 keV ENC: 14.75 keV
14 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	30 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	18	THR: -8.54 keV ENC: 7.47 keV
15 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	31 THR: 30.63 keV ENC: 4.72 keV	17	THR: -25.02 keV ENC: 19.62 keV