


Charge scan (THR: 212, 1000 events)

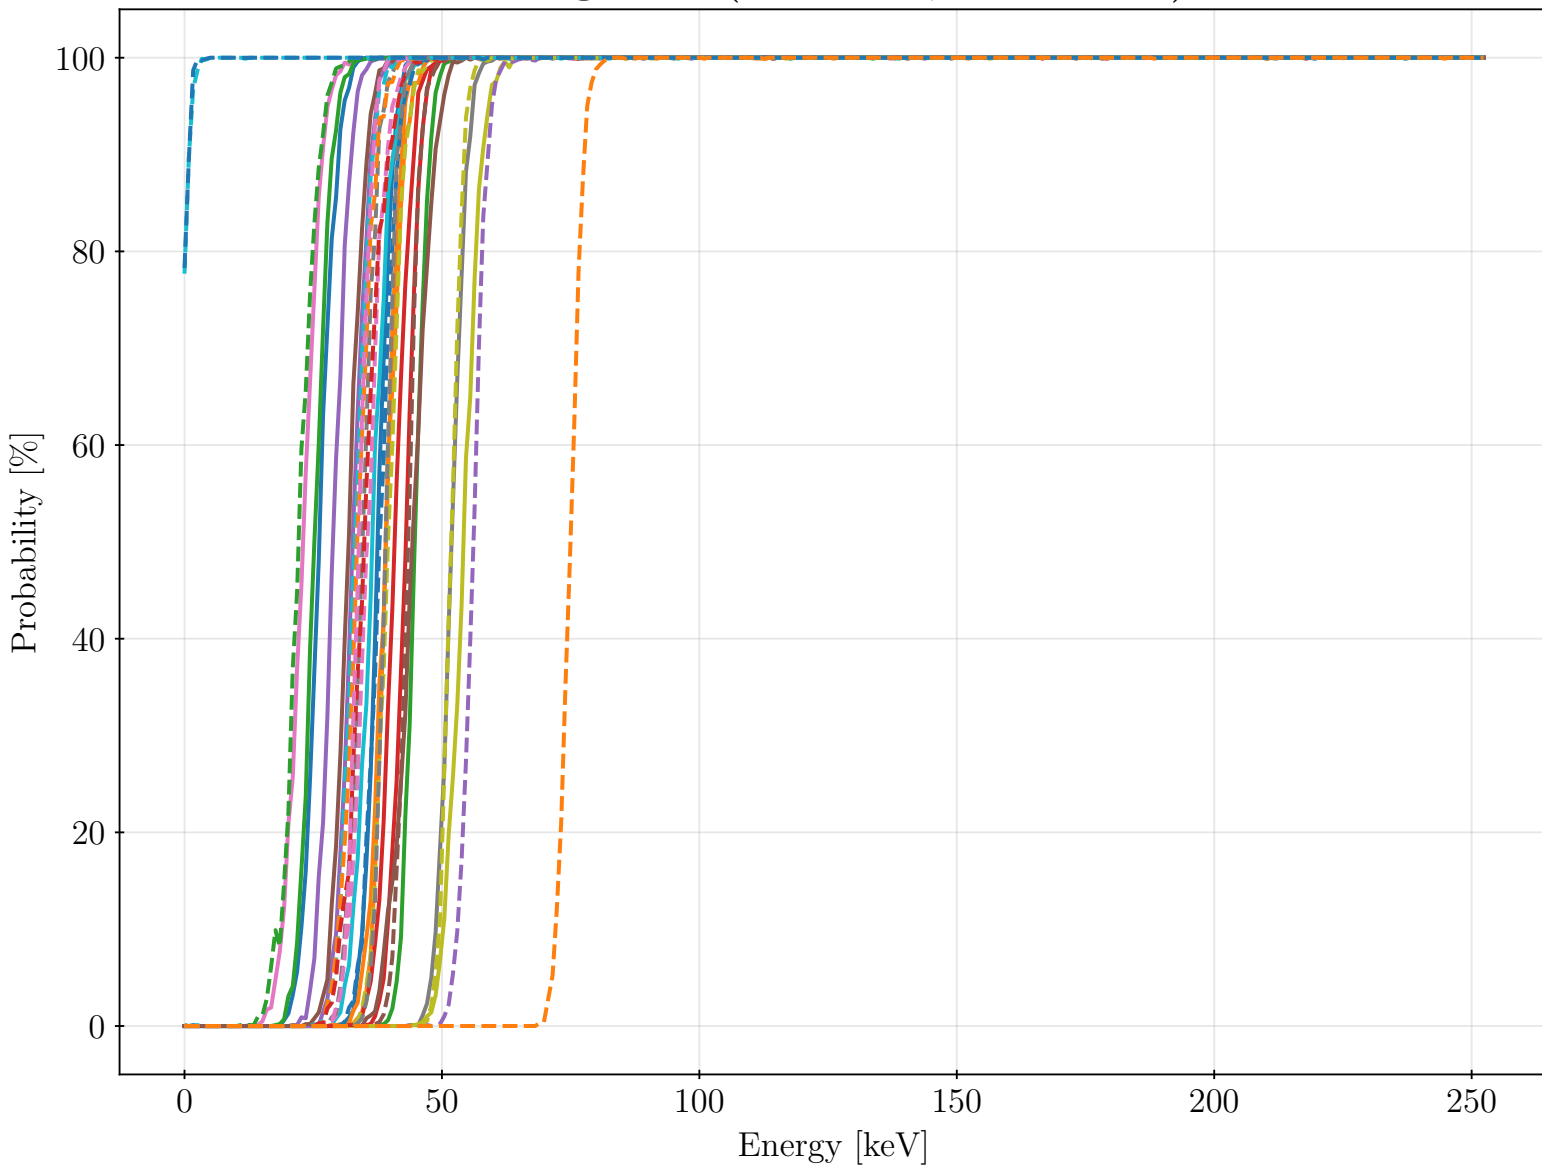

Channel			
0 THR: 37.55 keV ENC: 5.46 keV	16 THR: 35.51 keV ENC: 6.93 keV		
1 THR: 39.17 keV ENC: 5.21 keV	17 THR: 34.53 keV ENC: 5.94 keV		
2 THR: 44.77 keV ENC: 5.19 keV	18 THR: 39.57 keV ENC: 6.08 keV		
3 THR: 42.84 keV ENC: 5.86 keV	19 THR: 33.14 keV ENC: 6.28 keV		
4 THR: 28.94 keV ENC: 6.2 keV	20 THR: 37.93 keV ENC: 6.55 keV		
5 THR: 44.29 keV ENC: 8.34 keV	21 THR: 33.66 keV ENC: 6.86 keV		
6 THR: 22.96 keV ENC: 7.31 keV	22 THR: 22.25 keV ENC: 7.24 keV		
7 THR: 51.9 keV ENC: 5.73 keV	23 THR: 34.93 keV ENC: 8.13 keV		
8 THR: 54.15 keV ENC: 7.05 keV	24 THR: 56.02 keV ENC: 5.3 keV		
9 THR: 36.49 keV ENC: 7.21 keV	25 THR: 43.36 keV ENC: 4.72 keV		
10 THR: 26.18 keV ENC: 6.5 keV	26 THR: 33.88 keV ENC: 4.8 keV		
11 THR: 39.12 keV ENC: 6.73 keV	27 THR: 39.04 keV ENC: 4.39 keV		
12 THR: 25.31 keV ENC: 6.23 keV	28 THR: 51.8 keV ENC: 4.63 keV		
13 THR: 40.84 keV ENC: 6.54 keV	29 THR: -1.23 keV ENC: 3.81 keV		
14 THR: 32.76 keV ENC: 6.34 keV	30 THR: -1.14 keV ENC: 3.49 keV		
15 THR: 31.85 keV ENC: 6.42 keV	31 THR: 74.91 keV ENC: 5.11 keV		