


Charge scan (THR: 230, 1000 events)

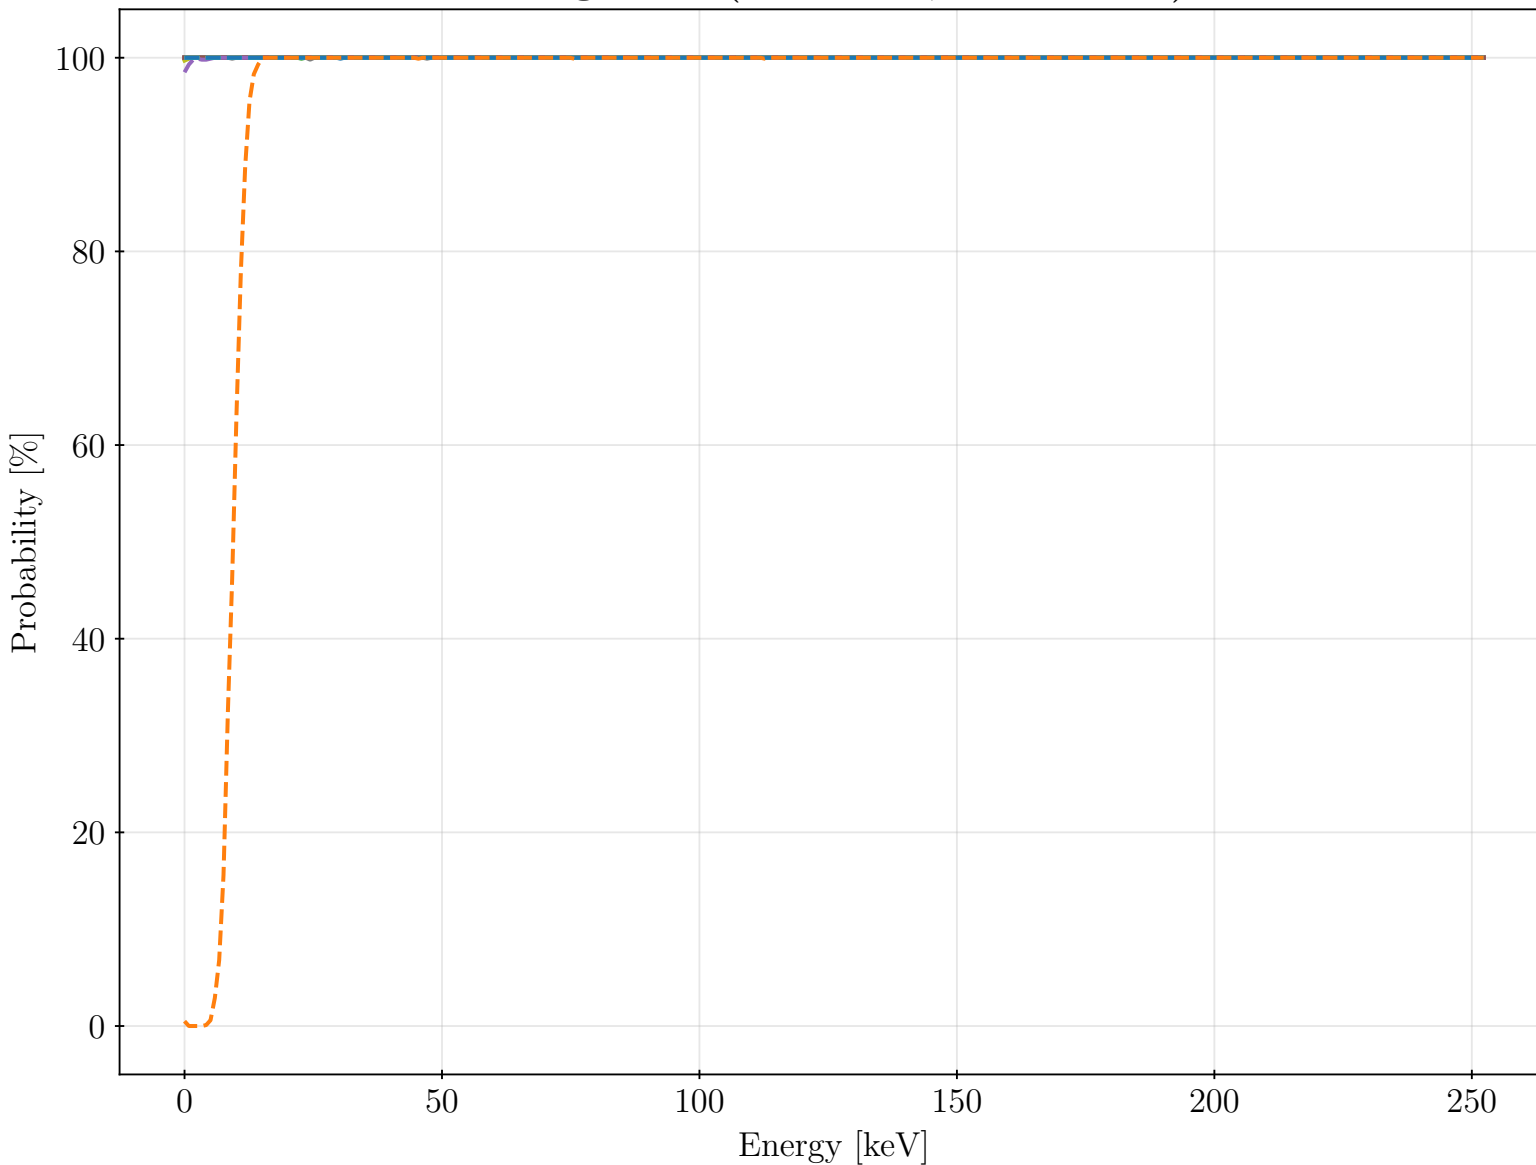

Channel			
0 THR: -38.05 keV ENC: 13.98 keV	---	16 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
1 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	---	17 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
2 THR: -60.09 keV ENC: 26.15 keV	---	18 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
3 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	---	19 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
4 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	---	20 THR: -60.48 keV ENC: 26.32 keV	
5 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	---	21 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
6 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	---	22 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
7 THR: -717.75 keV ENC: 448.46 keV	---	23 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
8 THR: -5.98 keV ENC: 5.12 keV	---	24 THR: -6.25 keV ENC: 6.76 keV	
9 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	---	25 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
10 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	---	26 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
11 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	---	27 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
12 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	---	28 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
13 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	---	29 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
14 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	---	30 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	
15 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	---	31 THR: 9.43 keV ENC: 4.51 keV	