


Charge scan (THR: 200, 1000 events, parasitic injection removed)

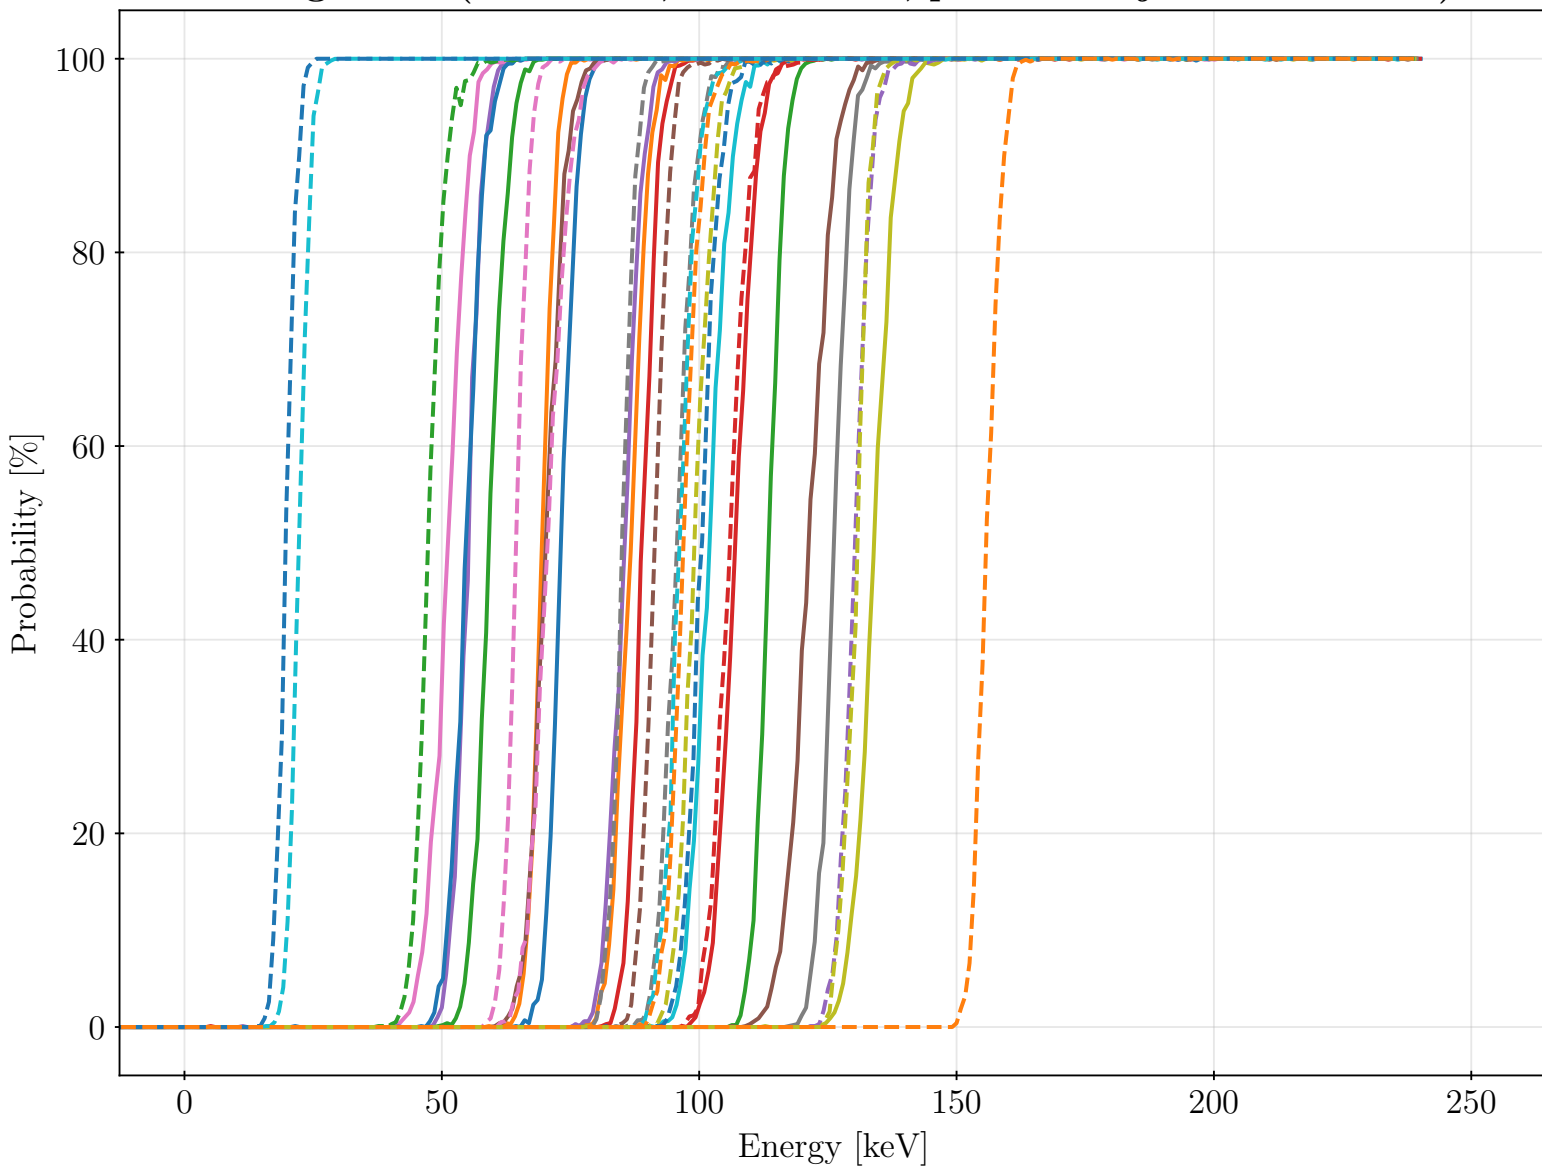

Channel			
0 THR: 73.26 keV ENC: 6.04 keV	16 THR: 70.62 keV ENC: 8.27 keV		
1 THR: 69.5 keV ENC: 5.3 keV	17 THR: 95.66 keV ENC: 7.23 keV		
2 THR: 113.54 keV ENC: 6.04 keV	18 THR: 99.18 keV ENC: 7.3 keV		
3 THR: 88.99 keV ENC: 6.15 keV	19 THR: 96.26 keV ENC: 6.73 keV		
4 THR: 55.02 keV ENC: 5.99 keV	20 THR: 100.45 keV ENC: 6.88 keV		
5 THR: 121.39 keV ENC: 9.66 keV	21 THR: 97.02 keV ENC: 6.95 keV		
6 THR: 51.19 keV ENC: 8.06 keV	22 THR: 47.45 keV ENC: 6.25 keV		
7 THR: 126.22 keV ENC: 6.43 keV	23 THR: 105.94 keV ENC: 8.2 keV		
8 THR: 134.01 keV ENC: 8.31 keV	24 THR: 130.25 keV ENC: 6.47 keV		
9 THR: 101.95 keV ENC: 8.22 keV	25 THR: 91.35 keV ENC: 5.88 keV		
10 THR: 54.79 keV ENC: 6.87 keV	26 THR: 64.45 keV ENC: 4.97 keV		
11 THR: 86.59 keV ENC: 7.35 keV	27 THR: 85.11 keV ENC: 5.13 keV		
12 THR: 59.26 keV ENC: 7.03 keV	28 THR: 130.53 keV ENC: 5.76 keV		
13 THR: 107.04 keV ENC: 8.1 keV	29 THR: 22.29 keV ENC: 4.47 keV		
14 THR: 85.45 keV ENC: 7.24 keV	30 THR: 19.73 keV ENC: 4.23 keV		
15 THR: 70.27 keV ENC: 7.59 keV	31 THR: 155.89 keV ENC: 5.93 keV		