


Charge scan (THR: 195, 1000 events, parasitic injection removed)

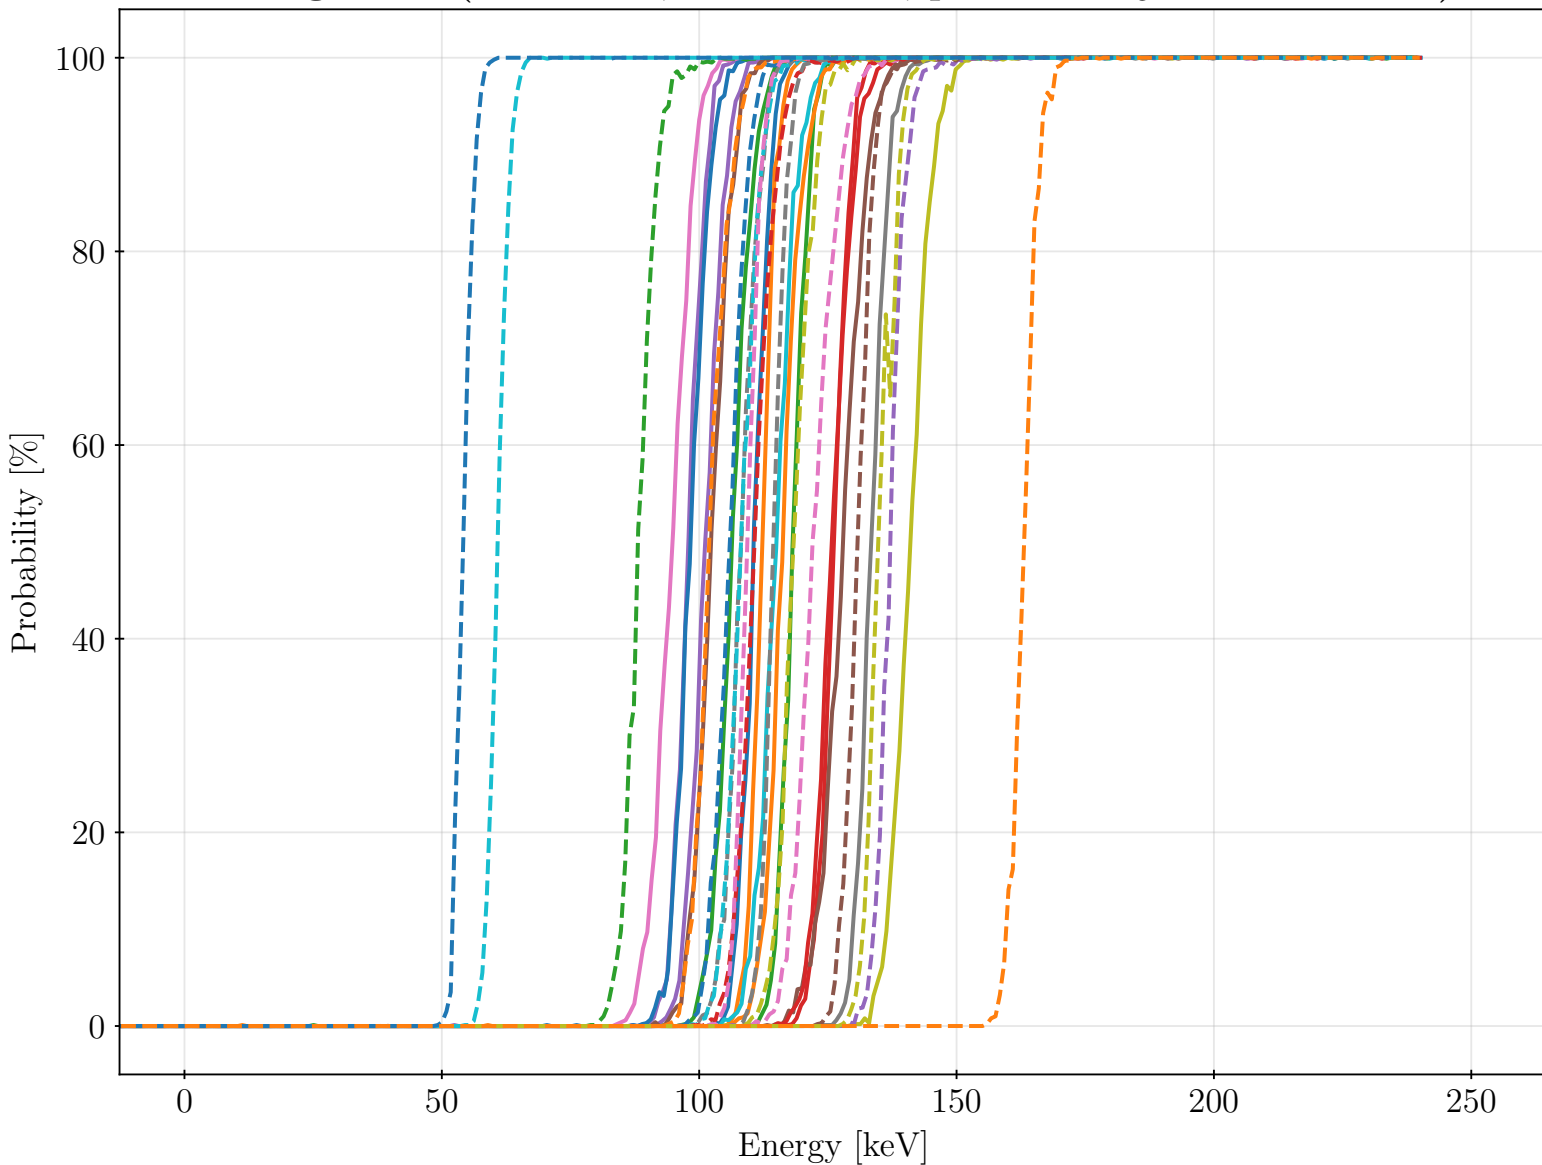

Channel			
0 THR: 110.72 keV	ENC: 6.4 keV	16 THR: 122.37 keV	ENC: 9.64 keV
1 THR: 112.23 keV	ENC: 5.47 keV	17 THR: 108.2 keV	ENC: 7.2 keV
2 THR: 118.24 keV	ENC: 6.32 keV	18 THR: 118.53 keV	ENC: 7.72 keV
3 THR: 126.17 keV	ENC: 6.65 keV	19 THR: 108.25 keV	ENC: 7.46 keV
4 THR: 97.93 keV	ENC: 6.75 keV	20 THR: 105.88 keV	ENC: 7.31 keV
5 THR: 127.91 keV	ENC: 9.73 keV	21 THR: 102.18 keV	ENC: 7.69 keV
6 THR: 94.67 keV	ENC: 8.88 keV	22 THR: 88.31 keV	ENC: 6.95 keV
7 THR: 133.48 keV	ENC: 6.62 keV	23 THR: 110.83 keV	ENC: 8.05 keV
8 THR: 141.0 keV	ENC: 8.71 keV	24 THR: 137.07 keV	ENC: 5.85 keV
9 THR: 114.94 keV	ENC: 8.4 keV	25 THR: 130.79 keV	ENC: 6.28 keV
10 THR: 98.33 keV	ENC: 7.55 keV	26 THR: 109.36 keV	ENC: 5.42 keV
11 THR: 116.25 keV	ENC: 7.54 keV	27 THR: 114.47 keV	ENC: 5.22 keV
12 THR: 106.48 keV	ENC: 8.02 keV	28 THR: 135.12 keV	ENC: 7.11 keV
13 THR: 125.89 keV	ENC: 8.34 keV	29 THR: 60.87 keV	ENC: 4.58 keV
14 THR: 101.27 keV	ENC: 7.91 keV	30 THR: 54.16 keV	ENC: 4.2 keV
15 THR: 102.46 keV	ENC: 8.07 keV	31 THR: 163.08 keV	ENC: 5.81 keV