


Charge scan (THR: 206, 1000 events)

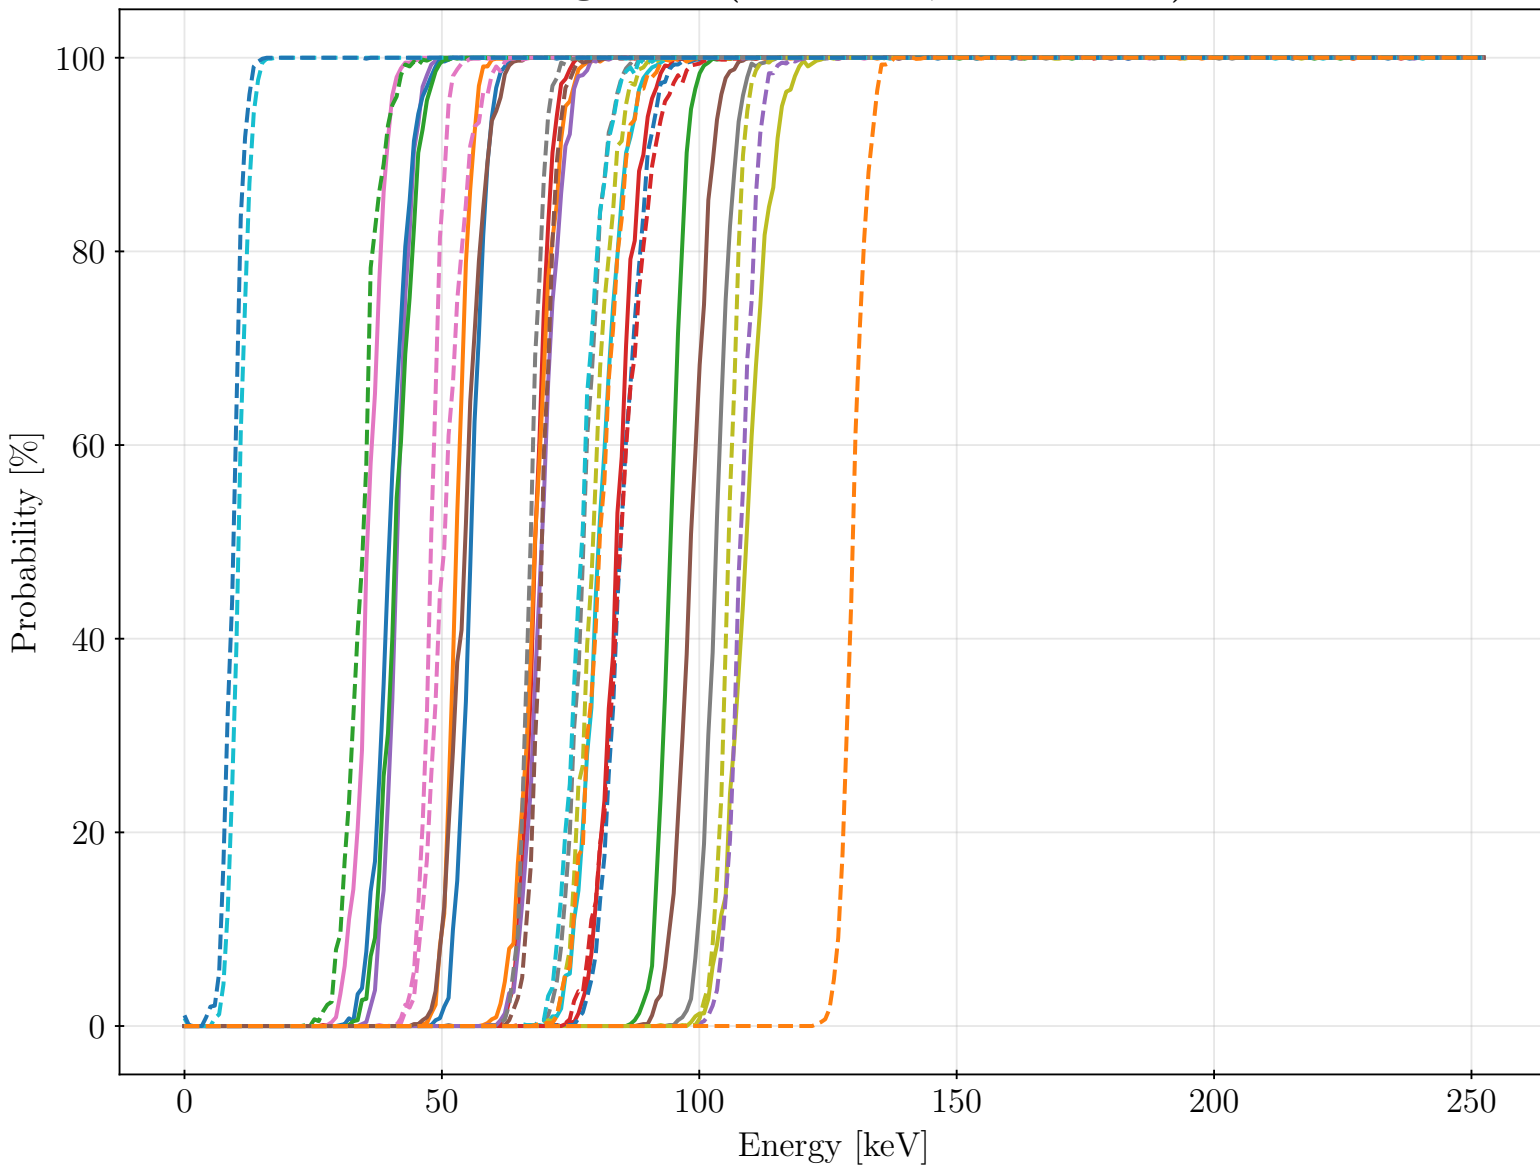

Channel			
0 THR: 55.67 keV ENC: 6.08 keV	16 THR: 50.48 keV ENC: 8.93 keV		
1 THR: 52.91 keV ENC: 5.31 keV	17 THR: 77.57 keV ENC: 7.82 keV		
2 THR: 94.41 keV ENC: 6.01 keV	18 THR: 79.33 keV ENC: 8.44 keV		
3 THR: 68.2 keV ENC: 6.08 keV	19 THR: 77.13 keV ENC: 8.5 keV		
4 THR: 41.32 keV ENC: 5.88 keV	20 THR: 84.98 keV ENC: 9.15 keV		
5 THR: 98.49 keV ENC: 7.76 keV	21 THR: 80.74 keV ENC: 9.78 keV		
6 THR: 35.74 keV ENC: 6.5 keV	22 THR: 34.36 keV ENC: 7.59 keV		
7 THR: 103.32 keV ENC: 6.56 keV	23 THR: 84.93 keV ENC: 11.11 keV		
8 THR: 109.15 keV ENC: 9.79 keV	24 THR: 108.11 keV ENC: 6.3 keV		
9 THR: 80.65 keV ENC: 9.41 keV	25 THR: 76.92 keV ENC: 0.05 keV		
10 THR: 39.95 keV ENC: 7.92 keV	26 THR: 47.93 keV ENC: 4.87 keV		
11 THR: 68.25 keV ENC: 8.29 keV	27 THR: 67.24 keV ENC: 4.97 keV		
12 THR: 41.17 keV ENC: 8.05 keV	28 THR: 105.76 keV ENC: 5.26 keV		
13 THR: 84.06 keV ENC: 8.42 keV	29 THR: 10.53 keV ENC: 4.25 keV		
14 THR: 69.41 keV ENC: 7.87 keV	30 THR: 9.37 keV ENC: 4.19 keV		
15 THR: 54.38 keV ENC: 8.32 keV	31 THR: 129.88 keV ENC: 5.48 keV		