


Charge scan (THR: 205, 1000 events, parasitic injection removed)

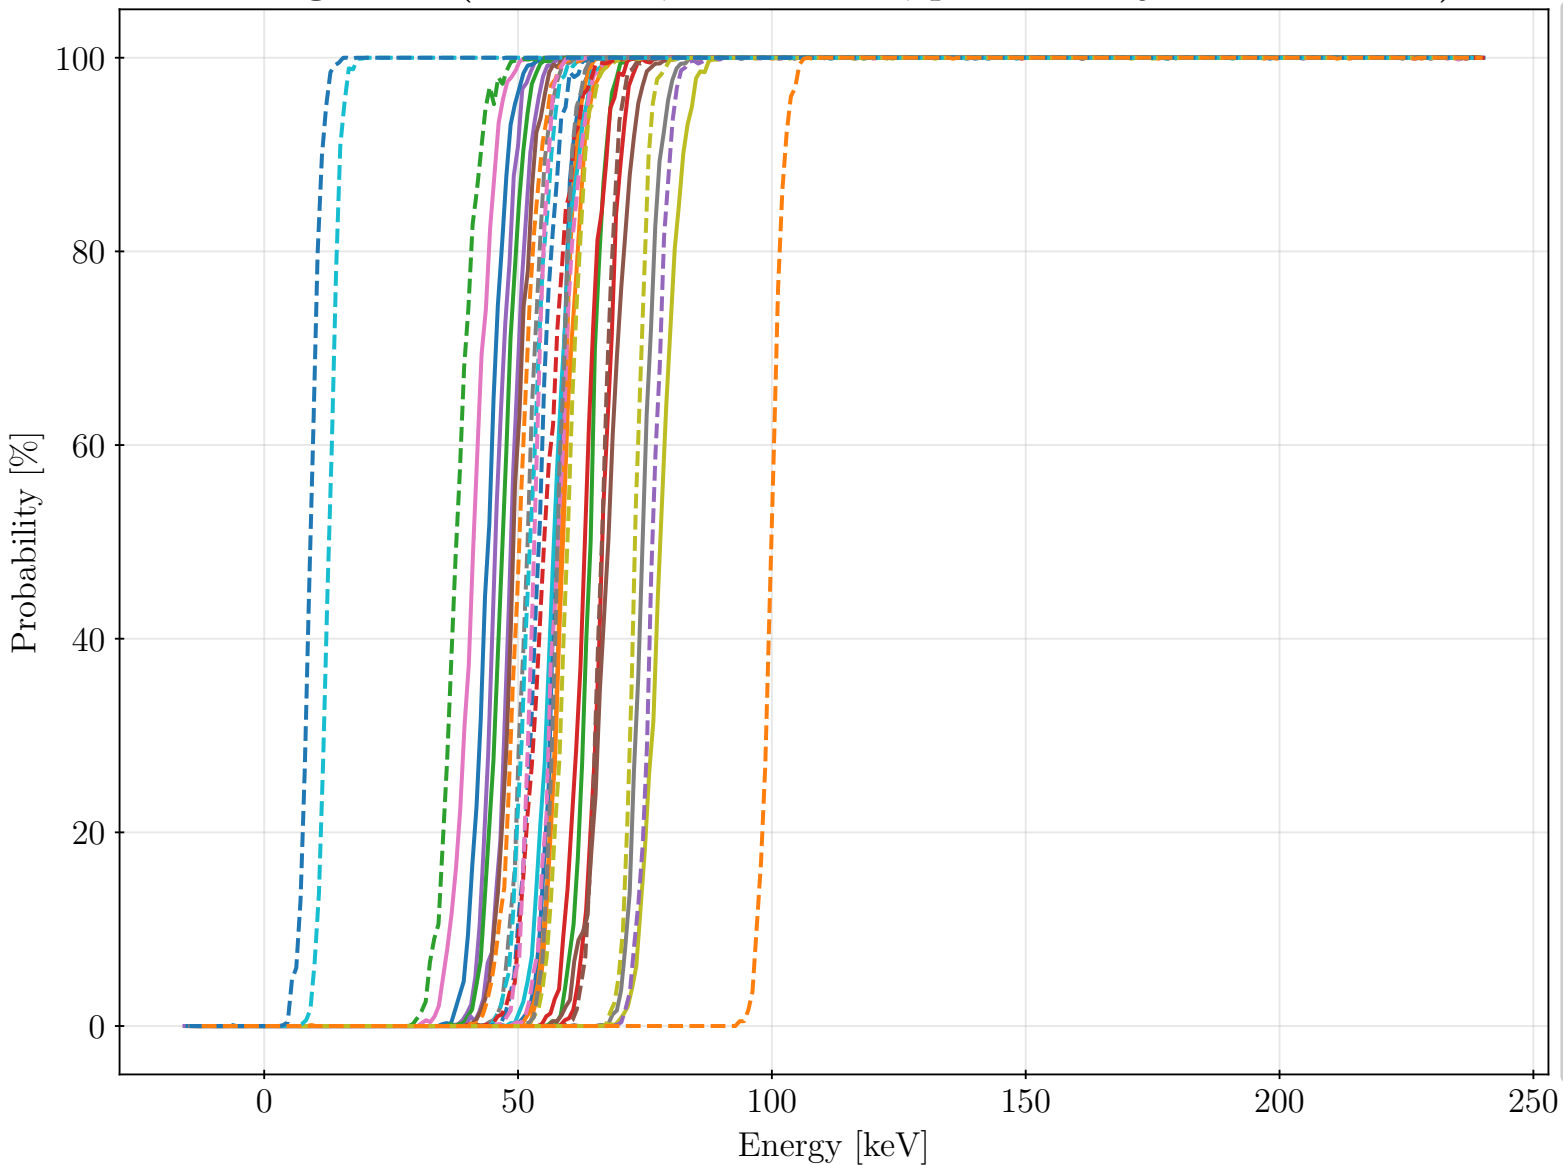

Channel			
0 THR: 57.61 keV	ENC: 5.97 keV	16 THR: 57.92 keV	ENC: 7.6 keV
1 THR: 58.48 keV	ENC: 5.43 keV	17 THR: 51.85 keV	ENC: 6.5 keV
2 THR: 64.07 keV	ENC: 5.77 keV	18 THR: 59.71 keV	ENC: 6.61 keV
3 THR: 66.69 keV	ENC: 6.64 keV	19 THR: 52.46 keV	ENC: 7.26 keV
4 THR: 45.74 keV	ENC: 6.7 keV	20 THR: 54.01 keV	ENC: 7.14 keV
5 THR: 67.69 keV	ENC: 8.7 keV	21 THR: 50.29 keV	ENC: 7.44 keV
6 THR: 41.23 keV	ENC: 8.21 keV	22 THR: 37.98 keV	ENC: 7.87 keV
7 THR: 74.6 keV	ENC: 6.12 keV	23 THR: 55.33 keV	ENC: 9.82 keV
8 THR: 78.09 keV	ENC: 7.91 keV	24 THR: 76.61 keV	ENC: 5.87 keV
9 THR: 57.19 keV	ENC: 7.94 keV	25 THR: 66.5 keV	ENC: 5.62 keV
10 THR: 44.08 keV	ENC: 7.21 keV	26 THR: 53.17 keV	ENC: 5.08 keV
11 THR: 58.93 keV	ENC: 7.25 keV	27 THR: 57.89 keV	ENC: 5.15 keV
12 THR: 46.95 keV	ENC: 7.2 keV	28 THR: 73.16 keV	ENC: 4.84 keV
13 THR: 63.14 keV	ENC: 7.28 keV	29 THR: 12.75 keV	ENC: 4.29 keV
14 THR: 48.71 keV	ENC: 6.59 keV	30 THR: 9.1 keV	ENC: 4.21 keV
15 THR: 49.27 keV	ENC: 7.19 keV	31 THR: 99.87 keV	ENC: 4.86 keV