


Charge scan (THR: 218, 1000 events)

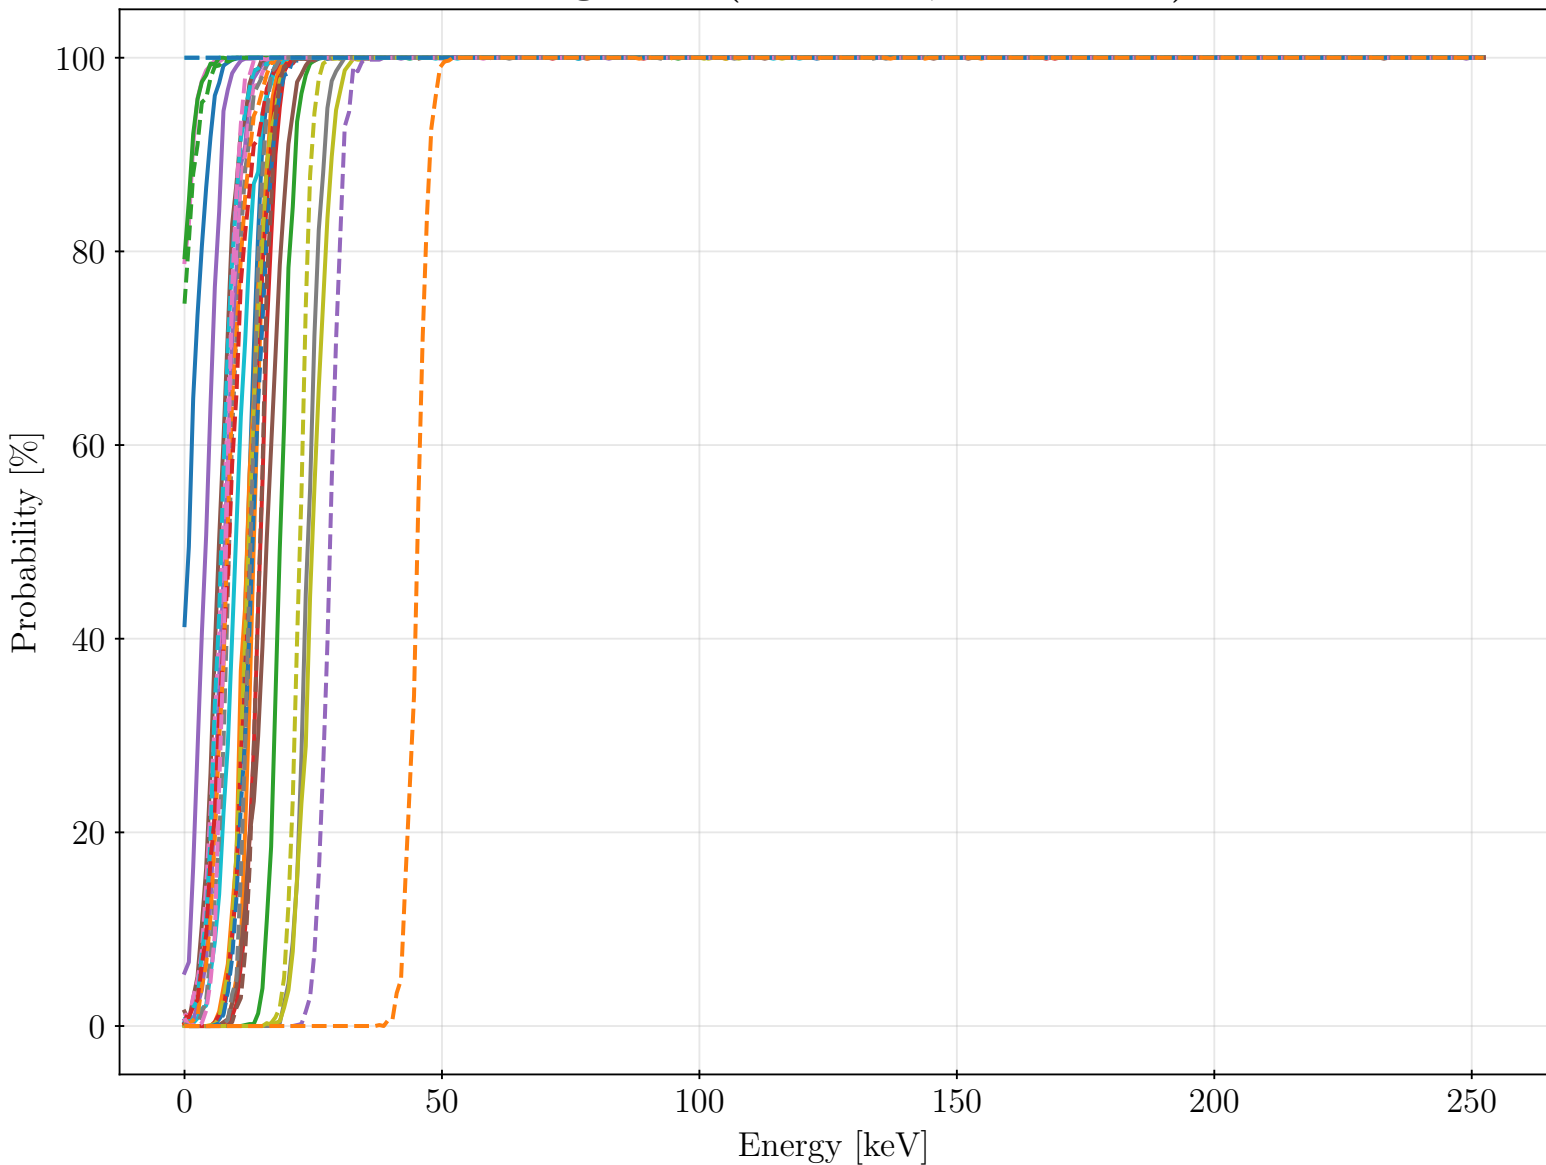

Channel			
0	THR: 12.24 keV ENC: 5.26 keV	16	THR: 7.41 keV ENC: 7.2 keV
1	THR: 13.5 keV ENC: 4.78 keV	17	THR: 8.75 keV ENC: 5.82 keV
2	THR: 18.63 keV ENC: 5.03 keV	18	THR: 12.56 keV ENC: 6.55 keV
3	THR: 14.71 keV ENC: 5.45 keV	19	THR: 7.16 keV ENC: 6.12 keV
4	THR: 4.08 keV ENC: 5.83 keV	20	THR: 13.29 keV ENC: 6.83 keV
5	THR: 15.91 keV ENC: 7.88 keV	21	THR: 8.42 keV ENC: 7.04 keV
6	THR: -2.25 keV ENC: 6.95 keV	22	THR: -2.36 keV ENC: 8.39 keV
7	THR: 24.02 keV ENC: 5.31 keV	23	THR: 8.6 keV ENC: 8.45 keV
8	THR: 24.92 keV ENC: 6.71 keV	24	THR: 28.27 keV ENC: 4.99 keV
9	THR: 10.04 keV ENC: 7.35 keV	25	THR: 14.63 keV ENC: 4.76 keV
10	THR: 0.7 keV ENC: 7.15 keV	26	THR: 8.06 keV ENC: 4.22 keV
11	THR: 12.31 keV ENC: 6.66 keV	27	THR: 12.84 keV ENC: 4.4 keV
12	THR: -2.38 keV ENC: 6.93 keV	28	THR: 22.37 keV ENC: 4.33 keV
13	THR: 12.83 keV ENC: 6.62 keV	29	THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV
14	THR: 7.85 keV ENC: 6.26 keV	30	THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV
15	THR: 6.79 keV ENC: 6.54 keV	31	THR: 45.19 keV ENC: 4.67 keV