


Charge scan (THR: 185, 1000 events, parasitic injection removed)

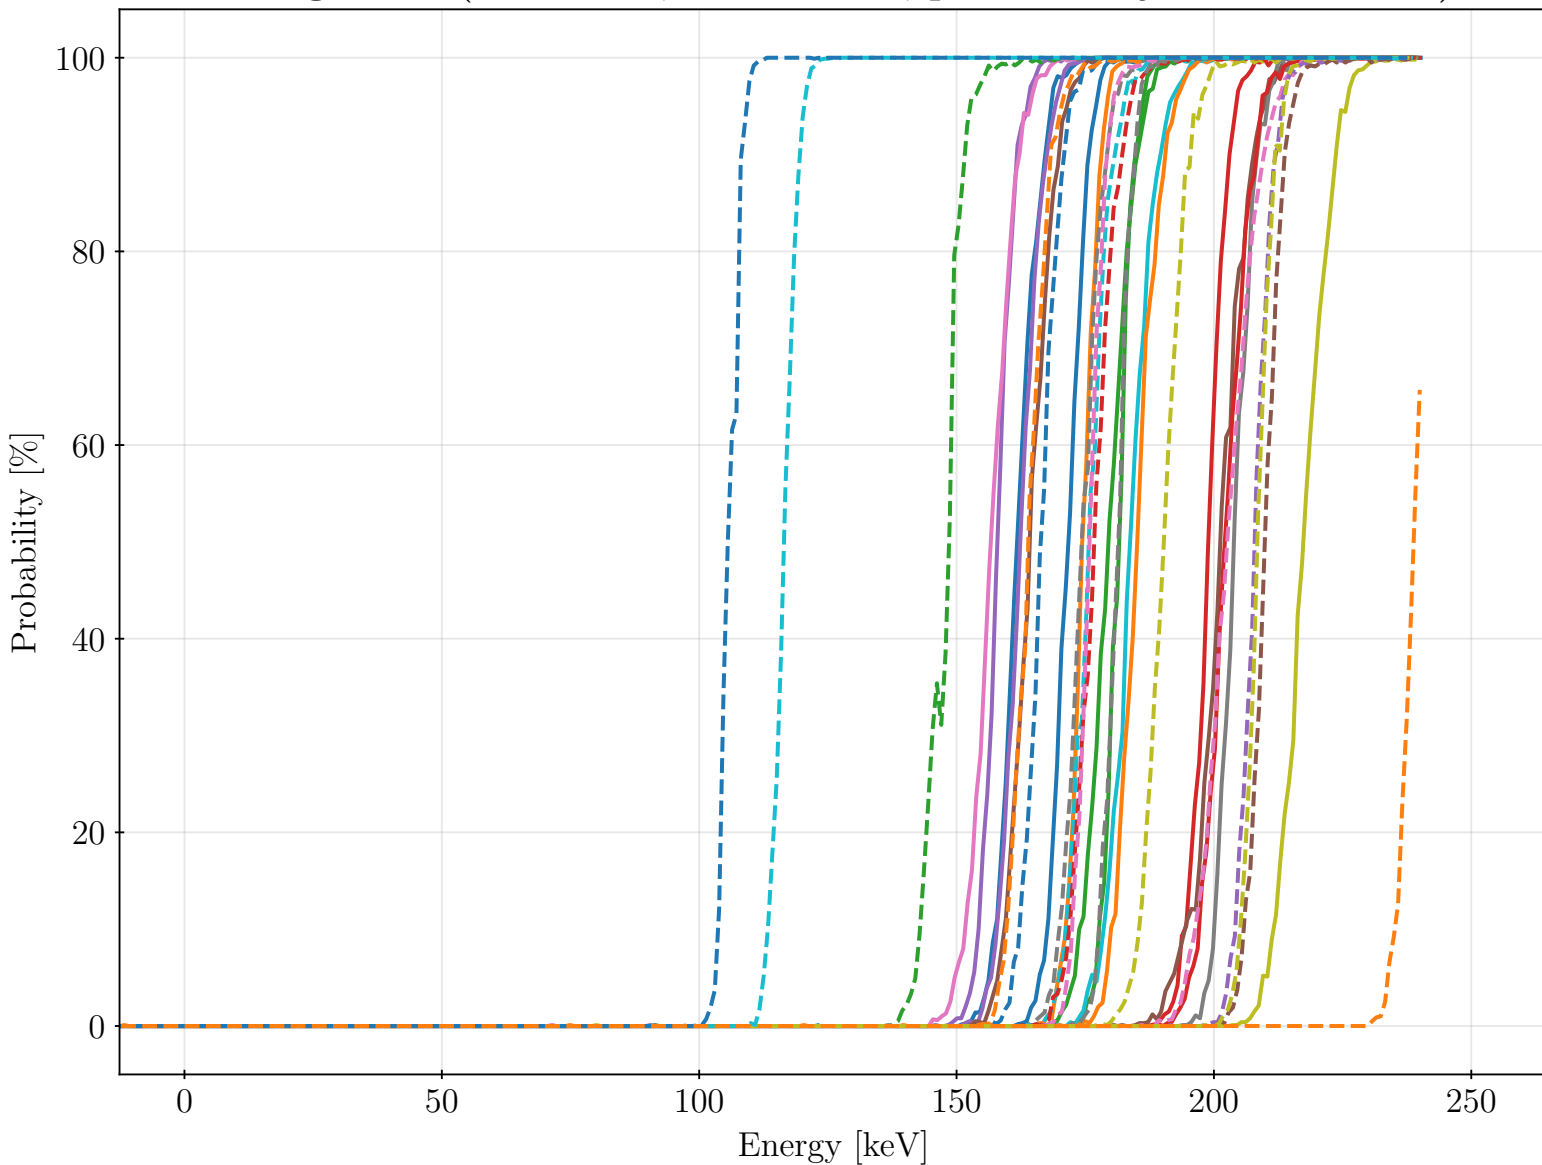

Channel			
0 THR: 171.63 keV ENC: 7.79 keV	16 THR: 202.77 keV ENC: 12.21 keV		
1 THR: 174.61 keV ENC: 6.38 keV	17 THR: 174.48 keV ENC: 8.33 keV		
2 THR: 181.35 keV ENC: 6.24 keV	18 THR: 190.24 keV ENC: 9.21 keV		
3 THR: 198.88 keV ENC: 7.73 keV	19 THR: 175.78 keV ENC: 8.6 keV		
4 THR: 157.98 keV ENC: 6.96 keV	20 THR: 166.45 keV ENC: 7.77 keV		
5 THR: 201.39 keV ENC: 11.43 keV	21 THR: 164.03 keV ENC: 8.27 keV		
6 THR: 156.83 keV ENC: 9.68 keV	22 THR: 147.75 keV ENC: 8.12 keV		
7 THR: 204.03 keV ENC: 7.94 keV	23 THR: 176.72 keV ENC: 9.34 keV		
8 THR: 217.53 keV ENC: 11.1 keV	24 THR: 207.93 keV ENC: 7.22 keV		
9 THR: 183.87 keV ENC: 9.84 keV	25 THR: 209.95 keV ENC: 7.19 keV		
10 THR: 161.93 keV ENC: 8.67 keV	26 THR: 175.83 keV ENC: 6.19 keV		
11 THR: 185.08 keV ENC: 9.26 keV	27 THR: 181.19 keV ENC: 6.26 keV		
12 THR: 179.57 keV ENC: 10.12 keV	28 THR: 208.53 keV ENC: 6.29 keV		
13 THR: 202.31 keV ENC: 10.02 keV	29 THR: 116.52 keV ENC: 5.55 keV		
14 THR: 162.46 keV ENC: 8.8 keV	30 THR: 105.87 keV ENC: 4.87 keV		
15 THR: 164.33 keV ENC: 9.67 keV	31 THR: 238.82 keV ENC: 6.75 keV		