


Charge scan (THR: 190, 1000 events)

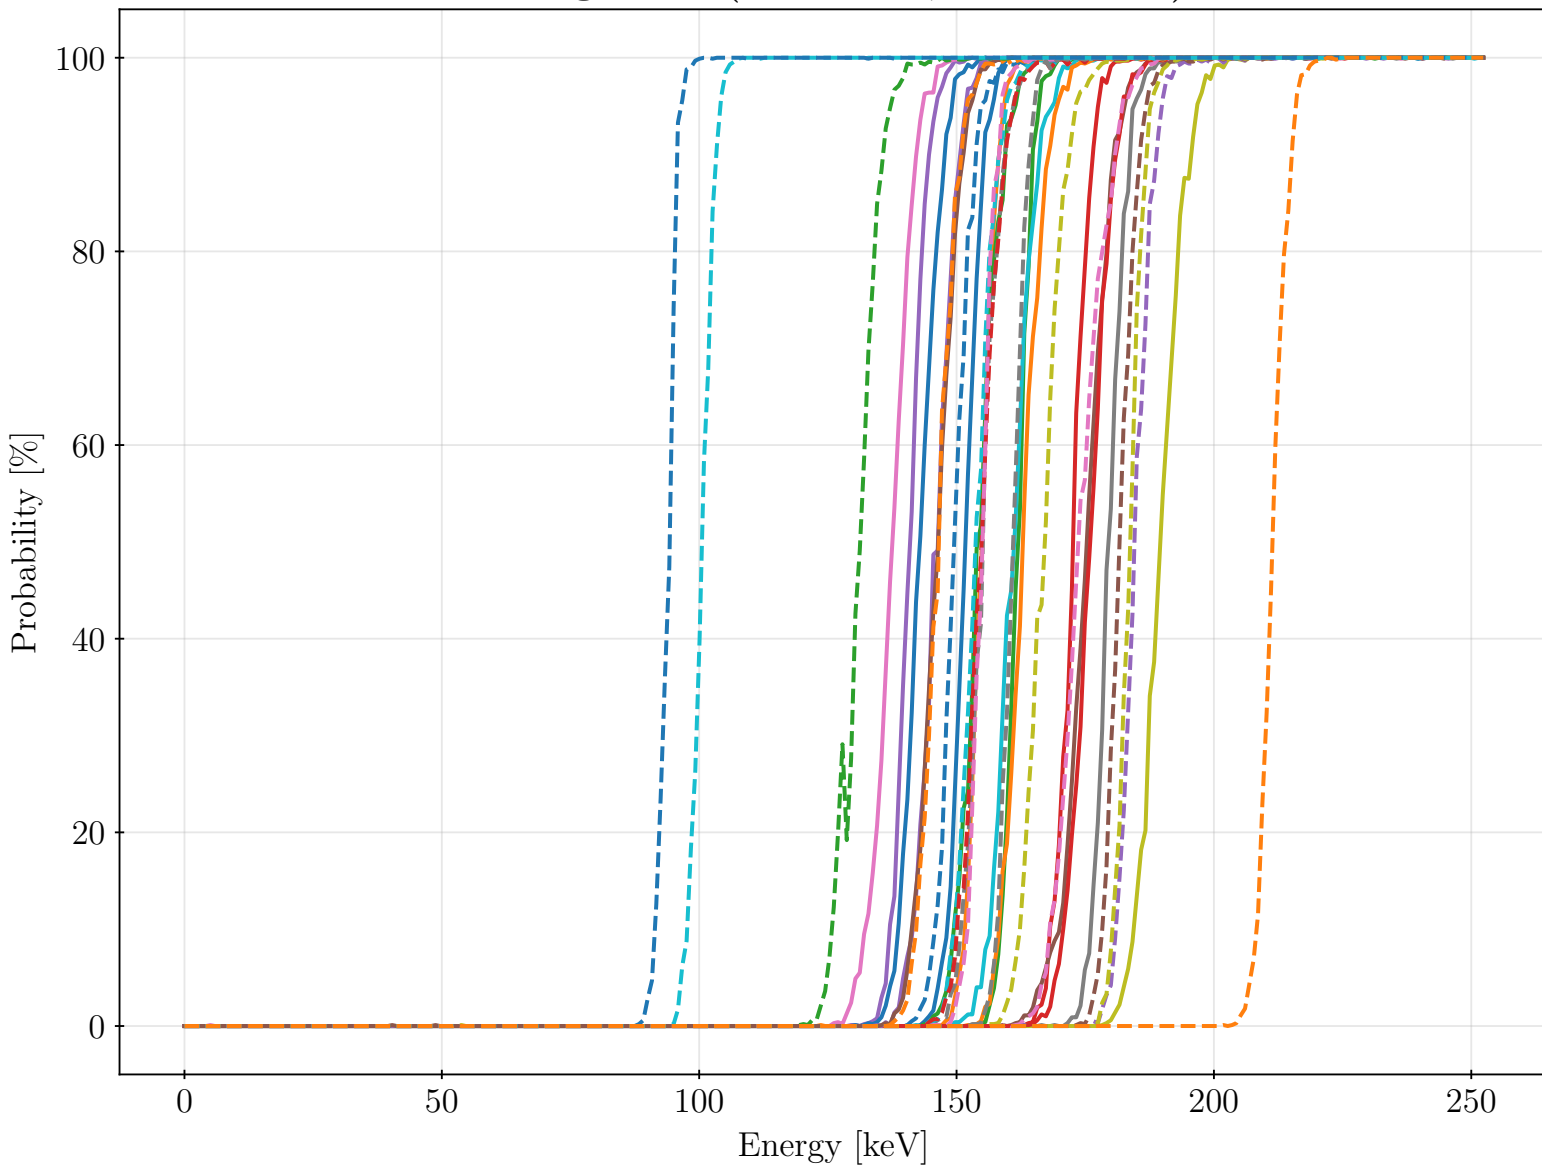

Channel			
0 THR: 151.74 keV ENC: 6.82 keV	16 THR: 174.09 keV ENC: 11.3 keV		
1 THR: 154.79 keV ENC: 6.07 keV	17 THR: 155.0 keV ENC: 7.61 keV		
2 THR: 161.84 keV ENC: 6.03 keV	18 THR: 166.83 keV ENC: 8.84 keV		
3 THR: 172.56 keV ENC: 7.04 keV	19 THR: 153.81 keV ENC: 8.03 keV		
4 THR: 140.88 keV ENC: 6.89 keV	20 THR: 149.65 keV ENC: 7.29 keV		
5 THR: 175.27 keV ENC: 10.29 keV	21 THR: 146.39 keV ENC: 7.92 keV		
6 THR: 137.51 keV ENC: 8.88 keV	22 THR: 131.06 keV ENC: 8.96 keV		
7 THR: 179.67 keV ENC: 6.91 keV	23 THR: 154.78 keV ENC: 8.41 keV		
8 THR: 189.67 keV ENC: 9.81 keV	24 THR: 184.71 keV ENC: 7.06 keV		
9 THR: 161.01 keV ENC: 9.25 keV	25 THR: 181.76 keV ENC: 6.76 keV		
10 THR: 142.96 keV ENC: 8.37 keV	26 THR: 154.89 keV ENC: 5.46 keV		
11 THR: 162.93 keV ENC: 8.71 keV	27 THR: 160.94 keV ENC: 5.92 keV		
12 THR: 154.37 keV ENC: 8.78 keV	28 THR: 183.63 keV ENC: 5.9 keV		
13 THR: 175.91 keV ENC: 9.33 keV	29 THR: 100.56 keV ENC: 5.22 keV		
14 THR: 146.06 keV ENC: 8.58 keV	30 THR: 93.95 keV ENC: 4.1 keV		
15 THR: 146.3 keV ENC: 9.02 keV	31 THR: 211.44 keV ENC: 6.21 keV		