


Charge scan (THR: 180, 1000 events, parasitic injection removed)

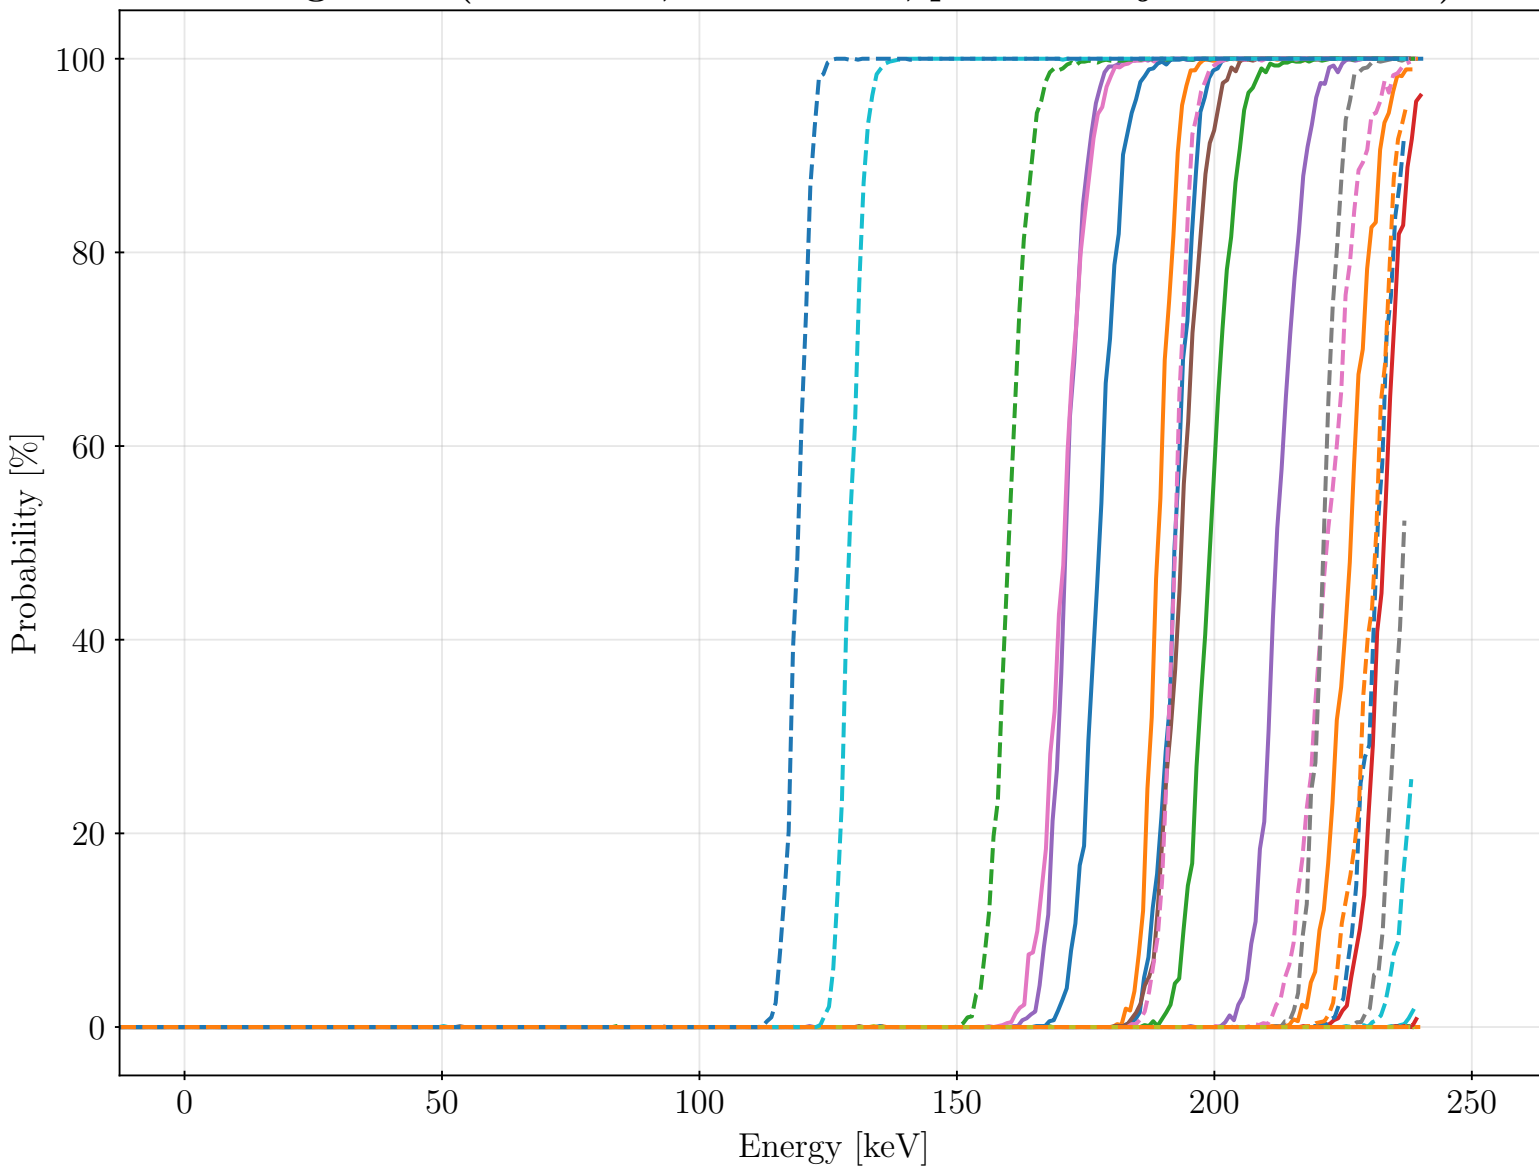

Channel			
0 THR: 192.43 keV ENC: 8.03 keV	16 THR: 222.08 keV ENC: 12.55 keV		
1 THR: 189.15 keV ENC: 6.69 keV	17 THR: 236.68 keV ENC: 7.86 keV		
2 THR: 269.02 keV ENC: 21.28 keV	18 THR: 238.45 keV ENC: 0.87 keV		
3 THR: 232.8 keV ENC: 8.71 keV	19 THR: 240.8 keV ENC: 9.35 keV		
4 THR: 171.23 keV ENC: 7.39 keV	20 THR: 231.62 keV ENC: 8.91 keV		
5 THR: 9640.57 keV ENC: 3141.96 keV	21 THR: 230.86 keV ENC: 9.65 keV		
6 THR: 170.7 keV ENC: 9.67 keV	22 THR: 160.1 keV ENC: 7.82 keV		
7 THR: 4006647.08 keV ENC: 2090047.94 keV	23 THR: 243.32 keV ENC: 3.96 keV		
8 THR: 10285.68 keV ENC: 5306.57 keV	24 THR: 9463.92 keV ENC: 3066.92 keV		
9 THR: 245.02 keV ENC: 7.15 keV	25 THR: 271.88 keV ENC: 25.84 keV		
10 THR: 177.63 keV ENC: 8.85 keV	26 THR: 192.35 keV ENC: 5.98 keV		
11 THR: 226.32 keV ENC: 10.64 keV	27 THR: 221.18 keV ENC: 6.85 keV		
12 THR: 199.24 keV ENC: 9.69 keV	28 THR: 9490.25 keV ENC: 3075.81 keV		
13 THR: 9492.45 keV ENC: 3071.37 keV	29 THR: 129.28 keV ENC: 5.48 keV		
14 THR: 212.45 keV ENC: 9.35 keV	30 THR: 119.06 keV ENC: 5.45 keV		
15 THR: 193.59 keV ENC: 9.54 keV	31 THR: 9724.81 keV ENC: 3151.22 keV		